

EURUS S8

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sehr geehrte Kunden

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Diese Gebrauchsanweisung erläutert die Verwendung des EURUS. Lesen Sie vor der Verwendung des EURUS sorgfältig die Bedienungsanleitung und verwenden Sie das Produkt stets ordnungsgemäß.

Wenn Sie das Produkt verwenden, ohne diese Anleitung gelesen zu haben, kann dies zu einem Unfall führen.

Um einen einfachen Zugriff auf die hierin enthaltenen Informationen zu erhalten, bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung griffbereit auf und schlagen Sie bei Bedarf nach.

Beauftragen Sie Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort mit der Installation dieses Produkts gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen.

Wenn Sie Fragen zur Bedienungsanleitung oder diesem Produkt haben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Wenn diese Gebrauchsanweisung verschmutzt ist und Sie eine neue benötigen, nennen Sie Ihrem autorisierten Belmont-Händler vor Ort die unten angegebene Referenznummer, um eine neue zu bestellen.

Dieses Dokument beschreibt die vollständige Version des Systems. Es kann daher Komponenten abdecken, die in dem von Ihnen erworbenen System nicht enthalten sind.

2025-09-01 (6. Ausgabe)	
REF	1E09WNF0

Sehr geehrte Kunden	2
---------------------------	---

1 Allgemeine Informationen

1–1 Verwendungszweck des Produktes	8
1–2 Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien	8
1–3 Konformitätserklärung	8
1–4 Entsorgung des Geräts	9
1–5 Entsorgung von Rückständen	9
1–6 Hinweis an den Benutzer und/oder Patienten	9
1–7 Kompatible Handstücke	9
1–8 Kompatible ZahnarztLicht/Leuchten	9
1–9 Symbole	10
1–10 Technische Beschreibung	15

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

2–1 Auslegung der Risikostufe	16
2–2 Sicherheitsvorkehrungen	18
Bei der Verwendung des Produktes zu beachtende Punkte	29
2–3 Stellen, an denen Vorsichtsaufkleber angebracht sind	31
2–4 EMV-Informationen	34
2–5 Kompatible Handstücke	38
2–6 Kompatible ZahnarztLicht/Leuchten	38

3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

3–1 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb	38
3–2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Kunstleder	40

4 Produktspezifikationen

4–1 Technische Daten	42
4–1–1 Varianten der Spezifikationen	42
4–1–2 S8	42
4–1–3 Spezifikationen für Luft/Wasser/Absaugung	50
4–2 Systemübersicht	51
4–3 Bezeichnung der einzelnen Teile	54
4–3–1 Stuhl	54
4–3–2 Kopfstütze	55
4–3–3 Fußanlasser (Kabel/Funk)	56

4–3–4	Fußanlasser	56
4–3–5	Arzteinheit	57
4–3–6	Mundspüleinheit	59
4–3–7	Vac Pac-Einheit	61
4–3–8	Assistenzelement	61
4–3–9	Anschlussclose	61

5 Bedienung

5–1	Vorbereitung vor der Verwendung	62
5–2	Nach der Verwendung	66
5–3	Betätigen des HauptscHolders für den Stuhl während der Behandlung (wenn der HauptscHolder für den Stuhl verfügbar ist)	67
5–4	Anheben/Absenken des Stuhls und Aufrichten/Zurücklehnen der Rückenlehne (manueller Betrieb)	68
5–5	Den Stuhl in die Voreinstellungsposition bewegen (automatischer Betrieb)	70
5–6	Bedienung der Kopfstütze (manueller Typ)	71
5–7	Bedienung der Kopfstütze (elektrohydraulisch Typ)	72
5–8	Drehen der Armlehne	76
5–9	Bedienung des Arzttisches	77
5–10	Bedienung der Helferinnenablage	79
5–11	Handstück	81
5–12	Bedienfeld der Arzteinheit	82
5–13	Helferinnen-Bedienfeld	106
5–14	Abbruchfunktion	110
5–15	Sperrfunktion	111
5–15–1	Stuhlverrieglungsfunktion	111
5–15–2	Handstücksperrfunktion	115
5–16	Mikromotor	116
	Mikromotor-Schiebemode einstellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	116
	Maximale Drehzahl einstellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	117
	Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	118
	Anzeige der Übersetzungsumwandlung (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	119
	Überhitzungsschutzfunktion (NBX/NLX plus/MX2/MCX)	120
	NLX plus	121
	MX2	123
5–17	Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät	130
	Scholdereinstellung Perio/Endo/Scaling	130

Einstellung der maximalen Ausgangsleistung im Schiebemode Va	131
Einstellung der maximalen Ausgangsleistung im Schiebemode Fix.....	131
Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten.....	132
5-18 Luftturbine/Motor	133
Einstellen des Schiebemode	133
Einstellen der maximalen Ausgangsleistung	134
Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten.....	135
5-19 Implantatmotor	136
5-19-1 Anschlussmethode	136
5-19-2 Betriebsmethode	140
5-19-3 Einstellung der Handstückbedingungen.....	141
Einstellung des Schiebemode	141
Einstellung der maximalen Leistung	141
Einstellung des Standardeinschaltspeichers.....	143
Anzeige der Übersetzungsumwandlung (MX-i LED 3. Generation)	144
5-20 Spritzen.....	145
5-21 Fußanlasser (Kabel/Funk)	146
5-21-1 Überprüfung der Kopplung mit dem Funken Fußanlasser	147
5-21-2 Austausch der Batterien im Funken Fußanlasser.....	148
5-21-3 Kabelverbindung für einen Funken Fußanlasser	149
5-21-4 Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung des Funken Fußanlassers	150
5-22 Wartungs-Bedienfeld	151
5-23 Handstück (HelferinnenHolder)	152
5-24 Helferinnen-Schlauchklemme	152
5-25 Einen Becher füllen.....	153
5-26 LED-Anzeige	154
5-27 Wasserflasche	155
5-28 USB-Anschluss	156
5-29 EURUS-Licht/Leuchte	157
5-30 900 ZahnarztLicht/Leuchte.....	158
5-31 MonitorHolderung	159
5-32 Panoramaanzeige.....	159
5-33 Dentalanzeige.....	159
5-34 Umbau rechts-/linkshändige Zahnarztbehandlung	160

6 Einstellen/Anpassen

6-1 Einstellung für automatischen Betrieb	168
6-1-1 Einstellung der Behandlungs- und Einstiegs-/Ausstiegspositionen	168

6-1-2	Einstellung der Mundspülposition	168
6-2	Funktionstaste.....	169
6-2-1	Elemente mit dem Funktionstaste einstellen.....	170
6-2-2	Auswahl des Spülverfahrens und Durchführung der Spülung	171
6-2-3	Auswahl des Waschverfahrens für die Absaugleitung und Durchführung des Waschens	191
6-2-4	Antriebsluftdruck anzeigen.....	208
6-2-5	Sprühmodus einstellen	209
6-2-6	Aktivierungszeit der Licht/Leuchte einstellen	210
6-2-7	Mikromotor-Helligkeit einstellen.....	211
6-2-8	Wasserstand des Becherfüllers einstellen.....	213
6-2-9	Synchronisation von Becherfüllung/Beckenspülung einstellen.....	215
6-2-10	Beckenspülzeit einstellen.....	216
6-2-11	Sprache einstellen	217
6-2-12	Timer-Alarmton einstellen	218
6-2-13	Tastenlautstärke einstellen	219
6-2-14	Schlafmodus-Zeit einstellen	220
6-2-15	Notabschaltung der Stuhlverriegelung einstellen	221
6-2-16	Anzeige der Programmversion	222
6-3	Von der Arzteinheit zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen	223
6-4	Zur Mundspüleinheit zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen	224

7 Wartung und Reinigung

7-1	Äuferes.....	225
7-1-1	Reinigung und Desinfektion der Oberflächen	225
7-2	Stuhl	226
7-2-1	Leder.....	226
7-3	Arzteinheit	227
7-3-1	Touchpanel.....	227
7-3-2	Silikonmatte/Handstückauflage.....	227
7-3-3	Griffabdeckung.....	228
7-3-4	AbfallbehälterHolder	229
7-3-5	InstrumentenHolder	229
7-3-6	BT14 3-WEGE-Spritze.....	233
7-3-7	SYR-20 3-WEGE-Spritze.....	235
7-3-8	Typ 77 3-WEGE-Spritze.....	237
7-3-9	Handstückschlauch	239
7-3-10	Ölnebelabscheider.....	249

Inhaltsverzeichnis

7-4	Mundspüleinheit	240
7-4-1	HelperinnenHolder	240
7-4-2	Helperinnen-Schlauchklemme	242
7-4-3	Helperinnen-Silikonmatte	242
7-4-4	Saughandstück und Kleiner Speichersauger-Handstück waschen und sterilisieren..	227
7-4-5	Absaugleitung/Kleiner Speichelsaugerleitung	243
7-4-6	BT14 3-WEGE-Spritze	246
7-4-7	SYR-20 3-WEGE-Spritze	246
7-4-8	Typ 77 3-WEGE-Spritze	246
7-4-9	Sensorfenster für Becherfüller	246
7-4-10	Speischale	247
7-4-11	Feststoffsammler	249
7-4-12	Speischale-Ventil	250
7-4-13	Luftfilter	251
7-4-14	Luftkompressor	251
7-4-15	Absaugpumpe	251
7-5	Batterie aus der Arzteinheit nehmen	252
7-6	Wartung und Überprüfung	254
	Hinweise zur täglichen Wartung und Überprüfung (durch den Benutzer)	254
	Hinweise für die regelmäßige Überprüfung	256
7-7	Abnehmbare Teile	257
7-8	Lagerungsmethode	257
8	Wartung durch Kundendiensttechniker	
8-1	Kundendienst	258
8-2	Lebensdauer	258
8-3	Liefergarantie für Ersatzteile	258
9	Fehlerbehebung	
9-1	Fehlerbehebung	259
9-2	Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen	260
10	Zubehör und Verbrauchsmaterialien	
10-1	Zubehör	263
10-2	Verbrauchsmaterialien	263

1–1 Verwendungszweck des Produktes

Dieses Produkt ist ein aktives Medizinprodukt, das ausschließlich für Diagnosen, Behandlungen und zugehörige Verfahren in der Zahnmedizin vorgesehen ist.

Das Produkt darf nur von qualifizierten Zahnärzten oder zahnärztlichen Mitarbeitern unter der Aufsicht des Zahnarztes bedient oder gehandhabt werden.

Diese Zahnärzte oder zahnärztlichen Mitarbeiter haben die Patienten anzuweisen und/oder dabei zu unterstützen, sich dem Produkt zu nähern und es zu verlassen.

Die Patienten dürfen das Produkt nicht bedienen oder handhaben, es sei denn, er/sie wurde dazu aufgefordert.

Das Produkt wird zusammen mit den Handstücken wie dem elektrischen Mikromotor, der Luftturbine und/oder dem Motor, dem Zahnsteinentfernungsgerät usw. ausgeliefert.

1–2 Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien

Dieses Produkt entspricht der MedizinprodukteRichtlinie (EU) 2017/745, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der RE-Richtlinie 2014/53/EU.

1–3 Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir unter alleiniger Verantwortung, dass das unten aufgeführte Gerät der Richtlinie MDR (EU)2017/745, der RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU nach Kategorie 8 Anhang I und, soweit zutreffend, allen anderen einschlägigen Vorschriften der Union entspricht, die für eine EU-Konformitätserklärung relevant sind.

Produktyp: ZAHNÄRZTLICHE BEHANDLUNGSEINHEIT MIT STUHL
(KLASSE IIa)

Produktbezeichnung: EURUS S8

„KLASSE IIa“ wird durch Regel 9 der Medizinprodukte-Richtlinie Anhang VIII definiert.

Das Produkt wurde so konstruiert und hergestellt, dass es sich in Übereinstimmung mit den in der Konformitätserklärung aufgeführten europäischen Normen befindet.

1–4 Entsorgung des Geräts

Wenn Sie dieses Produkt und die ausgetauschten Teile entsorgen möchten, ergreifen Sie sorgfältig die Maßnahmen zur Infektionsschutz und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften (die geltenden Vorschriften und örtlichen Vorschriften).

In der EU gilt für dieses Produkt die EU-Richtlinie 2012/19/EU (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte [WEEE-Richtlinie]). Ein umweltbewusstes Recycling/eine umweltgerechte Entsorgung ist nach dieser Richtlinie vorgeschrieben.

Nehmen Sie alle Batterien heraus, wenn Sie das Produkt entsorgen. Die Batterien befinden sich im Funken Fußanlasser und in der Arzteinheit.

Je nach Spezifikation ist möglicherweise keine Batterie in der Arzteinheit eingebaut.

Bitte entfernen Sie diese, falls eine vorhanden ist.

[Referenz] Entfernen der Batterie aus der Arzteinheit [Seiten 252, 253]

[Referenz] Austausch der Batterien im Funken Fußanlasser [Seite 148]

1–5 Entsorgung von Rückständen

Beauftragen Sie einen Fachmann damit, Amalgam-Rückstände zu entsorgen.

1–6 Hinweis an den Benutzer und/oder Patienten

Jede schwerwiegende Störung, die im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist, muss an den Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedslandes gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

1–7 Kompatible Handstücke

Wählen Sie ein Handstück aus der Liste kompatibler Handstücke aus. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 38.)

Die Steckverbinder für unseren Handstückschlauch sind nach ISO9168:2009 (ZAHNTECHNIK - SCHLAUCHVERBINDER FÜR DENTALHANDSTÜCKE MIT LUFTANTRIEB) konstruiert und hergestellt. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann es jedoch trotzdem vorkommen, dass die Steckverbinder von Turbinen oder Luftpumpen in manche Handstücke nicht passen. Lassen Sie Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort die Anschlussmöglichkeiten überprüfen, bevor Sie ein Handstück kaufen.

Mit Ausnahme der von uns empfohlenen Handstücke haften wir nicht für Probleme, die sich aus einer mangelnden Anschlussfähigkeit oder ihrer Leistung ergeben.

1–8 Kompatible ZahnarztLicht/Leuchten

Wählen Sie eine ZahnarztLicht/Leuchte aus der Liste der kompatiblen ZahnarztLicht/Leuchten aus.

(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 38.)

1–9 Symbole

Die unten aufgeführten Symbole werden auf diesem Produkt, auf der Beschriftung und in dieser Gebrauchsanweisung verwendet. Prüfen Sie die Bedeutung jedes Symbols.

	Schalter (EIN)		Schalter (AUS)
	Schalter zum Anheben des Stuhls/der Kopfstütze		Schalter zum Senken des Stuhls/der Kopfstütze
	Schalter zum Zurücklehnen der Rückenlehne/Kopfstütze		Schalter zum Anheben der Rückenlehne/Kopfstütze
	Schalter zum Wechseln zum Stuhl/zur Kopfstütze		Schalter zur Rückkehr in die letzte Position
	Automatischer Rückkehrschalter		Voreinstellungsschalter 1
	Voreinstellungsschalter 2		ZahnarztLicht/LeuchtenSchalter EIN/AUS
	Taste für Mundglasfüllung/Durchflussregler		Schalter für Beckenspülung/Durchflussregelung
	Zusatzschalter		Joystick-Schalter für die Kopfstütze (elektrohydraulisch)
	Joystick-Schalter für den manuellen Betrieb		Joystick-Schalter für den automatischen Betrieb
	Service-Steckverbinder für Wasserverwendung		Wasserstrahlsteuerung der Servicekupplung für die Wassernutzung
	Service-Steckverbinder für Luftverwendung		Wasser-/Luftstrahlsteuerung der Spritze
	Wasserstrahlsteuerung für das Handstücksprühen		Wasser aus dem Luftfilter ablassen
	Schutzerde		Funktionserdung
	Vorsicht *Die Grundfarbe ist gelb.		Allgemeines Warnzeichen *Die Grundfarbe ist gelb.

1 Allgemeine Informationen

	Allgemein untersagte Handlungsweise		Die Demontage, Reparatur oder Abänderung ist untersagt
	Anweisungen für die vorgeschriebenen Handlungsweisen im Allgemeinen		Die Gebrauchsanweisung befolgen *Der hier schwarz dargestellte Bereich ist auf dem Aufkleber selbst blau.
	Anwendungsteile des Typs B, die nur die Körperoberfläche des Patienten berühren		Wechselstrom
	Ein Autoklavsymbol zeigt die Teile an, die in einem Autoklaven bei Temperaturen bis 135 °C sterilisiert werden können		USB-Anschluss
	Herstellungsdatum und -land		Seriennummer
	ScHolder zur Auswahl des Patientenspeichers (Erwachsenenmodus)		Seriennummer
	ScHolder zur Auswahl des Patientenspeichers (Senioren-Modus)		Benutzerspeicher umschalten
	ScHolder ZahnarztLicht/ Leuchte EIN		ScHolder ZahnarztLicht/ Leuchte AUS
	Timer-ScHolder		ScHolder Becherfüller EIN
	ScHolder Becherfüller AUS		ScHolder Beckenspülung EIN
	ScHolder Beckenspülung AUS		Funktionstaste
	LichtwechselscHolder		Sensor-/ScHoldermodus
	ScHoldermodus		EIN-Modus
	AUS-Modus		VerriegelungsscHolder (nicht verriegelt)


1 Allgemeine Informationen

	Verriegelungsschalter (verriegelt)		ScHolder Wasserwärmer EIN
	ScHolder Wasserwärmer AUS		Handstück-Nr. aufgenommen
	ScHolder Handstückheizung Hoch		ScHolder Handstückheizung Niedrig
	ScHolder Handstückheizung AUS		Anzeige für Funken Fußanlasser (gekoppelt)
	Anzeige für Funken Fußanlasser (nicht gekoppelt)		Spülstatus für das Handstück (Spülen läuft)
	Seitenwechsel		Spülstatus für Becherfüller und Becken (Spülung läuft)
	Start		Pause
	Abbrechen		Sprühwechselschalter, Luft EIN
	Sprühwechselschalter, Luft AUS		Sprühwechselschalter, Wasser EIN
	Sprühwechselschalter, Wasser AUS		Handstücklichtschalter (EIN)
	Handstücklichtschalter (AUS)		Glockenschalter
	Auswahlschalter (z. B. Helligkeit der HandstückLicht/Leuchte)		Menü anzeigen
	Mikromotor-Drehschalter für normale Drehung (im Uhrzeigersinn)		Mikromotor-Drehschalter für Rückwärtsdrehung (gegen den Uhrzeigersinn)
	Reziprokmodus-Schalter für den Mikromotor		Mikromotor-Drehschalter für den Reziprokmodus
	+/-Schalter		Speichern-Schalter

1 Allgemeine Informationen

	ScHolder für Drehmomentsteuerung		Schiebemode-WechselschHolder Schiebemode Va
	Schiebemode-WechselschHolder Schiebemode Fix		Keine automatische Rückwärtseinstellung
	Automatische Rückwärtseinstellung		Automatische Vorwärts-Einstellung
	ScHolder zur Änderung des Übersetzungsverhältnisses		Home-SchHolder
	RückkehrschHolder		Überspringen-SchHolder
	Namen-RegistrierungsschHolder		Alphanumerischer SchHolder
	Rücktaste		Stuhlvoreinstellung kopieren
	Handstückeinstellung kopieren		Alarmlautstärke
	Berührungs-Balkenleiste		AlarntonSchHolder (aktiv)
	AlarmtonSchHolder (stumm geschaltet)		Art des Alarmtons
	Überhitzungsschutz aktivieren		Anzeige für Stuhlsperre (Stuhl ist verriegelt!)
	Erläuterungsseite		Spülen, Auswaschen der Absaugleitung
	Sauger/Speichelejektor		Anzeige des Reinigers
	Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten		Getrennte Sammlung aller Batterien
	Referenznummer		Autorisierter europäischer Vertreter

1 Allgemeine Informationen

	Autorisierter Vertreter in der Schweiz		Zertifizierung Dritter gemäß Richtlinie über Medizinprodukte: 2017/745
	Name und Adresse des Herstellers		Nenneingang
	Nennspannung		Behandlungsstuhl für Patienten
	Zahnärztliche Behandlungseinheit		Medizinprodukt
	Elektronische Gebrauchsanweisung		<p>① Maximale Aktivierungszeit ② Diskontinuierlicher Betrieb ③ Tastverhältnis</p>
	Implantatsholder		Implantatmotor
	Kochsalzlösungsspülungs-umscHolder EIN		Kochsalzlösungsspülungs-umscHolder AUS
	UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösung Stufe 5		UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösung Stufe 4
	UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösung Stufe 3		UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösung Stufe 2
	UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösung Stufe 1		<p>Wasserzufuhr-UmscHolder für Wasserflasche EIN: Wasserversorgung einschalten AUS: Wasserversorgung stoppen</p>
	Wasserzufuhr-UmscHolder für Wasserflasche DRÜCKEN: Wasserversorgung einschalten ZIEHEN: Wasserversorgung stoppen		<p>Wasserzufuhr-UmscHolder DRÜCKEN: Wasserversorgung aus Wasserleitung ZIEHEN: Wasserversorgung aus Wasserflasche</p>

 CLOSE	Hauptwasserventil ist geschlossen	 OPEN	Hauptwasserventil ist offen
 Spülung		 Timer-ScHolder für Spülung	
 Spüleinstellungen		 ModussHolder für Handstück	
 Spülmodusschalter für Becherfüller		 SpülmodussHolder für Becherfüller, Speischale	
 Spülstatus für den Becherfüller (Spülen läuft)			

1–10 Technische Beschreibung

Im Folgenden sind die unten aufgeführten Dokumente erläutert:

Punkt	Dokument
Installation dieses Produktes	Installationsanweisungen Anweisungen vor der Installation
Verkabelung/Sanitärinstallation	Installationsanweisungen

Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

2-1 Auslegung der Risikostufe

Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb sorgfältig gelesen haben und das Produkt ordnungsgemäß verwenden.

Diese Sicherheitsvorkehrungen sind dafür vorgesehen, eine sichere Verwendung des Produktes zu gewährleisten und eine Beschädigung oder Verletzung der Benutzer oder Dritter zu vermeiden.

In Abhängigkeit vom Ausmaß der Beschädigung und Verletzung und vom Grad der Gefahr ist ein Vorfall, der durch die fehlerhafte Verwendung des Produktes entstehen kann, in eine der folgenden Kategorien eingestuft: GEGENANZEIGE, WARNUNG und VORSICHT.

Alle diese Kategorien sind für die Sicherheit wichtig. Befolgen Sie stets die aufgeführten Anweisungen.

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für Unfälle, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen oder Bedienungsanweisungen entstehen, auch im Fall einer Beschädigung oder Verletzung der Benutzer oder anderer Personen.

In diesem Fall sind die Benutzer oder anderen Personen, die das Produkt verwenden, ohne die Sicherheitsvorkehrungen und Bedienungsanweisungen zu beachten, für alle auftretenden Beschädigungen oder Verletzungen verantwortlich.

Die grafischen Symbole werden nachfolgend ausführlich erläutert.

Wenn Sie diese Erläuterung vollständig verstanden haben, lesen Sie den Text.

Klassifizierung nach dem Grad der Verletzung oder Beschädigung und der Dringlichkeit

GEGENANZEIGE

Die Verwendung des Produktes unter Missachtung der hier angegebenen Anweisungen führt zu einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder einer schweren Verletzung führen kann.

WARNUNG

Die unsachgemäße Verwendung des Produktes unter Missachtung der hier angegebenen Anweisungen führt zu einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder einer schweren Verletzung führen kann.

VORSICHT

Die unsachgemäße Verwendung des Produktes unter Missachtung der hier angegebenen Anweisungen führt zu einer potenziell gefährlichen Situation, die zu einer mittelschweren oder leichten Verletzung oder Sachbeschädigung führen kann.

Die folgenden grafischen Symbole werden verwendet, um Ihre Pflichten für die sichere Verwendung des Produktes zu erläutern:

Grafisches Symbol für eine untersagte Handlungsweise



Allgemein untersagte Handlungsweise



Die Demontage, Reparatur oder Abänderung ist untersagt

Grafisches Symbol für verbindliche Anweisungen



Anweisungen für die vorgeschriebenen Handlungsweisen im Allgemeinen

2–2 Sicherheitsvorkehrungen

GEGENANZEIGE

Installation und Umsetzung des Produktes



Verwendung und Wartung des Produktes



Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Quellen elektromagnetischer Strahlung, wie zum Beispiel Kommunikationseinrichtungen oder Fahrstühlen. Durch die Anwesenheit störender elektromagnetischer Wellen kann eine Fehlfunktion dieses Produktes auftreten.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosiven Umgebung (z. B. in der Nähe von entzündlichen Gasen).

Die unsachgemäße Verwendung in einer solchen Umgebung kann zu einer Verletzung oder einem Feuer führen.

Seien Sie bei der Anwesenheit elektromagnetischer Wellen vorsichtig.

Verwenden Sie in der Nähe dieses Produkts keine Geräte, die elektromagnetische Wellen erzeugen, wie zum Beispiel Mobiltelefone.

Das kann zu einer Fehlfunktion dieses Produktes führen.

Schalten Sie stets den HauptscHolder des Produktes aus, wenn Sie hochfrequente chirurgische Geräte verwenden.

Schalten Sie stets den HauptscHolder aus, wenn Sie hochfrequente chirurgische Geräte verwenden, da die vom hochfrequenten chirurgischen Gerät erzeugte Störung zu einer Fehlfunktion dieses Produktes führen kann.

Zerlegen oder reparieren das Produkt nicht und ändern Sie es nicht ab.

Niemand anderes als Ihr autorisierter Belmont-Händler vor Ort darf dieses Produkt zerlegen oder reparieren.

Dies kann zu einem Unfall, einer Fehlfunktion, einem Stromschlag oder Feuer führen.

Ändern Sie das Produkt niemals ab, da dies sehr gefährlich ist.



WARNUNG

Installation und Umsetzung des Produktes



Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Beauftragen Sie Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort mit der Installation des Produktes.

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt auf einem festen und ebenen Untergrund aufgestellt wird.

Wenn Sie das Gerät auf einem unebenen Untergrund aufstellen, kann es umfallen.

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt sicher geerdet ist. (Lassen Sie das Produkt von einem Fachmann erden.)

Eine fehlerhafte Erdung oder elektrisch undichte Stelle kann zu einem Stromschlag führen.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an eine Versorgungsnetz mit Schutzerde angeschlossen werden.

Verwendung und Wartung des Produktes



Halten Sie die beweglichen Teile des Produktes von den Händen, Fingern und Körpern der Patienten und Benutzer fern.
Die Hände, Finger oder der Körper können sich im Produkt verfangen, was zu einer Verletzung führt.

Der Patient darf nicht auf seinem/ihrem Bauch liegen, im Kniestütz sitzen (mit seinem/ihrem Gesäß auf seinen/ihren Fersen) oder mit einem Kind in seinen/ihren Armen auf dem Produkt sitzen.

Der Stuhl kann sich unerwartet bewegen und eine Verletzung verursachen.

Der Patient darf sich nicht auf den Rand des Sitzes setzen.

Der Stuhl kann umfallen oder sich unerwartet bewegen, was zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führt.

Die Patient darf sich nicht auf eine andere Stelle als die vorgesehene Stelle setzen.

Auf das Produkt darf keine übermäßige Last aufgetragen werden.

Der Patient darf sich nicht auf die Kopfstütze, Armlehne oder Rückenlehne setzen.

Das kann zu einer Verletzung durch Herunterfallen oder zu einer Beschädigung der Peripheriegeräte führen.

Es darf keine übermäßige Last auf den Arzt- oder Helferinnenarm ausgeübt werden.

Der Patient darf sich nicht auf den Arzt- oder Helferinnenarm setzen.

Das kann zu einer Verletzung durch Herunterfallen oder zu einer Beschädigung der Peripheriegeräte führen.

Es darf keine Last auf den Arzttisch ausgeübt werden, die die Gewichtsgrenze (3 kg) überschreitet.

Dies kann zu einer Beschädigung oder Verletzung führen.

Eine Last, die die Gewichtsgrenze (1,5 kg) überschreitet, darf nicht auf die Nebenablage des Arzttisches (Stange) ausgeübt werden.

Dies kann zu einer Beschädigung oder Verletzung führen.

Es darf keine Last auf die Helferinnenablage ausgeübt werden, die die Gewichtsgrenze (1,5 kg) überschreitet.

Dies kann zu einer Beschädigung oder Verletzung führen.

⚠️ **WARNUNG**

Verwendung und Wartung des Produktes



Waschen Sie das Produkt nicht mit Wasser.


Dass kann zu einer Fehlfunktion oder einem Stromschlag führen.

Zu beachtende Punkte, wenn ein Patient auf dem Stuhl sitzt
Weisen Sie den Patienten an, sich wie in der Abbildung gezeigt auf den Stuhl zu setzen.



Achten Sie darauf, dass der Patient die in der Abbildung gezeigte Körperhaltung einnimmt, bevor Sie den Stuhl bedienen.



Der Patient sollte seine Hände ineinanderlegen.



Der Patient sollte seine Füße nebeneinander legen.



Überzeugen Sie sich bei einem kleinen Kind davon, dass das Gesäß sich im Sitz befindet, bevor Sie die Rückenlehne aufrichten.

Das Kind kann nach unten rutschen, wenn der Stuhl sich bewegt, was zu Verletzungen führen kann.

Achten Sie auf die Patienten und Kinder.

Behalten Sie den Patienten im Auge, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Patienten (vor allem Kinder) können den SteuercHolder oder das System versehentlich berühren, was zu einem Unfall durch eine Fehlfunktion des Produktes führen kann.

Halten Sie Kinder von diesem Produkt fern, außer wenn Sie sie behandeln.

Verwendung und Wartung des Produktes



WARNUNG

Vorsichtsmaßnahmen beim Besteigen und Verlassen des EURUS

Wenn der Patient den EURUS besteigt oder verlässt, sollte der Stuhl immer in der niedrigsten Position sein und alle Bedienvorgänge müssen mit dem SperrscHolder verriegelt sein.

Bevor ein Patienten aus einem Rollstuhl in den EURUS gesetzt wird oder umgekehrt, achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse (z. B. die Fußanlasser) in der Nähe des Rollstuhls oder des Betreuers befinden. Der Kontakt der Füße oder der Laufrollen des Rollstuhls mit den Hindernissen (wie zum Beispiel den Fußanlasseren) kann zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führen.

Wenn der Patient von einem Rollstuhl auf den EURUS gesetzt wird oder umgekehrt, muss er/sie sorgfältig beobachtet werden, damit er/sie nicht stürzt.

Wenn der Patient wegen eines Stromausfalls oder in einem Notfall den EURUS an einer anderen Stelle als der für das Besteigen und Verlassen des EURUS vorgesehenen Position verlassen muss, muss er/sie sorgfältig beobachtet werden, damit er/sie nicht stürzt.

Entfernen Sie vor der Behandlung die Brille und Accessoires des Patienten (wie zum Beispiel eine Halskette oder Armbänder).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann die Behandlung behindern und zu einem Unfall führen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufrichten/Zurücklehnen der Rückenlehne

Achten Sie vor dem Zurücklehnen der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen der Rückenlehne und dem Sitz eingeklemmt werden.

Achten Sie vor dem Aufrichten der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen der Rückenlehne und der Armlehne eingeklemmt werden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb des Stuhls und automatischen Betrieb

Achten Sie vor und während der Stuhlbedienung besonders auf den Arbeitsbereich (Richtung des Anhebens/Absenkens des Sitzes und Richtung des Zurücklehrens/Aufrichtens der Rückenlehne) und achten Sie darauf, dass der Stuhl nicht in Kontakt mit irgendwelchen Körperteilen, Händen, Füßen oder Hindernissen gerät. Körperteile, Hände oder Füße oder Gegenstände können im Stuhl eingefangen werden, was zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führt.

Vergewissern Sie sich vor der Bedienung des Stuhls, dass der Patient in der richtigen Position sitzt und beobachten Sie ihn/sie, wenn Sie den Stuhl verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Kopfstütze (manuell)

Achten Sie bei der Bedienung der Kopfstütze darauf, dass sich Ihre Finger nicht im Steuerhebel verfangen oder zwischen der Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt werden.

WARNUNG

Verwendung und Wartung des Produktes



Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Kopfstütze (elektrohydraulisch)

Vergewissern Sie sich vor der Bedienung der Kopfstütze, dass der Patient in einer normalen Position sitzt und beobachten Sie ihn/sie, wenn Sie den Stuhl verwenden.

[Referenz] Zu beachtende Punkte, wenn ein Patient auf dem Stuhl sitzt [Seite 20]

Wenden Sie die Kopfstütze nicht in einem Winkel an, bei dem der Patient Schmerzen hat.

Überzeugen Sie sich vor der Bedienung der Kopfstütze davon, dass keine Hindernisse im Bereich der Kopfstütze vorhanden sind und achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände zwischen Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt werden.

Wenn die Rückenlehne bei sitzendem Patienten zurückgelehnt ist, bewegen Sie die Kopfstütze nicht mit dem Kopf des Patienten darauf hoch oder runter.

Achten Sie auf die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Verwendung der Funken Fußanlasser.

Wenn sich mehr als ein EURUS auf demselben Boden befindet, bedienen Sie nicht den Funken Fußanlasser für das andere Produkt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung eines Mikromotors (NBX, NLXplus, NLX nano) mit Hitzeschutzfunktion

Wenn die Hitzeschutzfunktion aktiviert ist, schalten Sie nicht den Hauptschalter ein, um das Gerät aus- und wieder einzuschalten oder den Betrieb fortzusetzen. Der Mikromotor kann Wärme erzeugen und Verbrennungen oder Schäden am Motor verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Anbringen der Düse (Spritze)

Wird die Spritze mit nicht sicher angebrachter Düse verwendet, kann diese beim Spritzen von Wasser oder Luft herausschießen und die Benutzer oder andere Personen verletzen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Düse sicher angebracht ist.

[Seiten 233, 236 und 238]

Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Spritze auf den Boden fällt (Spritze)

Wenn die Spritze auf den Boden gefallen ist, überzeugen Sie sich von der einwandfreien Funktion der Spritze. Wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab, das mit dem Desinfektionsmittel FD366 von Dürr befeuchtet ist. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn sich eine scharfe Kante an der Düse oder am Spritzenkörper befindet, wenden Sie sich daher an Ihren autorisierten Belmont-Händler und benutzen Sie das Produkt nicht mehr.

Entwicklung von subkutanen Emphysemen

Die Kühlluft (alleine oder gesprührt) wird vom Chip des Handstücks (Mikromotor und Luftpumpe/Motor) abgegeben. Dies kann dazu führen, dass der Patient subkutane Emphyseme entwickelt, verwenden Sie daher die Kühlung vorsichtig.

Verwendung und Wartung des Produktes



WARNUNG

Achten Sie besonders auf einen Patienten, der einen **Herzschriftmacher oder Defibrillator** implantiert hat.

Wenn etwas Ungewöhnliches auftritt, schalten Sie sofort den HauptscHolder aus und beenden Sie die Verwendung des Produktes.

EURUS kann die Funktion des Herzschrittmachers oder Defibrillators beeinflussen und einen Unfall verursachen.

Verbot der Verwendung dieses Geräts neben oder auf anderen elektronischen Geräten

Die Verwendung dieses Geräts neben oder auf einem anderen Gerät ist zu vermeiden, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann. Wenn eine solche Verwendung unerlässlich ist, sind dieses Gerät und das andere Gerät zu beobachten, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

Verbot des Anbringens tragbarer

Hochfrequenzkommunikationsgeräte neben diesem Produkt

Tragbare Hochfrequenzkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräten wie zum Beispiel Antennenkabel und externe Antennen) dürfen nicht näher als 30cm (12 Zoll) zu allen Teilen des EURUS verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller vorgeschriebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit dieses Geräts kommen.

Wischen Sie sofort verschüttetes Wasser oder auf den Boden ausgelaufene Flüssigkeit auf.

Eine verringerte Tragfähigkeit des Bodens kann dazu führen, dass das Gerät umfallen kann, was zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führt.

Reinigen Sie das Produkt sorgfältig.

Eine schlechte Reinigung kann zum Wachstum von Bakterien führen und eine Gesundheitsgefahr darstellen.

Siehe den Abschnitt Reinigungsverfahren auf den Seiten 225 bis 251.

Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Wartung.

Die Verwendung des Produktes ohne Wartung kann zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führen.

Siehe den Abschnitt Wartungsinformationen auf den Seiten 254 bis 256.

Stellen Sie die Verwendung des Produktes ein, wenn es defekt ist.

Stellen Sie im Fall eines defekten Produktes sofort die Verwendung ein und schalten Sie den HauptscHolder aus. Beauftragen Sie dann Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort mit der Reparatur des Produktes.

Schalten Sie den HauptscHolder während der Reinigung aus.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu einem Stromschlag oder einer Entzündung führen. Das Produkt kann sich außerdem unerwartet bewegen und eine Verletzung verursachen.

Bei einem Stromausfall zu ergreifende Maßnahmen

Schalten Sie den HauptscHolder aus und stecken Sie das Handstück/die Spritze in den InstrumentenHolder/HelperinnenHolder, um eine Fehlfunktion des Produktes nach der Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden.

WARNUNG

Verwendung und Wartung des Produktes



Schalten Sie stets den SchutzscHolder für die Geräte aus, wenn Sie das Produkt für einen langen Zeitraum nicht verwenden.

Stellen Sie sicher, dass der SchutzscHolder für die Geräte in einer Klinik ausgeschaltet ist, wenn das Produkt aus Gründen, wie zum Beispiel Schließungszeit und Tag ohne Behandlungen, längere Zeit nicht verwendet wird. Wenn Sie den SchutzscHolder nicht ausgeschaltet haben, kann durch den wegen Verschlechterung der Isolierung austretenden Strom ein Brand entstehen.

VORSICHT

Verwendung und Wartung des Produktes



Lassen Sie nicht zu, dass sich eine Person auf den Sitz setzt, die die Gewichtsgrenzen überschreitet.

Der Stuhl kann umfallen oder eine Fehlfunktion kann auftreten.

[Referenz] Gewichtsgrenze

4 Produktspezifikationen, 4-1 Technische Daten [Seite 44]

Schlagen Sie nicht auf das Produkt und reiben Sie es nicht ab.
Das kann zu einer Beschädigung der Abdeckung oder einer Fehlfunktion führen.

Verwenden Sie nur die von Belmont vorgeschriebene Batterie für den Funken Fußanlasser.

Verwenden Sie neue und alte Batterien nicht zusammen und verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen (z. B. Alkali-Mangan- und Nickel-Wasserstoff-Batterien). Ein unsachgemäßes Gebrauch der Batterien kann zum Auslaufen oder Platzen der Batterie führen.

Berühren Sie die ausgelaufene Batterieflüssigkeit nicht.

Der Kontakt von Batterieflüssigkeiten mit den Augen kann zur Erblindung führen. Sofort mit sauberem Wasser Spülung, ohne zu reiben, und unverzüglich einen Arzt konsultieren.

Der Kontakt von Batterieflüssigkeiten mit der Haut kann zu Hauterkrankungen führen, daher sofort mit sauberem Wasser abspülen.



Stellen Sie sicher, dass alle Teile normal funktionieren und Sie keine Abweichungen erkannt haben, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie das Produkt stets auf ungewöhnliche Feststellungen, wie zum Beispiel lose Bauteile, Spiel, Neigung, Schwingungen, Geräusche, ungewöhnliche Temperatur oder schlechte Gerüche.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht in Ordnung ist, beenden Sie sofort die Verwendung des Produktes und schalten Sie den HauptscHolder aus. Wenden Sie sich dann an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Lesen Sie die Begleitdokumente für jedes Gerät.

Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass Sie die mitgelieferte Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen haben, und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß.

Betätigen Sie die ScHolder stets mit der Hand.

Betätigen Sie die ScHolder stets mit der Hand, außer der Fußanlasser, die mit dem Fuß betätigt wird, und den Joystick-ScHoldern. Wenn Sie die ScHolder nicht mit der Hand betätigen, kann dies zu einer Beschädigung oder Fehlfunktion führen.

Betätigen Sie die ScHolder vorsichtig, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.

Der Bediener hat sorgfältig auf die Menschen in der Nähe des Produktes zu achten und die Bedienung anzukündigen, um Fehler zu vermeiden.

Ziehen Sie vor der ersten Anwendung die Folie vom Touchpanel ab

Die Verwendung des Touchpanels mit aufgeklebter Folie kann zu Fehlfunktionen führen und Verletzungen verursachen.

VORSICHT

Verwendung und Wartung des Produktes



Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung des Touchpanels

Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion des Touchpanels Ethanol. Die Verwendung anderer Desinfektionsmittel kann zu fehlerhafter Funktion und zu Verletzungen führen.

Wischen Sie Wasser und Reinigungsmittel immer ab. Sonst kann es zu Funktionsstörungen, Defekten, und im Ergebnis zu Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verstellen der Arzteinheit

Beobachten Sie aufmerksam die Umgebung, während die Arzteinheit verstellt wird. Der Kontakt mit der Spitze des Handstücks kann zu Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Wagens

Wenn Sie den Wagen innerhalb des Verstellbereichs des Stuhls verwenden, achten Sie darauf, dass er nicht mit der Person auf dem Stuhl oder dem Stuhl kollidiert. Der Kontakt mit der Spitze des Handstücks kann zu Verletzungen führen.

Setzen oder lehnen Sie sich nicht auf den Wagen. Treten Sie nicht auf das Wagengestell oder den Wagenschlauch.

Andernfalls kann der Schlauch beschädigt werden oder der Wagen kann umfallen und Verletzungen verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Handstücks

Bei Wärmeentwicklung oder brenzligem Geruch beenden Sie sofort die Verwendung des Handstücks, schalten Sie den NetzschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.


Dies kann zu Verbrennungen führen oder einen nachteiligen Einfluss auf das Zahnmärk haben.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung eines Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts

Setzen Sie nach dem Gebrauch die vorgesehene Abdeckung (falls vorhanden) wieder auf die Zahnsteinentfernungsgerät-Spitze auf und stecken Sie ihn in einen InstrumentenHolder. Der Kontakt mit der Spitze des Zahnsteinentfernungsgeräts kann zu Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung einer speziellen Funktion für NLXplus/MX2

Wenn eine Feile in Form einer Schraube mit Linksgewinde angebracht ist, wählen Sie immer „Keine automatische Rückwärtsfunktion“ aus und ändern Sie die Drehrichtung mit dem Mikromotor-DrehscHolder. Wenn NLXplus/MX2 mit ausgewählter „Automatischer Rückwärtsfunktion/Automatischer Vorwärtsfunktion“ verwendet wird, wird die Feile beschädigt, was zu Verletzungen führt.

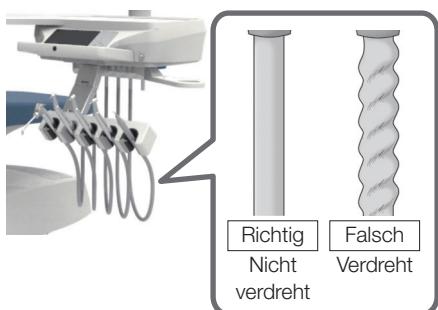

Verwenden Sie das Handstück nicht, wenn sein Schlauch verdreht ist

Wiederholtes Aufnehmen und Zurücksetzen des Handstücks kann dazu führen, dass sich der Schlauch verdreht.

Prüfen Sie den Schlauch regelmäßig, um sicherzustellen, dass er nicht verdreht ist. Wenn er verdreht ist, entfernen Sie die Verwicklung vor dem Gebrauch. Die kontinuierliche Verwendung des Handstücks mit verdrehtem Schlauch führt dazu, dass Knicke im Schlauch entstehen oder der Draht bricht und das Handstück somit unbrauchbar wird.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Drehung der Armlehne

Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse rings um die Armlehne befinden und die Finger nicht in der Armlehne eingeklemmt werden.

Bedienen Sie den Stuhl nicht, wenn die Armlehne verdreht ist. Stellen Sie die Armlehne in ihre ursprüngliche Position zurück, bevor Sie den Stuhl bedienen.

VORSICHT

Verwendung und Wartung des Produktes



Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung einer MonitorHolderung

Üben Sie keine übermäßige Last auf den Monitor oder die MonitorHolderung aus. Montieren Sie keinen Monitor, der die unten aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Größe: Bis zu 340 x 530 mm (L x B)
[22-Zoll- oder kleinerer Monitor]

Gewicht: Bis zu 6,5 kg

*Ausgenommen Abmessungen des Monitorgriffs und anderer Zubehörteile

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Batterien

Nehmen Sie die Batterie aus dem Funken Fußanlasser, wenn er länger als eine Woche nicht gebraucht wird.

Schalten Sie den HauptscHolder aus, während die Batterie gewechselt wird. Wenn das nicht geschieht und ein SchHolder oder Pedal versehentlich gedrückt wird, führt das zu einer falschen Funktion des Produkts und kann Personen- oder Sachschäden verursachen.

Ziehen Sie die Reinigungshandschuhe an, wenn Sie das Speischale abnehmen.

Das Speischale besteht aus Keramik und kann bei Zerbrechen Verletzungen verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen für den Umbau von Rechts- auf Linkshänder-Ausführung

Lesen Sie bitte die Seiten 160 - 167, dort finden Sie Anweisungen für den Umbau von Rechts- auf Linkshänder-Ausführung.

Wenn der Umbau durchgeführt wird, ohne sie zu lesen, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

Achten Sie darauf, dass der Arzttisch während des Umbaus nicht gegen das Speischale stößt.

Achten Sie darauf, dass während des Umbaus der Absaug- und der Kleiner Speichelsaugerschlauch nicht zwischen dem Helferinnenarm und dem Schwenkarm des Speischales eingeklemmt werden.

Wischen Sie alle am Produkt anhaftenden chemischen Lösungen oder das am Produkt anhaftende Wasser sofort ab.

Die am Produkt anhaftenden chemischen Lösungen oder das am Produkt anhaftende Wasser können zu einer Fehlfunktion oder elektrisch undichten Stellen führen. Wenn chemische Lösungen oder Wasser am Produkt anhaften, schalten Sie sofort den HauptscHolder aus und wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Schließen des Hauptwasserventils am Tagesende.

Achten Sie darauf, das Hauptwasserventil am Ende des Tages zu schließen, um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden.

Schalten Sie den HauptscHolder zum Feierabend oder in einer Pause aus.

Eine Fehlfunktion durch den Kontakt mit EURUS führt zu einer Beschädigung oder Verletzung.

Reinigen und sterilisieren Sie die HVE-Spitze und die Spritzendüse vor dem Gebrauch.

HVE-Spitzen und Spritzendüsen, die mit dem Mundgewebe in Kontakt kommen, sind bei der Lieferung nicht sterilisiert.

Vor Gebrauch müssen sie gereinigt und sterilisiert werden.

Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Wasserqualität



Benötigte Zeit für Standardspülungen der Wasserleitungen des Geräts

VORSICHT

Führen Sie vor der Behandlung eine Spülung durch.

Wenn dieses Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird, kann das in den Kanälen und im Wasserwärmer verbliebene Wasser für Bakterienwachstum anfällig sein. Um eine sichere Behandlung zu gewährleisten und das Handstück ohne Probleme zu bedienen, vergessen Sie niemals, die Wasserleitungen vor Beginn der Behandlung zu spülen (zu entleeren).

Es wird empfohlen, nach den morgendlichen und abendlichen Behandlungen jeweils eine Spülung mit frischem Wasser für mindestens 2 Minuten und 40 Sekunden durchzuführen (kann je nach Wasserqualität variieren), um Bakterienwachstum zu vermeiden.


Spülwasserkreisläufe von Handstücken	40 Sekunden bis 2 Minuten 40 Sekunden
Luftturbine/Mikromotor/ Luftmotor/Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät/ Spritze	
Befüllen der Wasserkreisläufe der Handstücke mit chemischer Lösung Befüllen der Wasserkreisläufe des Becherfüllers mit chemischer Lösung	30 Sekunden bis 10 Minuten
Luftturbine/Mikromotor Luftmotor/Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät Spritze + Becherfüller	20 Sekunden bis 5 Minuten
	10 Sekunden bis 5 Minuten
Wasserkreisläufe der Handstücke spülen Wasserkreisläufe von Becherfüller und Speischale spülen	5 Minuten 20 Sekunden bis 10 Minuten
Luftturbine/Mikromotor/ Luftmotor/Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät/ Spritze + Becherfüller Beckenspülung	2 Minuten 40 Sekunden bis 5 Minuten
Ausführung ohne Speischale Wasserkreisläufe der Handstücke spülen (Kurzmodus)	2 Minuten 40 Sekunden bis 5 Minuten
Ausführung ohne Speischale Wasserkreisläufe der Handstücke spülen (Langmodus)	40 Sekunden bis 2 Minuten 40 Sekunden
Absaugleitung spülen	2 Minuten 40 Sekunden bis 5 Minuten
Absaugleitung mit Reiniger auswaschen	4 Minuten
Absaugleitung spülen + Absaugleitung mit Reiniger auswaschen	8 Minuten

Benötigte Zeit für ein Standard-Auswaschen der Absaugleitung

[Referenz] Auswahl und Durchführung des Spülverfahrens
[Seiten 171 bis 190]

Bei der Verwendung des Produktes zu beachtende Punkte

BodenplatteHolderung

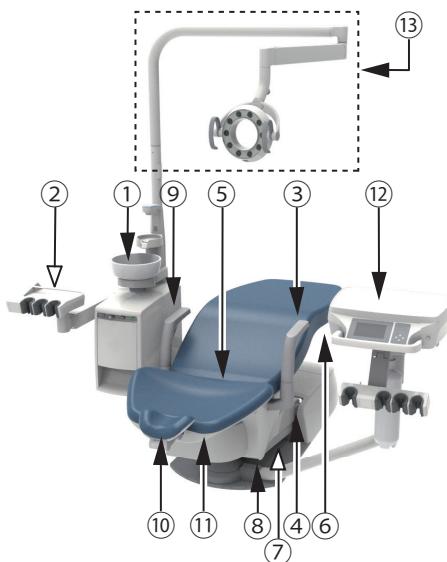


Bedeutung eines Symbols

- Zu beachtender Punkt
(Stellen, die zu beachten sind, einschließlich der beweglichen Teile, drehbaren Teile und abnehmbaren Teile)
- Zu beachtende Punkte, wo ein Not-Aus-Mechanismus verfügbar ist


Bedeutungen der zu beachtenden Punkte

- ① Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem Speischale zu vermeiden.
Halten Sie das Speischale entfernt von Armlehne und Patient, wenn es zur Seite des Stuhls gedreht wird.
- ② Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem HelferinnenHolder zu vermeiden.
Der Oberkörper des Patienten sollte sich nicht nach vorn über die Mundspülleinheit lehnen.
- ③ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Armlehne eingeklemmt werden (wenn sie sich dreht).
Bedienen Sie den Stuhl nicht, wenn die Armlehne verdreht ist.
- ④ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Armlehne eingeklemmt werden (wenn der Stuhl abgesenkt wird).
Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände auf die ArmlehnensHolderung, wenn der Stuhl abgesenkt wird.
- ⑤ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in den beweglichen Teilen der Rückenlehne eingeklemmt werden.
Klemmen Sie Ihre Hände oder Füße nicht zwischen die Rückenlehne und den Sitz.
- ⑥ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Unterseite des Sitzes eingeklemmt werden.
Legen Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Unterseite des Sitzes.
- ⑦ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in der Hintere Stuhlabdeckung eingeklemmt werden.
Stellen Sie keine Körperteile oder Gegenstände zwischen die Hintere Stuhlabdeckung und die Bodenplatte.
- ⑧ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in der Flanschabdeckung eingeklemmt werden.
Stellen Sie keine Körperteile oder Gegenstände zwischen die Flanschabdeckung und die Bodenplatte.
- ⑨ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände zwischen dem Speischale und dem Stuhl eingeklemmt werden.
Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Stuhls darauf, dass sich keine Hände, Füße oder Hindernisse zwischen dem Speischale und dem Stuhl befinden.
- ⑩ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände im beweglichen Teil der Kopfstütze eingeklemmt werden.
Achten Sie darauf, dass Ihre Finger und Haare nicht im beweglichen Teil der Kopfstütze eingeklemmt werden.
- ⑪ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Rückenlehne zu vermeiden.
Achten Sie vor der Bedienung der Rückenlehne darauf, dass sich keine Hindernisse in der Nähe der Rückenlehne befinden.
- ⑫ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit der Arzteinheit zu vermeiden.
Bringen Sie die Arzteinheit nicht in den Verstellbereich des Stuhls.
- ⑬ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Licht/Leuchte zu vermeiden.
Die Licht/Leuchte sollte nicht in der Nähe von Personen oder Hindernissen in der Umgebung Placeiert werden.
- ⑭ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit dem Wagen zu vermeiden.
Bringen Sie den Wagen nicht in den Verstellbereich des Stuhls.

Wagen

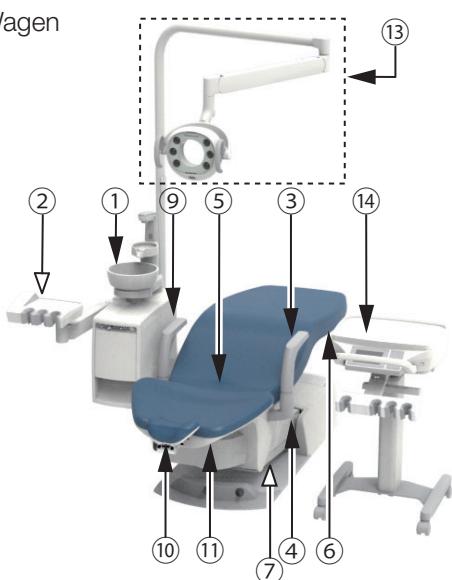

SchwenkHolderung

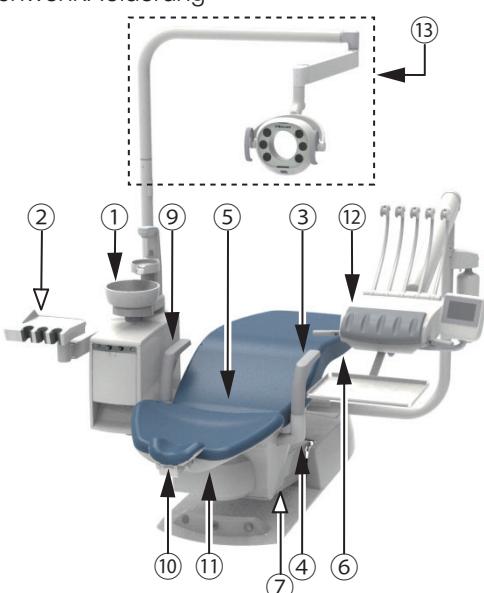


WARNUNG


Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände in die Nähe der beweglichen Teile, wenn Sie den Stuhl bedienen. Dies kann eine Verletzung verursachen.

2 Sicherheitstechnische Betrachtung


BodenplatteHolderung
Vac Pac

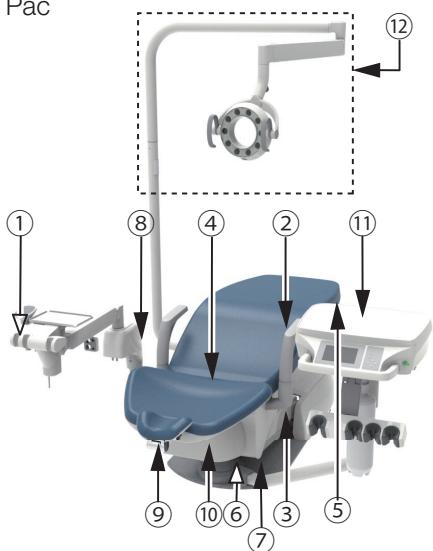

Wagen
Vac Pac

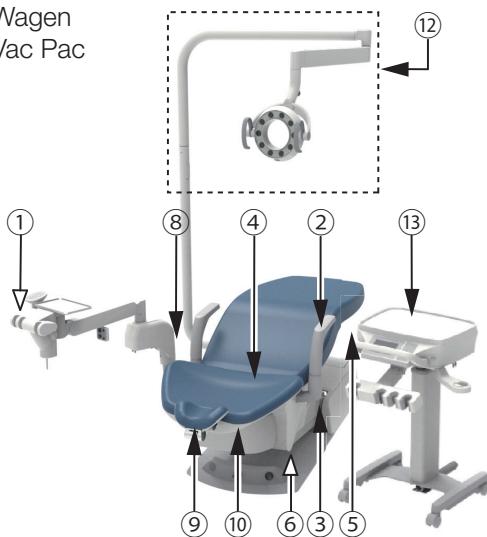

SchwenkHolderung
Vac Pac

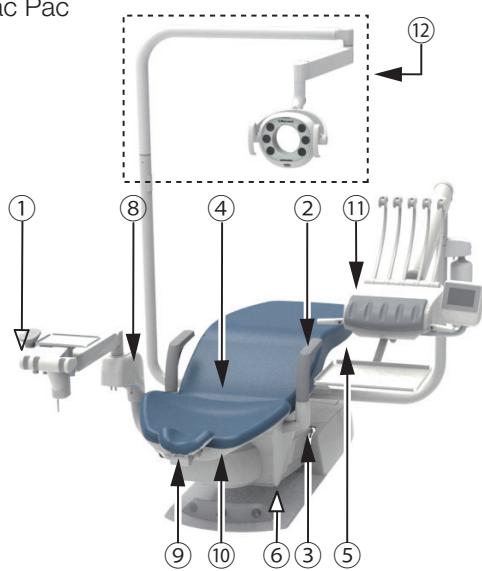


Bei der Verwendung des Produktes zu beachtende Punkte

Bedeutung eines Symbols



Zu beachtender Punkt

(Stellen, die zu beachten sind, einschließlich der beweglichen Teile, drehbaren Teile und abnehmbaren Teile)



Zu beachtende Punkte, wo ein Not-Aus-Mechanismus verfügbar ist

Bedeutungen der zu beachtenden Punkte

- ① Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem HelferinnenHolder zu vermeiden.
Der Oberkörper des Patienten sollte sich nicht nach vorn über die Mundspüleinheit lehnen.
- ② Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Armlehne eingeklemmt werden (wenn sie sich dreht).
Bedienen Sie den Stuhl nicht, wenn die Armlehne verdreht ist.
- ③ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Armlehne eingeklemmt werden (wenn der Stuhl abgesenkt wird).
Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände auf die ArmlehnenHolderung, wenn der Stuhl abgesenkt wird.
- ④ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in den beweglichen Teilen der Rückenlehne eingeklemmt werden.
Klemmen Sie Ihre Hände oder Füße nicht zwischen die Rückenlehne und den Sitz.
- ⑤ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Unterseite des Sitzes eingeklemmt werden.
Legen Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Unterseite des Sitzes.
- ⑥ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in der Hintere Stuhlabdeckung eingeklemmt werden.
Stellen Sie keine Körperteile oder Gegenstände zwischen die Hintere Stuhlabdeckung und die Bodenplatte.
- ⑦ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in der Flanschabdeckung eingeklemmt werden.
Stellen Sie keine Körperteile oder Gegenstände zwischen die Flanschabdeckung und die Bodenplatte.
- ⑧ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände zwischen dem Vac Pac und dem Stuhl eingeklemmt werden.
Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Stuhls darauf, dass sich keine Hände, Füße oder Hindernisse zwischen dem Speischale und dem Stuhl befinden.
- ⑨ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände im beweglichen Teil der Kopfstütze eingeklemmt werden.
Achten Sie darauf, dass Ihre Finger und Haare nicht im beweglichen Teil der Kopfstütze eingeklemmt werden.
- ⑩ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Rückenlehne zu vermeiden.
Achten Sie vor der Bedienung der Rückenlehne darauf, dass sich keine Hindernisse in der Nähe der Rückenlehne befinden.
- ⑪ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit der Arzteinheit zu vermeiden.
Bringen Sie die Arzteinheit nicht in den Verstellbereich des Stuhls.
- ⑫ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Licht/Leuchte zu vermeiden.
Die Licht/Leuchte sollte nicht in der Nähe von Personen oder Hindernissen in der Umgebung Placeiert werden.
- ⑬ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit dem Wagen zu vermeiden.
Bringen Sie den Wagen nicht in den Verstellbereich des Stuhls




WARNING

Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände in die Nähe der beweglichen Teile, wenn Sie den Stuhl bedienen. Dies kann eine Verletzung verursachen.

2 Sicherheitstechnische Betrachtung


2-3 Stellen, an denen Vorsichtsaufkleber angebracht sind

BodenplatteHolderung

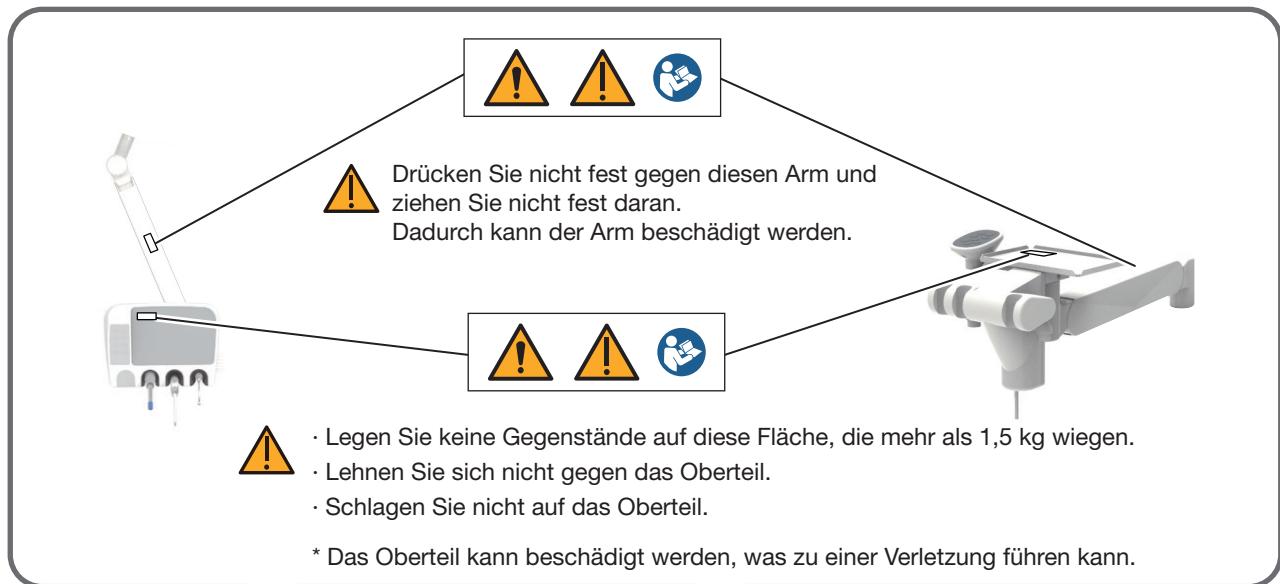


2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Wagen

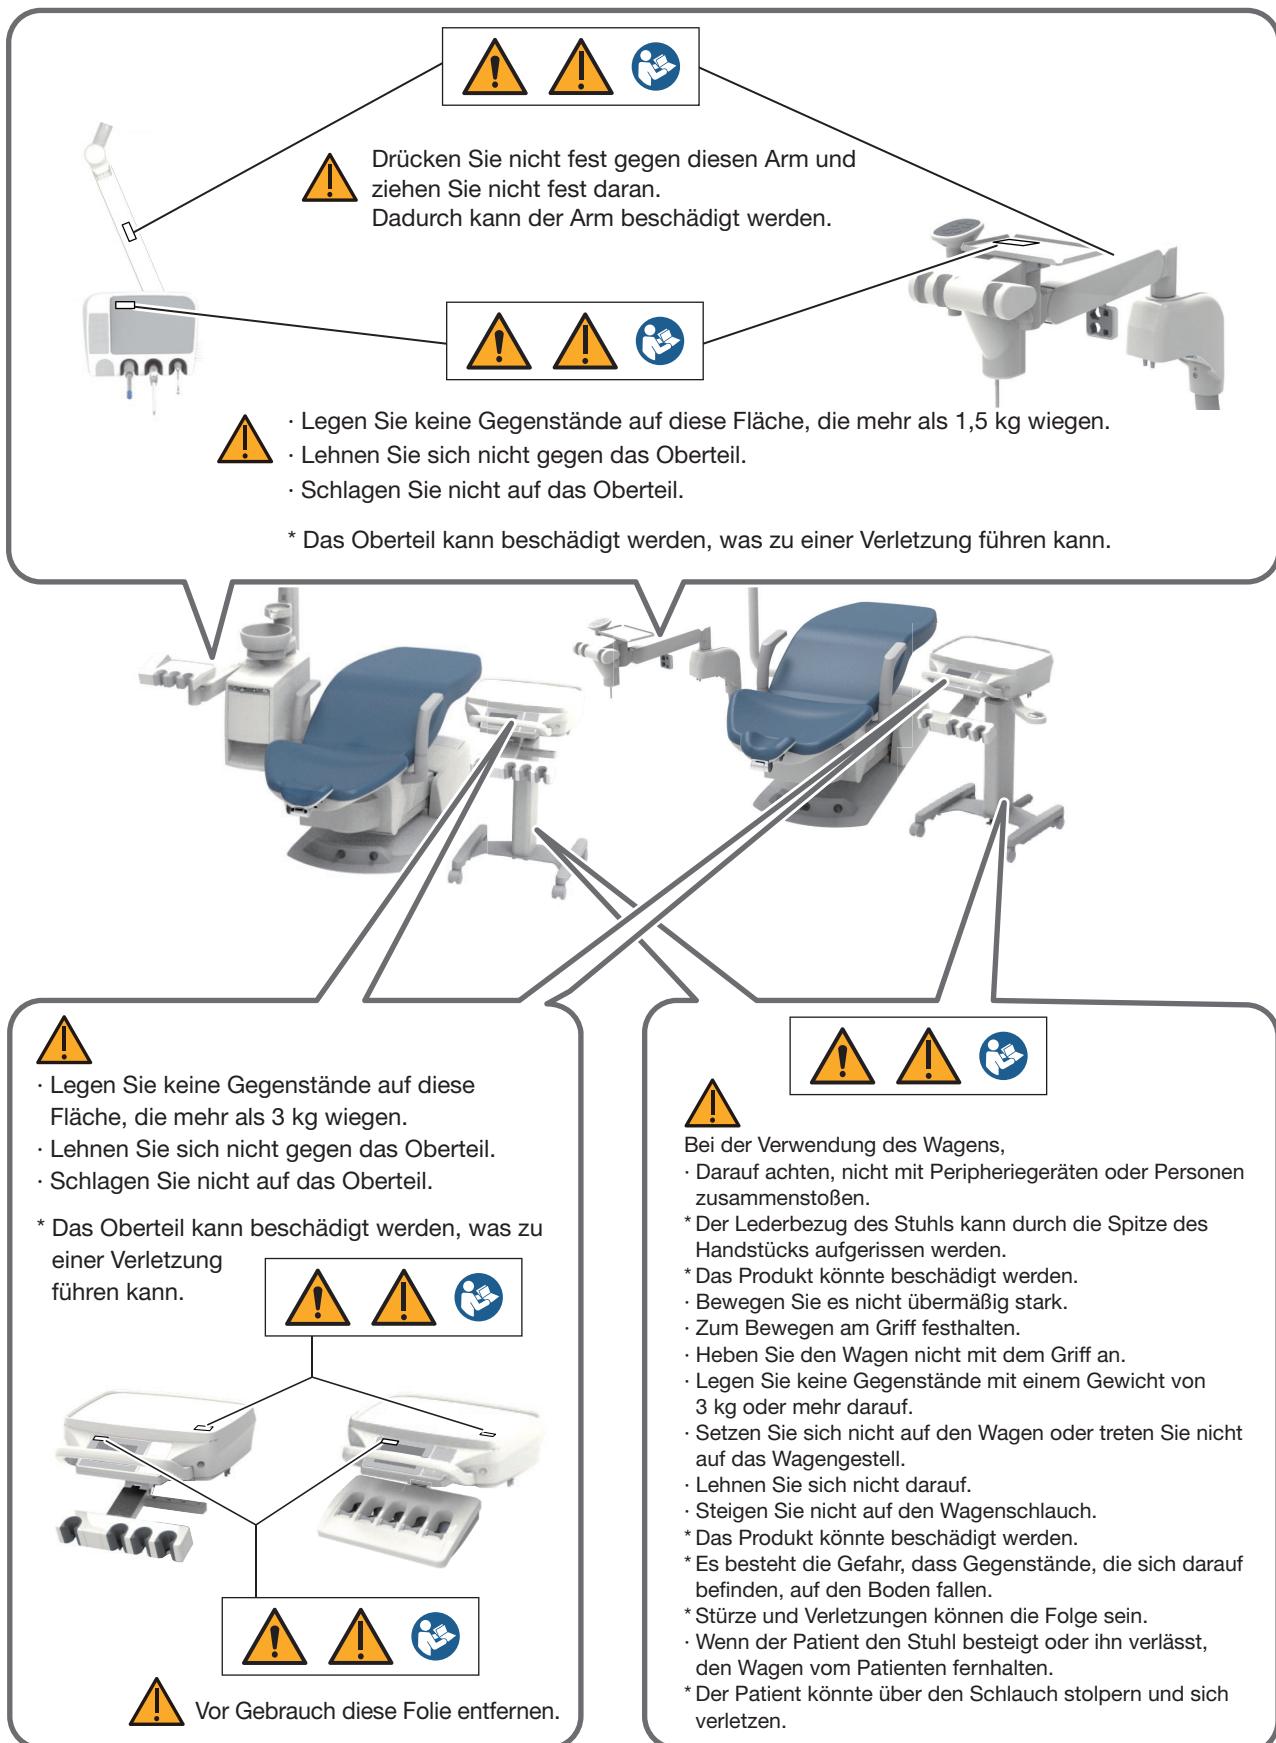

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

SchwenkHolderung

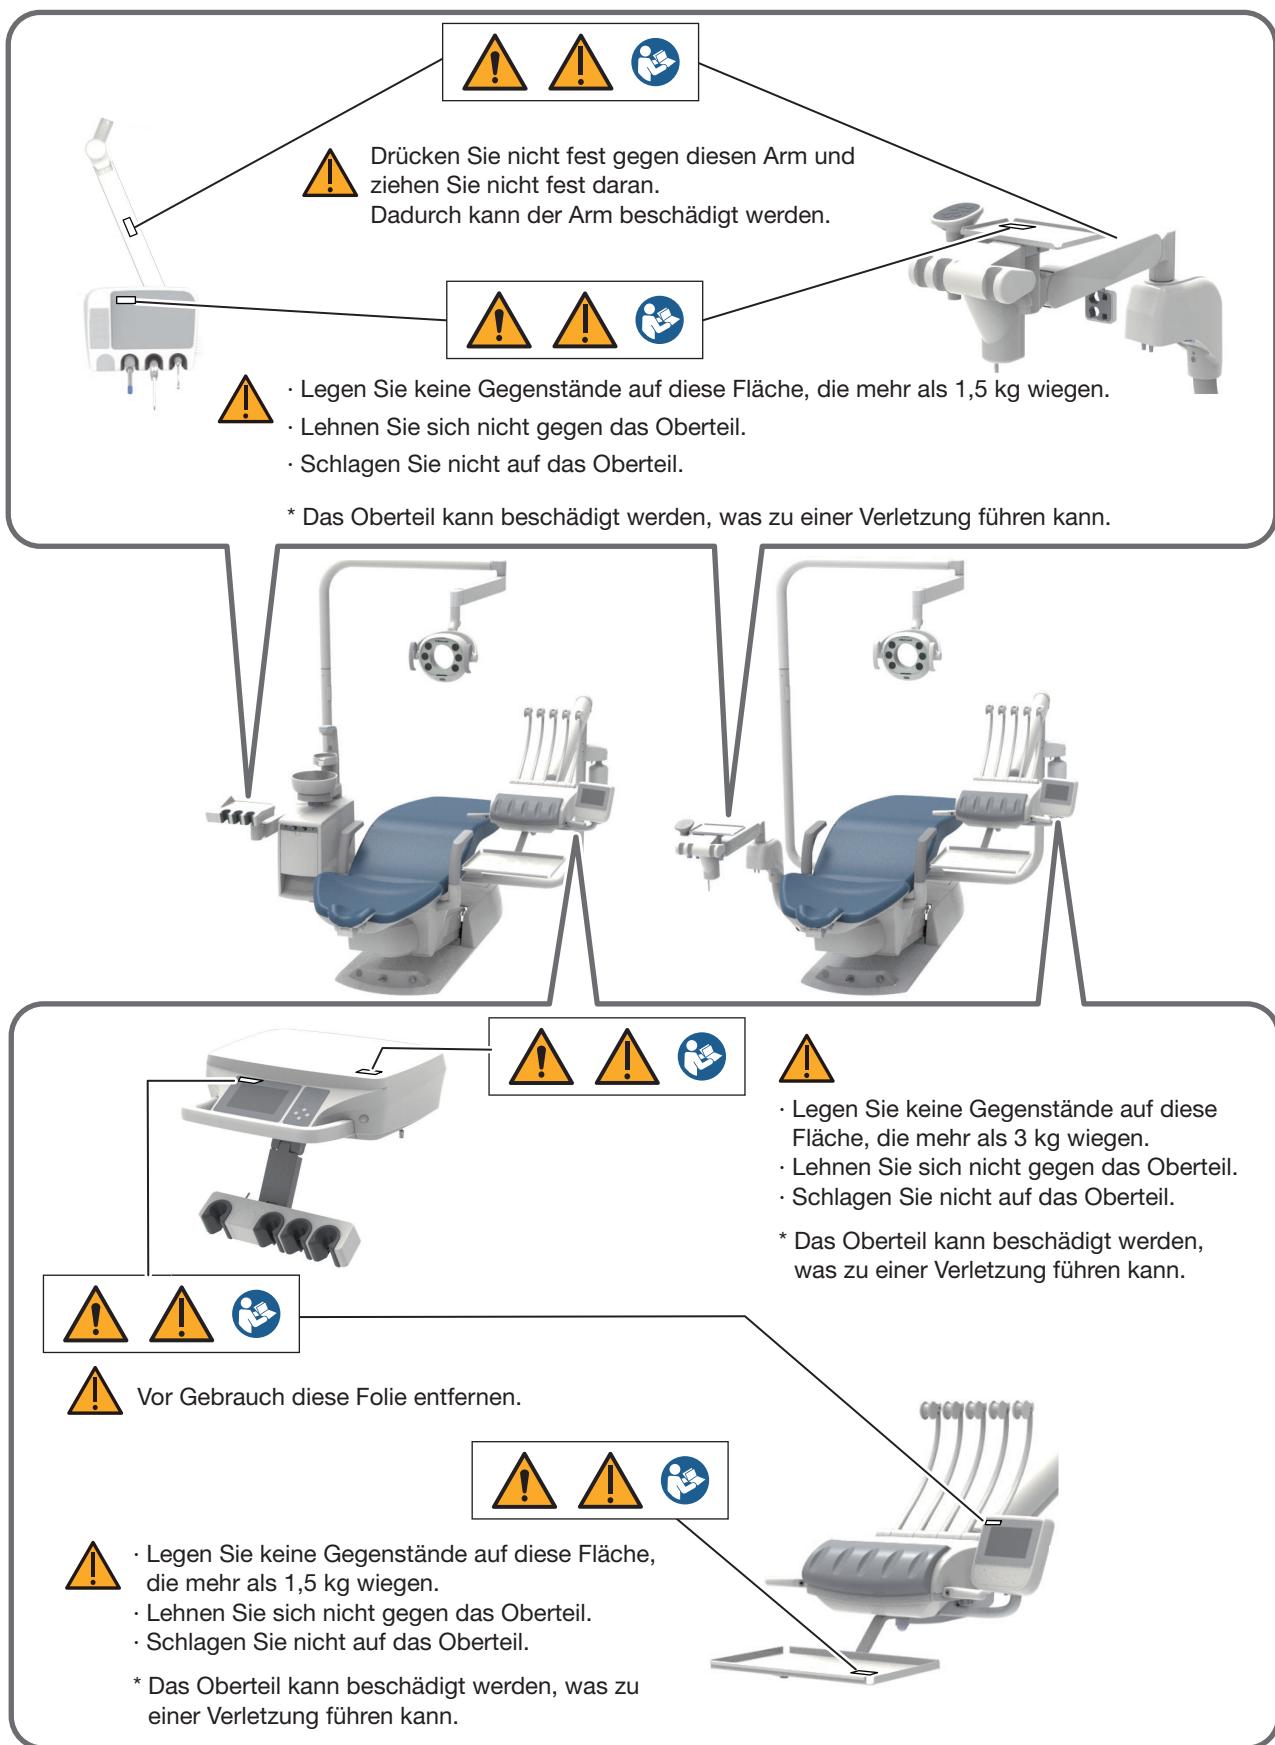

2–4 EMV-Informationen

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie EN 60601-1-2:2015+AMD1:2021.

1. Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV und Einhaltung der Begleitdokumente

Das medizinische elektrische Gerät bedingt spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV und muss entsprechend den in dieser Gebrauchsanweisung zur Verfügung gestellten EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.

2. Auswirkungen von Hochfrequenzkommunikationsgeräten

Tragbare und mobile Hochfrequenzkommunikationsgeräte können das medizinische elektrische Gerät beeinträchtigen.

3. Umgebung, in der die Installation ausgeschlossen ist

Krankenhäuser mit Ausnahme nahe aktiver HF-CHIRURGIEGERÄTE und des hochfrequenzabgeschirmten Raums eines ME-Systems für die Magnetresonanzspektroskopie, wo die Intensität von EM-Störungen hoch ist.

4. Erklärung zur elektromagnetischen Strahlung

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Strahlung			
Emissionsprüfung	Einhaltung		Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
	Japan	CE	
Hochfrequenzemissionen CISPR 11	Gruppe 1		EURUS verwendet die hochfrequente Energie nur für seine internen Funktionen. Daher sind seine hochfrequenten Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.
Hochfrequenzemissionen CISPR 11	Klasse B		EURUS ist für die Verwendung in allen Umgebungen geeignet, einschließlich häuslicher Umgebungen und solchen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude für häusliche Zwecke versorgt.
Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2	Nicht anwendbar	Klasse A	
Spannungsschwankungen/Aussendung von Spannungsschwankungen IEC 61000-3-3	Nicht anwendbar	Wird eingehalten	



WARNUNG

Die Verwendung dieses Geräts neben oder auf anderen elektronischen Geräten ist zu vermeiden, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.

Wenn eine solche Verwendung unerlässlich ist, sind dieses Gerät und das andere Gerät zu beobachten, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

5. Erklärung der elektromagnetischen Störfestigkeit 1

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit			
EURUS ist für die Verwendung in der nachfolgend angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des EURUS muss sicherstellen, dass er in einer derartigen Umgebung verwendet wird.			
Störfestigkeitsprüfung	Prüfpegel nach IEC 60601	Einhaltungsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	Der Fußboden sollte aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material abgedeckt ist, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens bei 30 % liegen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	±2 kV für die Stromversorgungsnetzen ±1 kV für Eingangs-/Auszugsleitungen	±2 kV für die Stromversorgungsnetzen ±1 kV für Eingangs-/Auszugsleitungen	Die Qualität der Hauptstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannungen IEC 61000-4-5	±1 kV Differentialmodus ± 2 kV allgemeiner Modus	±1 kV Differentialmodus ± 2 kV allgemeiner Modus	Die Qualität der Hauptstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, kurzzeitige Unterbrechungen und Spannungsschwankungen der Eingangsleitungen der Stromversorgung IEC 61000-4-11	0 % Ut ; 0,5 Zyklen 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % Ut ; 1 Zyklus und 70 % Ut ; 25/30 Zyklen bei 0°, einphasig 0 % Ut ; 250/300 Zyklen	0 % Ut ; 0,5 Zyklen 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % Ut ; 1 Zyklus und 70 % Ut ; 25/30 Zyklen bei 0°, einphasig 0 % Ut ; 250/300 Zyklen	Die Qualität der Hauptstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des EURUS die Fortsetzung des Betriebs während eines Stromausfalls wünscht, empfehlen wir, den EURUS an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie zu betreiben.
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Die Magnetfelder der Netzfrequenz müssen auf Pegeln liegen, die in einer üblichen gewerblichen oder Krankenhausumgebung typisch sind.
Magnetfelder in der Nähe IEC 61000-4-39	134,2 kHz 65 A/m, Pulsmodulation 2,1 kHz 13,56 MHz 7,5 A/m, Pulsmodulation 50 kHz	134,2 kHz 65 A/m, Pulsmodulation 2,1 kHz 13,56 MHz 7,5 A/m, Pulsmodulation 50 kHz	Die Magnetfelder in der Nähe müssen auf Pegeln liegen, die an einem typischen Ort in einer Einrichtung der professionellen Gesundheitsversorgung üblich sind.
Hinweis Ut ist die Spannung des Wechselstroms vor der Auftragung des Prüfpegels.			

6. Erklärung der elektromagnetischen Störfestigkeit 2

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit			
EURUS ist für die Verwendung in der nachfolgend angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des EURUS muss sicherstellen, dass er in einer derartigen Umgebung verwendet wird.			
Störfestigkeitsprüfung	Prüfpegel nach IEC 60601	Einhaltungsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Leitungsgeführte hochfrequente Felder IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V 0,15 MHz - 80 MHz in ISM- und Amateurfunkbändern	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V 0,15 MHz - 80 MHz in ISM- und Amateurfunkbändern	Warnung: Tragbare Hochfrequenzkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräten wie zum Beispiel Antennenkabel und externe Antennen) dürfen nicht näher als 30cm (12 Zoll) zu allen Teilen des EURUS verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller vorgeschriebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit dieses Geräts kommen.
Abgestrahlte Hochfrequenz IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM (1 kHz)	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM (1 kHz)	
Nahe dem elektromagnetischen Feld, das durch drahtlose Hochfrequenzkommunikationsgeräte verursacht wird IEC61000-4-3	Siehe die Tabelle auf der nächsten Seite (Seite 37)	Siehe die Tabelle auf der nächsten Seite (Seite 37)	

7. Wesentliche Leistungsmerkmale

Wenn der Stuhl nicht durch den SteuersHolder bedient wird, führt er keine Bewegungen aus. Wenn es nicht durch den Fußanlasser bedient wird, bewegt sich das Handstück nicht, außer dass der Summer ertönt oder die Anzeige ein-/ausgeschaltet wird.

Wenn der Stuhl oder das Handstück die wesentlichen Leistungsmerkmale verliert oder in diesen nachlässt, kann sich der Stuhl bzw. das Handstück unerwartet bewegen, was eine Verletzung oder Schädigung des Patienten, des Bedieners oder der Menschen in der Nähe des Patienten oder des Bedieners verursacht.

⚠️ WARNUNG

Tragbare Hochfrequenzkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräten wie zum Beispiel Antennenkabel und externe Antennen) dürfen nicht näher als 30cm (12 Zoll) zu allen Teilen des EURUS verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller vorgeschriebenen Kabel.
Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit dieses Geräts kommen.

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Nahe dem elektromagnetischen Feld, das durch drahtlose Hochfrequenzkommunikationsgeräte verursacht wird

Testfrequenz (MHz)	Modulation	Prüfpegel nach IEC 60601	Konformitätsstufe nach IEC 60601
385	Pulsmodulation ^{a)} 18 Hz	27 V/m	27 V/m
450	Frequenzmodulation ± 5 kHz Verschiebung 1 kHz Sinuswelle	28 V/m	28 V/m
710 745 780	Pulsmodulation ^{a)} 217 Hz	9 V/m	9 V/m
810 870 930	Pulsmodulation ^{a)} 18 Hz	28 V/m	28 V/m
1.720 1.845 1.970	Pulsmodulation ^{a)} 217 Hz	28 V/m	28 V/m
2.450	Pulsmodulation ^{a)} 217 Hz	28 V/m	28 V/m
5.240 5.500 5.785	Pulsmodulation ^{a)} 217 Hz	9 V/m	9 V/m
Hinweis a) Der Träger wird durch eine Rechteckwelle mit einem 50%igen Tastverhältnis moduliert.			

2–5 Kompatible Handstücke

Folgende Handstücke sind mit diesem Produkt kompatibel:

Spritze	BT14 3-WEGE
	SYR-20 3-WEGE
	Typ 77 3-WEGE
	DCI 3439 3-WEGE
	DCI 3459 3-WEGE
	LUZZANI 3-WEGE (Minimate)
	LUZZANI 3-WEGE (Minilight)
	LUZZANI 6-WEGE (Minilight)
Luftturbine	NSK (PTL-CL-LED+M900L)
Luftmotor	NSK (M205+M65)
	NSK (M205+M25L)
Mikromotor	BIEN AIR MX-i LED 3rd Gen.
	BIEN AIR MX2 (DMX3)
	BIEN AIR MCX
	NSK NLX plus
	NSK NLX nano
	NSK NBX
	NSK VARIOS VS170 Zahnsteinentfernungsgerät
	NSK VARIOS VS170 LUX Zahnsteinentfernungsgerät
	DENTSPLY CAVITRON Zahnsteinentfernungsgerät (TYP G139)
	SATELEC SP4055 NEWTRON
	SATELEC Xinetic
	EMS NO PAIN
Polymerisationslampe	SATELEC MINI LED STD OEM
Intraoralkamera	SOPRO ACTEON SOPRO 617
	SOPRO ACTEON SOPRO CARE
	ACTEON C20 Intraorale Full-HD-Kamera
	ACTEON C50 Intraorale Full-HD-Kamera

2–6 Kompatible ZahnarztLicht/Leuchten

Folgende ZahnarztLicht/Leuchten sind mit diesem Produkt kompatibel:

ZahnarztLicht/ Leuchte	EURUS-Licht/Leuchte
	ZAHNARZTLicht/Leuchte 900

3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

3-1 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

Wischen Sie alle am EURUS anhaftenden Arzneimittellösungen sofort ab.

Andernfalls können sie zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen.

Erwärmern Sie das Produkt nicht.

Dies kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen.

Verfärbung des Kunststoffes

In den äußenen Bestandteilen des Produktes werden Kunststoffmaterialien verwendet.

Wir verwenden sorgfältig ausgewählte Materialien. Aus Gründen wie zum Beispiel natürlicher Verschlechterung oder Anhaftung von Arzneimittellösungen kann jedoch eine Verfärbung auftreten.

Wischen Sie alle anhaftenden Arzneimittellösungen sofort ab und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um eine möglichst lange Lebensdauer des EURUS zu gewährleisten.

Placeieren Sie keine anderen Gegenstände, sondern nur Personen auf dem Sitz.

Andernfalls kann es zu einer Verformung, Einrissen oder Zersetzung des Leders kommen.

Funktionsprüfung für den Arzttisch

Wenn Sie den Arzttisch nach oben/unten verstellen, ohne die Bremse zu lösen, kann das Produkt beschädigt werden.

Lösen Sie immer zuerst die Bremse, indem Sie auf den BremslösescHolder drücken. Fahren Sie anschließend den Arzttisch nach oben/unten.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Wagens

Achten Sie darauf, dass er nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. Das Leder des Stuhls kann durch die Spitze des Handstücks reißen oder das Produkt kann beschädigt werden.

Wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen nicht befolgen, kann das Produkt beschädigt werden oder es besteht die Gefahr, dass Gegenstände, die sich darauf befinden, auf den Boden fallen.

(Bewegen Sie ihn nicht gewaltsam und energisch. /Halten Sie den Griff, um ihn zu bewegen. /Heben Sie den Wagen nicht mit dem Griff an. /Legen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von 3 kg oder mehr darauf. /Setzen Sie sich nicht auf den Wagen oder treten Sie nicht auf das Wagengestell.)

Gehen Sie mit den Handstücken/Spritzen vorsichtig um.

Gehen Sie mit Handstücken/Spritzen vorsichtig um, damit sie nicht herunterfallen. Wenn sie herunterfallen, können sie beschädigt oder verformt werden.

Licht/Leuchten der LED-Anzeigen

Überzeugen Sie sich am Anfang jedes Arbeitstags davon, dass die SteuerscHolder wie abgebildet normal funktionieren, da das Licht/Leuchten der LED-Anzeigen als Anhaltspunkt für die Verriegelung von Stuhl/Handstück und für Modus-Umschaltungen fungiert.

3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

Überprüfung der Funktion des Kompressors.

Dieses Produkt funktioniert nur, wenn Luft zugeführt wird. Schalten Sie den Kompressor ein, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Achten Sie darauf, dass Sie kein anderes Wasser als Leitungswasser verwenden.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit Leitungswasser, gereinigtem Wasser, destilliertem Wasser oder reinem Wasser vorgesehen; die Verwendung eines anderen als der oben genannten Wasser kann zu einer Fehlfunktion führen. Wenn das Produkt aufgrund der Verwendung von Wasser ausfällt, das nicht den Vorschriften entspricht, ist dies nicht von der Garantie abgedeckt.

Maßnahmen bei Wasserlecks

Schließen Sie im Falle eines Wasserlecks das Hauptwasserventil, schalten Sie den HauptscHolder und den TrennscHolder für Geräte, die in der Klinik verwendet werden, aus, und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für die zahnärztliche Behandlung.

Dieses Produkt ist eine Dentaleinheit und ein Patientenstuhl, die für die zahnärztliche Behandlung verwendet werden.

Dieses Produkt darf nur von einem Zahnarzt und zahnärztlichen Mitarbeitern verwendet werden.

Gewichtsbeschränkung des Stuhls

Der Stuhl kann sich langsam anheben, wenn eine Person ungefähr so viel wie maximale Hebekapazität wiegt.

[Referenz] Gewichtsgrenze

4 Produktspezifikation, 4-1 Technische Daten [Seite 44]

3-2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Kunstleder

Anhaftung von Kleidungsfarbstoffen

Um das Kunstleder zu reinigen und zu desinfizieren, wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD360 befeuchtet haben, und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.

Der Farbstoff von Kleidungsstücken oder Gürteln kann in das Kunstleder des Produktes eindringen. Wenn Farbstoff anhaftet, wischen Sie ihn so bald wie möglich vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das Sie mit einem etwa 1:10 mit Wasser verdünnten neutralen Reinigungsmittel imprägniert haben, um eine Durchdringung zu vermeiden. Wischen Sie anschließend mit Wasser und dann gründlich mit einem trockenen Tuch nach.

Achten Sie darauf, eine Verschlechterung und das Eindringen des Farbstoffs durch den Kontakt zu vermeiden.

Der Kontakt mit anderen Kunststoffmaterialien, beschichteten Produkten, Lösungsmitteln und Klebestreifen kann Veränderungen des Oberflächenglanzes, Risse, Verformung oder Abrieb verursachen.

Farbstoff von Zeitungen oder Druckschriften kann in das Produkt eindringen.

Der Farbstoff von bedruckten Kleidungsstücken wie zum Beispiel T-Shirts oder Jeanskleidung kann in das Leder des Produktes eindringen.

Anhaftungen von Waschbenzin, Nagellackentferner, Alkohol oder Öl können zu einer Verfärbung, Auflösung der Oberfläche, Veränderungen des Oberflächenglanzes, Aushärtung, Aufweichung oder Abrieb führen.

Die Verwendung eines Bleichmittels oder eines mit Bleichmittel versetzten Tuches kann eine Glanzveränderung oder Verfärbung hervorrufen.

Wenn Sie das Produkt in der Nähe einer Wärmequelle wie zum Beispiel einer Heizung aufstellen, kann eine Verformung oder Verfärbung verursacht werden.

Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, indem Sie einen Vorhang verwenden. Die direkte Sonneneinstrahlung kann eine Veränderung der Oberfläche, Schrumpfung, Verfärbung oder ein Ausbleichen verursachen.

Wenn Sie einen schweren Gegenstand für längere Zeit auf das Produkt stellen, kann ein Abdruck oder eine Falte zurückbleiben.

4-1 Technische Daten

4-1-1 Varianten der Spezifikationen

S8

		S8H	S8P	S8CH	S8CP	S8SR	S8SH	S8SP
Stuhl	Kontur	<input type="radio"/>						
	Einklappbare Beinstütze							
Mundspüleinheit	StuhlHolderung	<input type="radio"/>						
Vac Pac-Einheit	StuhlHolderung	<input type="radio"/>						
Ausleger der Arzteinheit	BodenplatteHolderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	Wagen			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SchwenkHolderung					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instrumenten-ausleger	Holder	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	PlaceHolder		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
	Stange					<input type="radio"/>		

4-1-2 S8

Modell

Arzteinheit

AU-ER8-CBM (BodenplatteHolderung)

AU-ER8-CT (Wagen)

AU-ER8-CSWR/CSWH
(SchwenkHolderung)

Mundspüleinheit

AU-ER8-SW*

Vac Pac-Einheit

AU-ER8-VP*

Stuhl

AC-ER8-CP* (Wagen, elektrische
Kopfstütze)

AC-ER8-CD* (Wagen, manuelle
Kopfstütze)

(* steht für einzelne oder mehrere Zeichen
oder Ziffern.)

Klassifizierung des Schutzes gegen Stromschlag

Gerät der Schutzklasse I

Klassifizierung nach dem Grad des Schutzes gegen Stromschlag

Typ B Anwendungsteile
(Handstück/Spritze/gepolsterte Teile des
Stuhls/Armllehne)

Klassifizierung nach dem Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Wasser oder Feinstaub

Fußanlasser IPX1

Nennspannung

Wechselstrom 230 V

Netzfrequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

5,5 A

4 Produktspezifikationen

Sicherung	SicherungsHolderung Primärschaltkreis: 8 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 80 A/250 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung Größe: 5,2 × 20 mm
	Sekundärschaltkreis für 24-V-/6,5-A-Leitung 10 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung Größe: 5,2 × 20 mm
	Sekundärschaltkreis für 24-V-/5-A-Leitung 6,3 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung Größe: 5,2 × 20 mm
	Sekundärschaltkreis für 14-V-/5-A-Leitung 6,3 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung Größe: 5,2 × 20 mm
	Sekundärschaltkreis für den Handstück-Wasserwärmer 6,3 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung Größe: 5,2 × 20 mm
	Sekundärschaltkreis für 6-Wege-Spritzen-/ Becherwasserversorgung und Wasserwärmer 6,3 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung Größe: 5,2 × 20 mm
	Netzplatine für NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX 5 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 100 A/250 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung Größe: ø8,35 mm
	Steuerplatine für den Fußanlasser 0,315 A/32 V (Unterbrechungskapazität: 1,2 A/32 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Normalbetrieb Größe: 1,6 × 0,8 mm
	Steuerplatine des Stuhls 1,25 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Unterbrechen Größe: 5,2 × 20 mm
	Wechselstrom-/Gleichstromplatine 2,0 A/250 V (Unterbrechungskapazität: 100 A/300 V Wechselstrom) Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung Größe: 8,5 × 8,5 × 4 mm

4 Produktspezifikationen

Betriebsmodus	Diskontinuierlicher Betrieb (Motor) Maximale Betriebsdauer, 3 Minuten TASTVERHÄLTNIS 1:15	
Gewicht	Mundspüleinheit	40 kg
	Arzteinheit	
	BodenplatteHolderung	30 kg
	Wagen	25 kg
	SchwenkHolderung	40 kg
	Vac Pac	25 kg
	Stuhl	170 kg
Hauptluftdruck	0,5 MPa	
Hauptwasserdruck	0,2 MPa	
Anfangshöhe/Hub des Stuhls	490 mm/310 mm	
Mechanismus zum Anheben und Absenken des Stuhls	Elektrohydraulisch	
Kopfstütze	Elektrohydraulisch	
	Manuell	
Rückenlehne	Elektrohydraulisch	
Sitz	Mit der Rückenlehne verbundener Neigungsmechanismus	
Armlehne	Links gedreht/rechts gedreht Drehwinkel 90°/135°	
Gepolsterte Teile	Kunstleder	
SteuerscHolder	Joystick-ScHolder	
Nutzungsumgebung	Temperatur 0 °C bis 40 °C Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend) Luftdruck 700 bis 1.060 hPa	
Transport-/Lagerungsumgebung	Temperatur –20 °C bis 70 °C Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend) Luftdruck 700 bis 1.060 hPa	
Gewichtsbeschränkung	Arzttisch 3 kg Nebenablage des Arzttisches (Stange) 1,5 kg Helferinnenablage 1,5 kg Stuhl (maximales Patientengewicht;) 200 kg	
Anpassung an eine Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt	Das Produkt ist nicht für die Verwendung in einer Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt geeignet.	


Die Angaben für die Kapazität der Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

BodenplatteHolderung Speischale

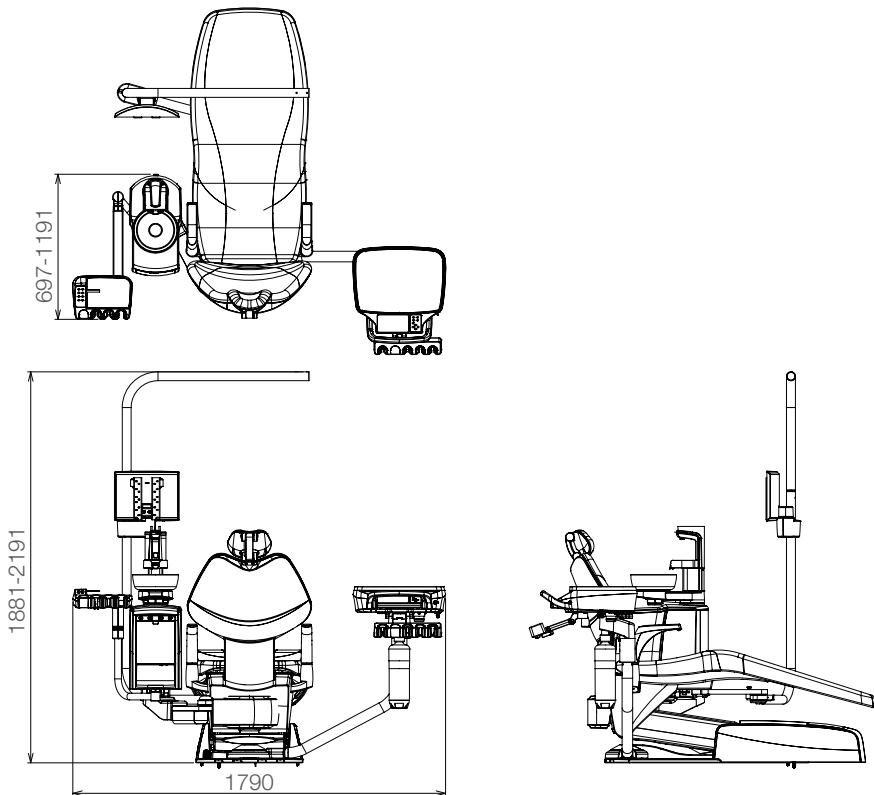

BodenplatteHolderung Vac Pac

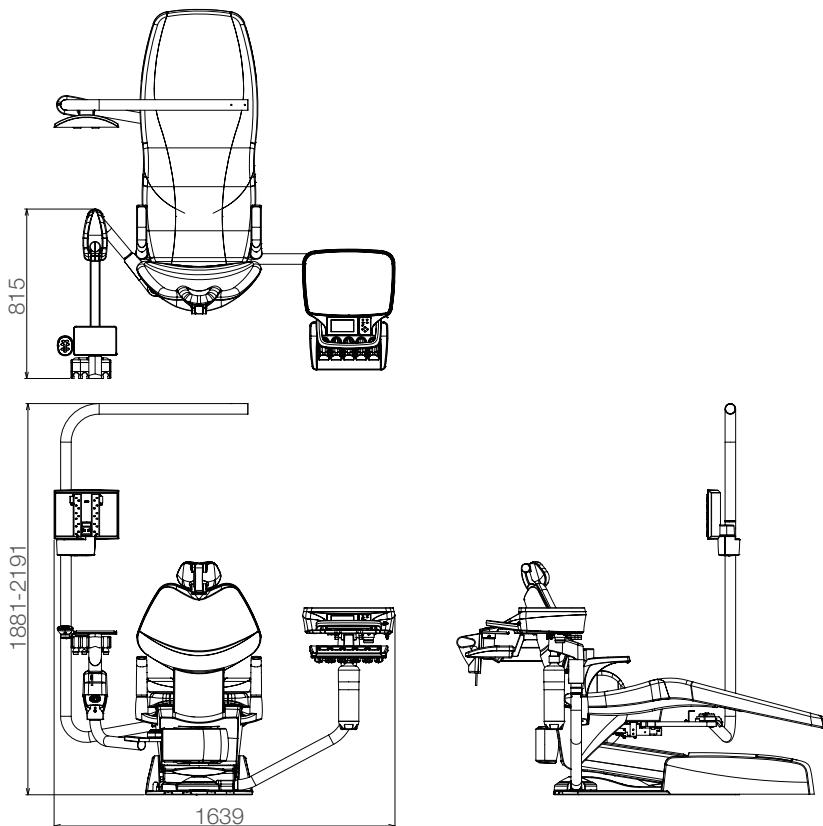


Einheit: mm
Toleranz in den Abmessungen:
±10%

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Wagen Speischale

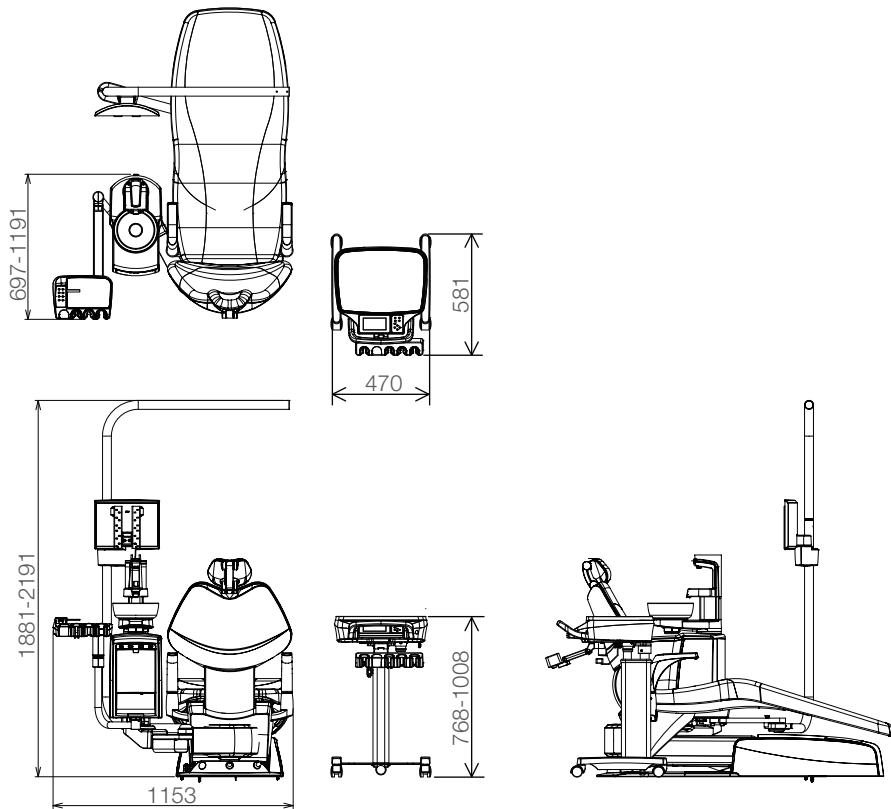

Wagen Vac Pac

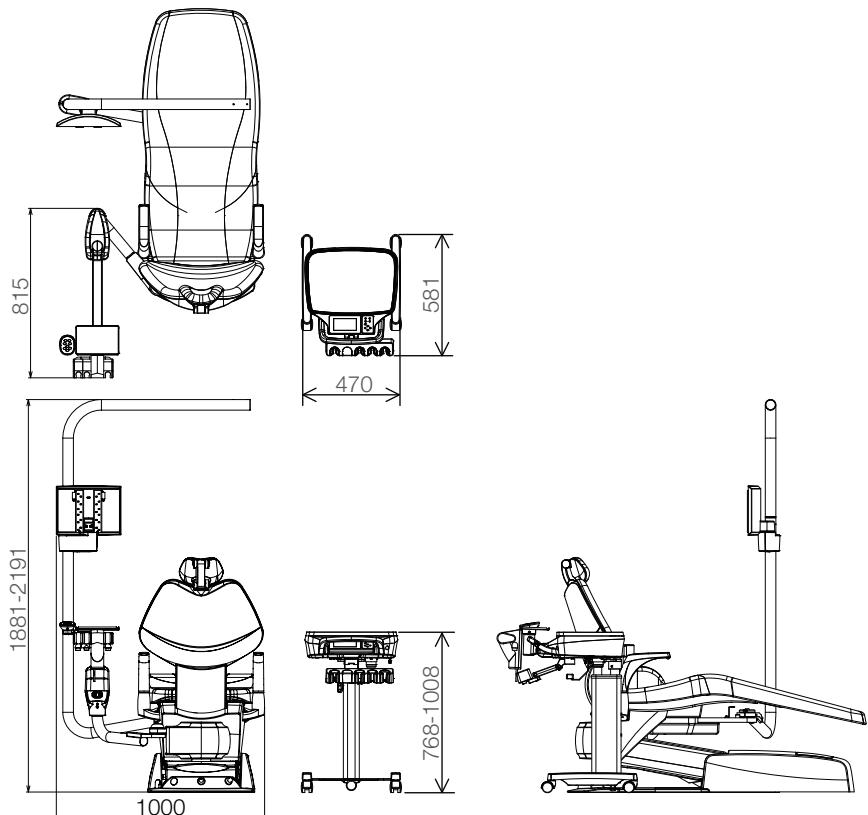


Einheit: mm
Toleranz in den Abmessungen:
±10%

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

SchwenkHolderung Speischale

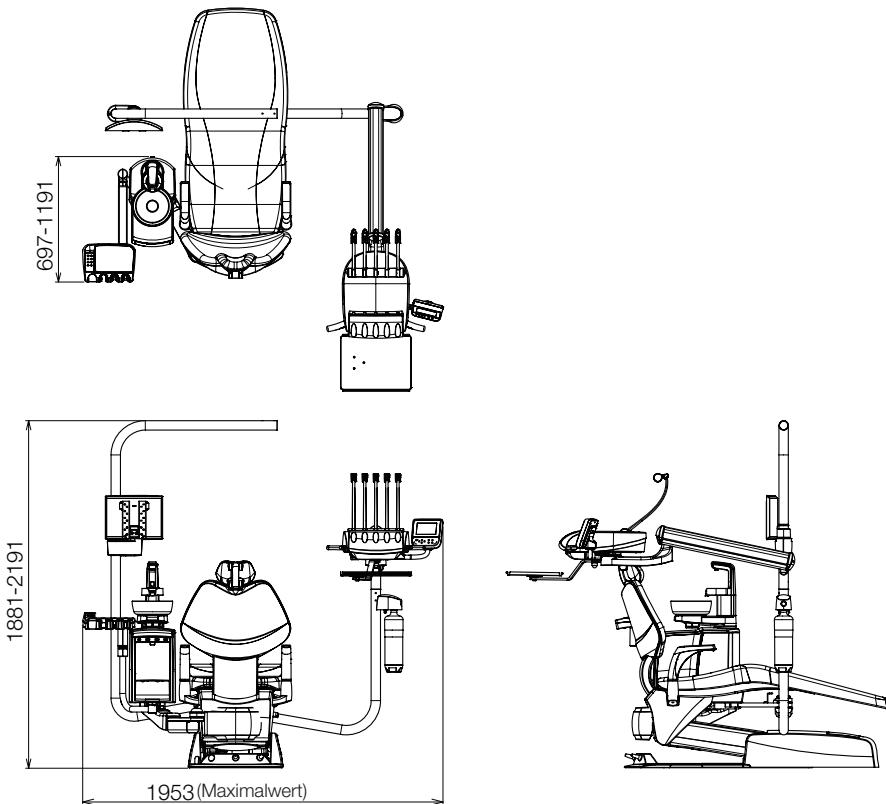

SchwenkHolderung Vac Pac

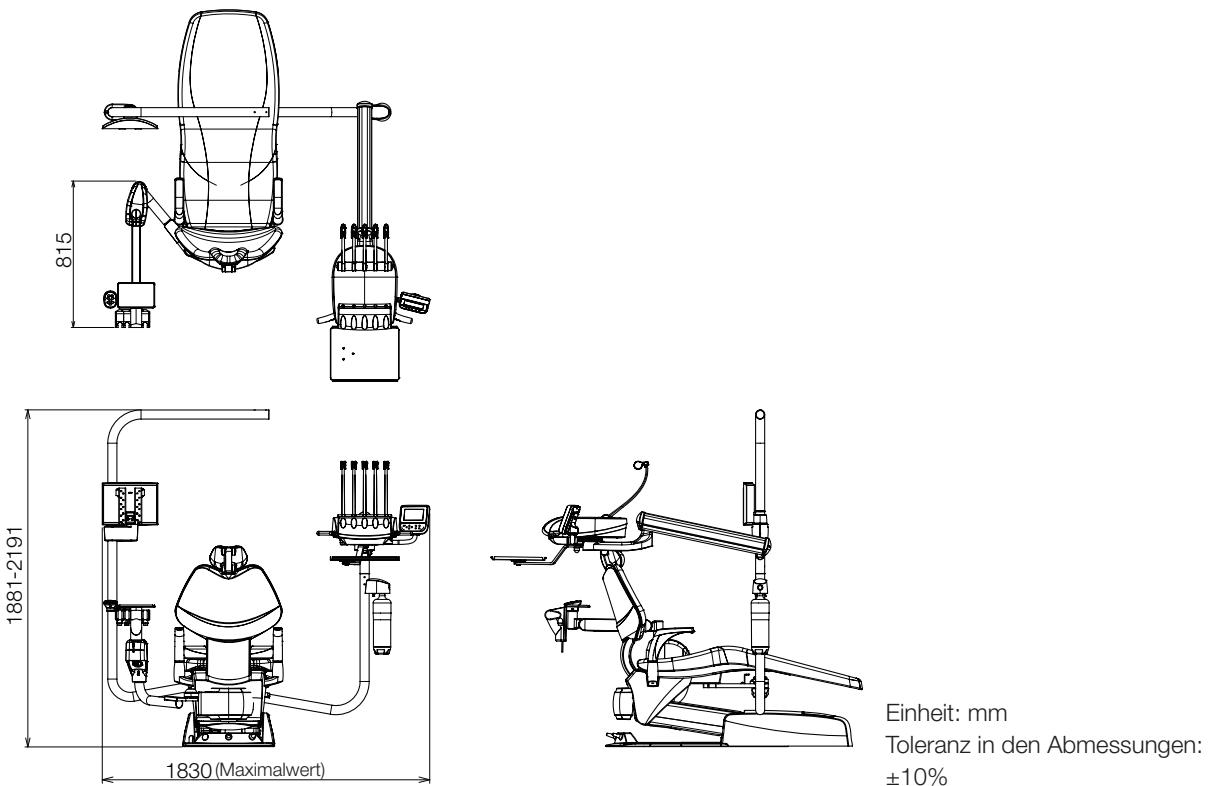

Einheit: mm
Toleranz in den Abmessungen:
±10%


Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Produktspezifikationen


Stuhl Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

BodenplatteHolderung

Kopfstütze: Elektrohydraulisch

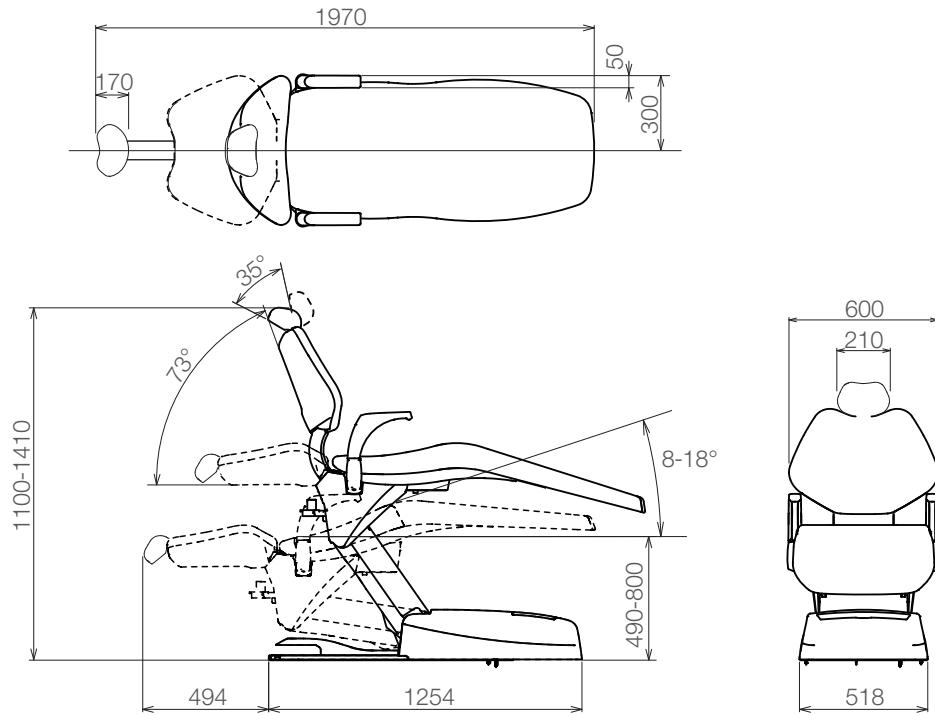

Kopfstütze: Manuell

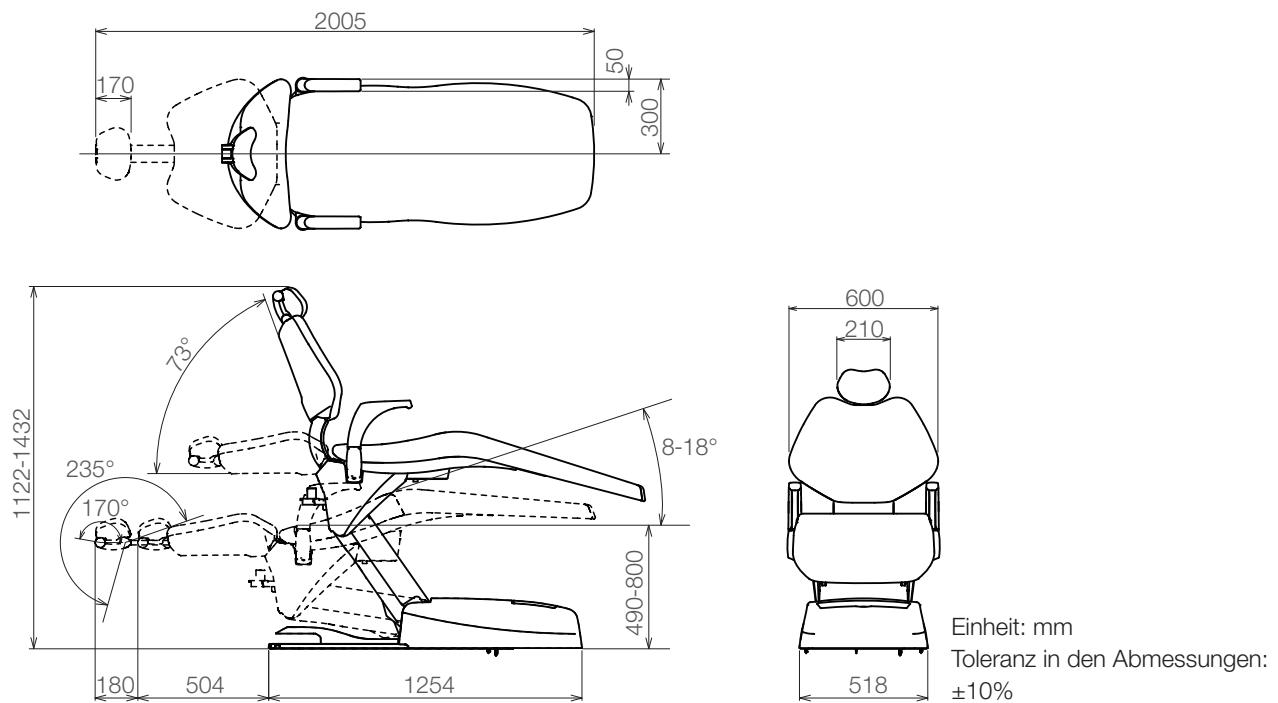


Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Wagen

Kopfstütze: Elektrohydraulisch

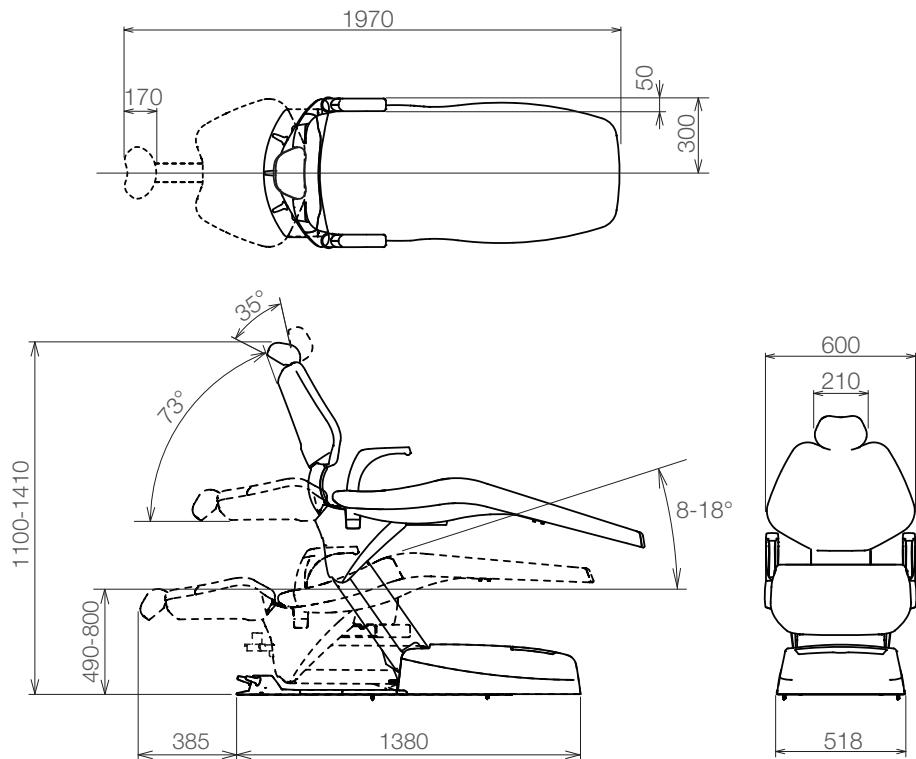

Kopfstütze: Manuell

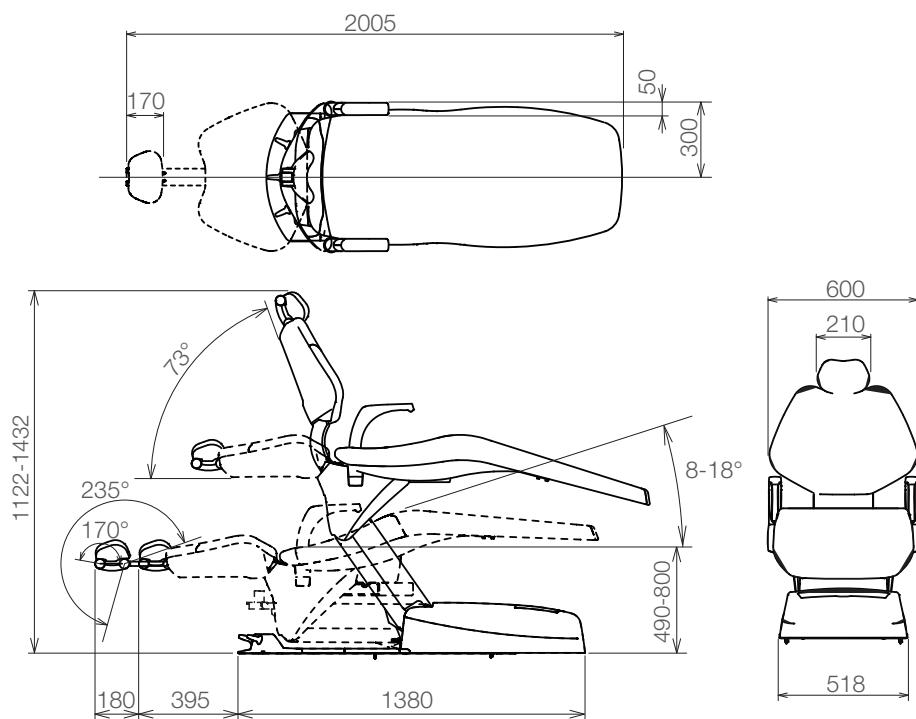

Einheit: mm
Toleranz in den Abmessungen:
±10%

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4-1-3 Spezifikationen für Luft/Wasser/Absaugung

Wasserversorgung

Druck: 0,2-0,4 MPa
Minimaler Wasserdurchfluss: 6 L/min
Härte: Weniger als 2,14 mmol/L (< 12-dH)
pH: 6,5-8,5
Partikelwasserfilter: 100 µm
Wasserqualität: Muss die nationalen Anforderungen für Trinkwasser erfüllen.
Beachten Sie die nationalen Anforderungen für den Anschluss des EURUS an die öffentliche Trinkwasserversorgung.

Luftversorgung

Druck: 0,5-0,7 MPa
Minimale Flussrate: 100 L/min
Feuchtigkeit: 10 bis 95 % (Keine Kondensation)
Ölkontamination: Max. 0,5 mg/m³
Partikelkontamination :
Partikelgröße (1 µm - 5 µm), weniger als 100/m³
Partikelluftfilter: 5 µm

Typ des Luftvolumendurchflusses

Typ 1: Hochleistungsansaugsystem


VH-18 HVE

Spitzengröße: ø11/ø16

4-2 Systemübersicht


BodenplatteHolderung

Speischale

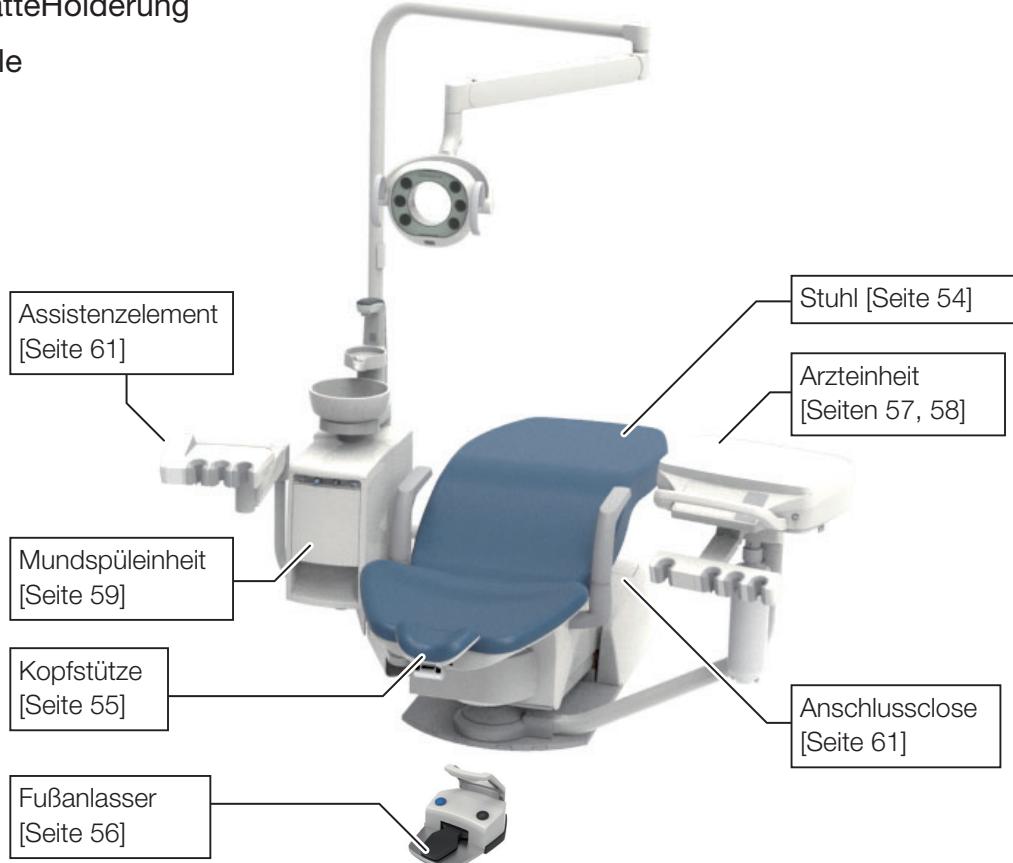

BodenplatteHolderung


Vac Pac

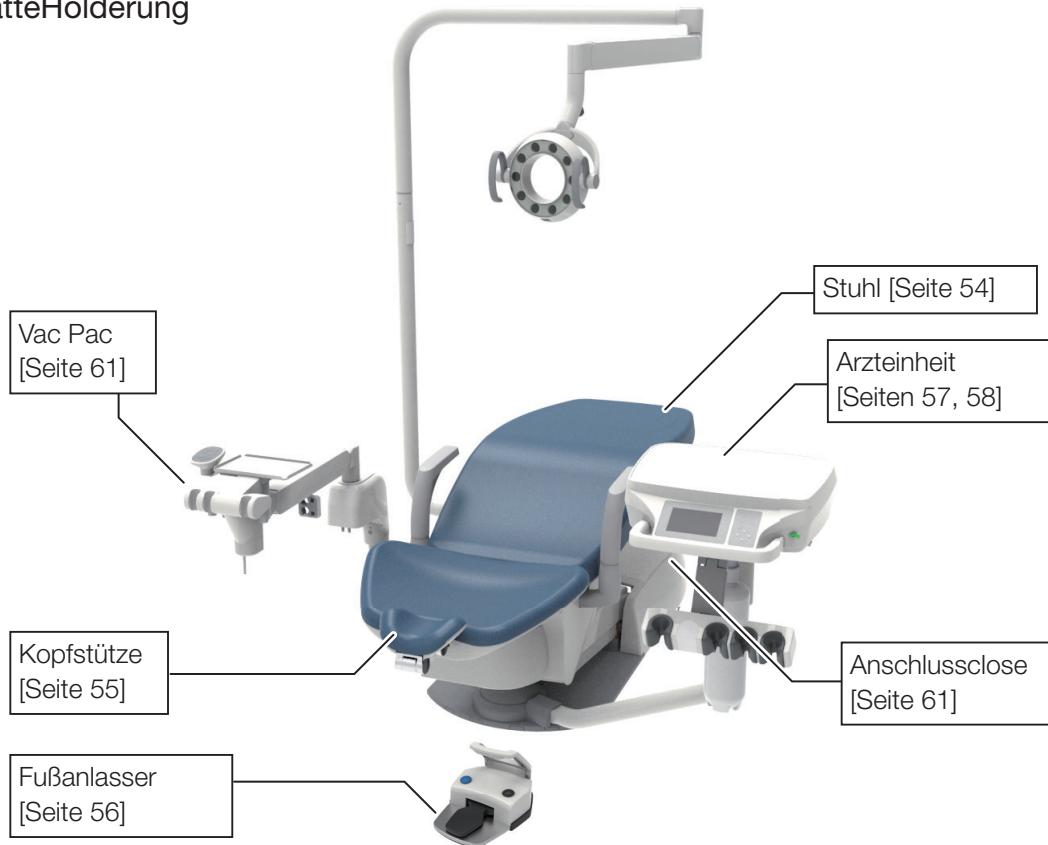

4 Produktspezifikationen


Wagen

Speischale

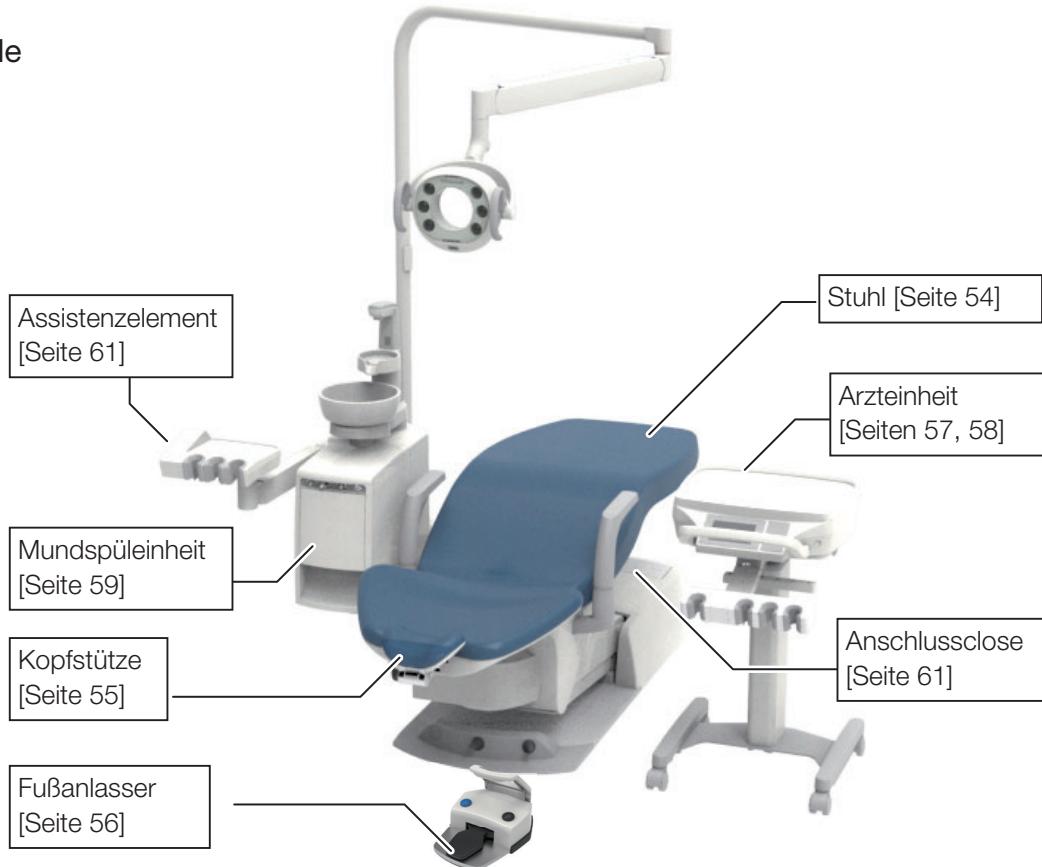

Wagen


Vac Pac

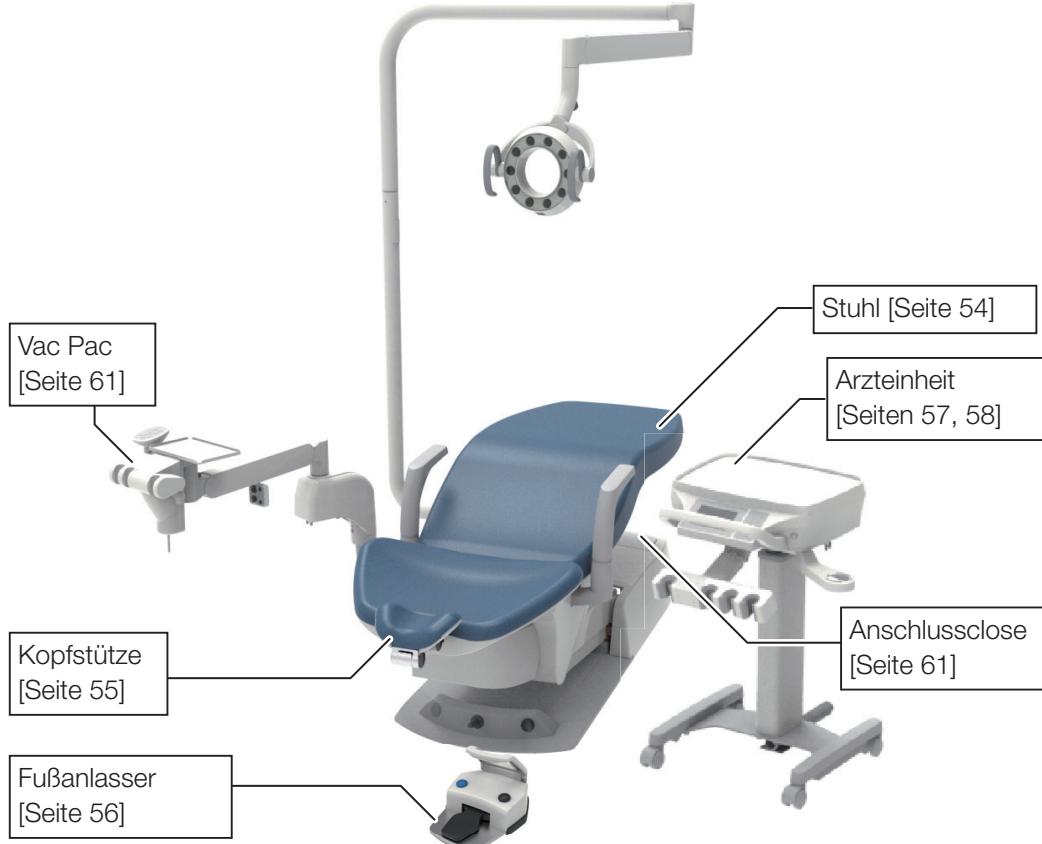

4 Produktspezifikationen


SchwenkHolderung

Speischale

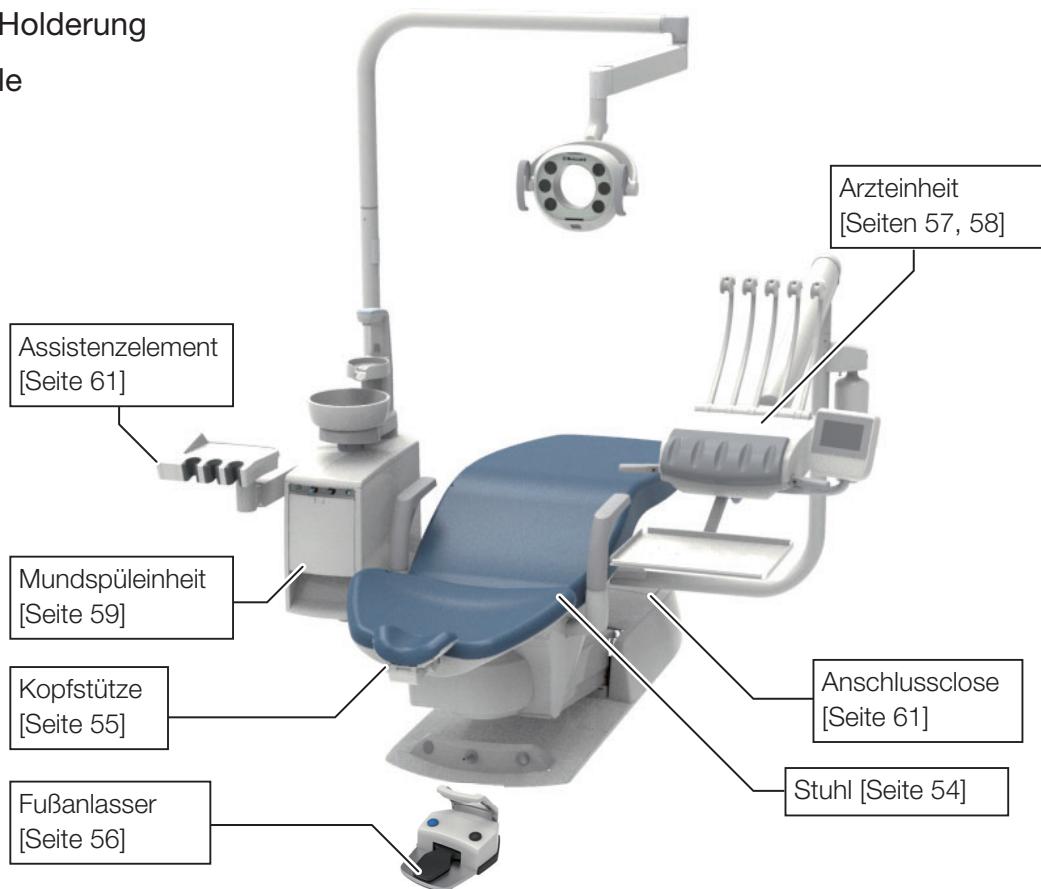

SchwenkHolderung

Vac Pac

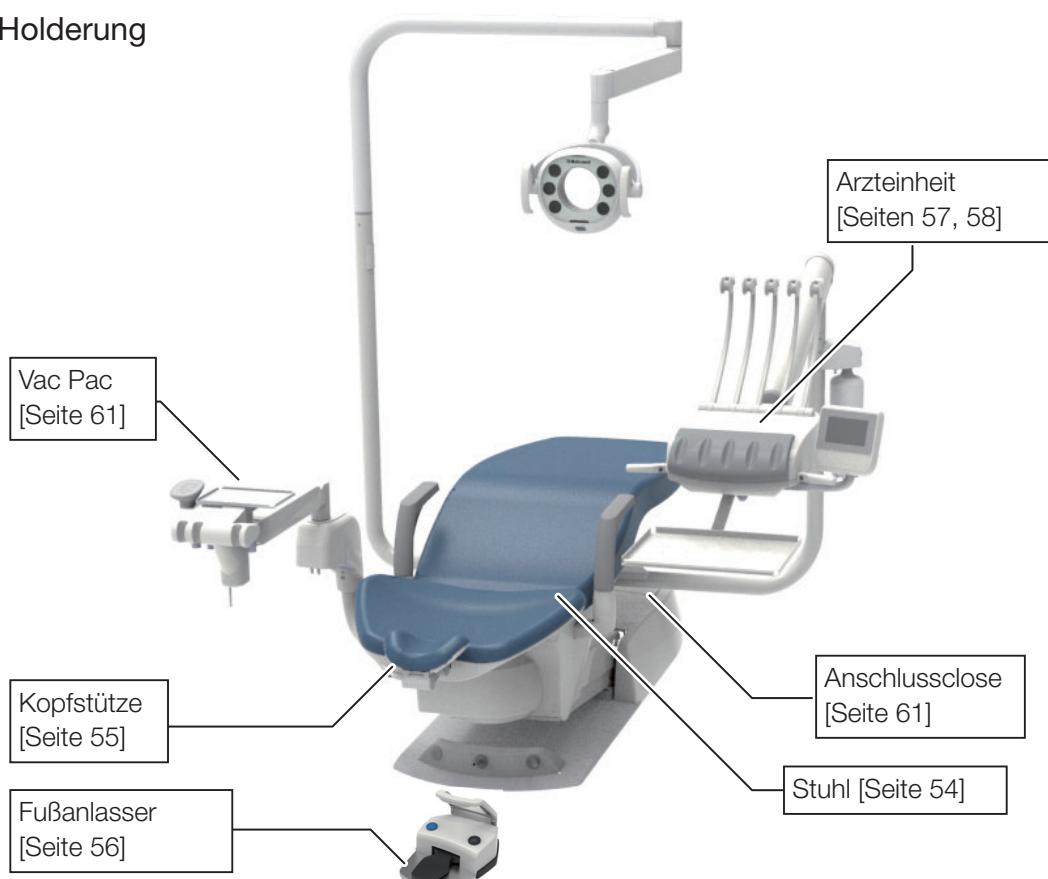

4–3 Bezeichnung der einzelnen Teile

4–3–1 Stuhl

BodenplatteHolderung




Die Kopfstütze kann je nach gewählter Ausführung abweichen.



Wagen/SchwenkHolderung



Die Kopfstütze kann je nach gewählter Ausführung abweichen.

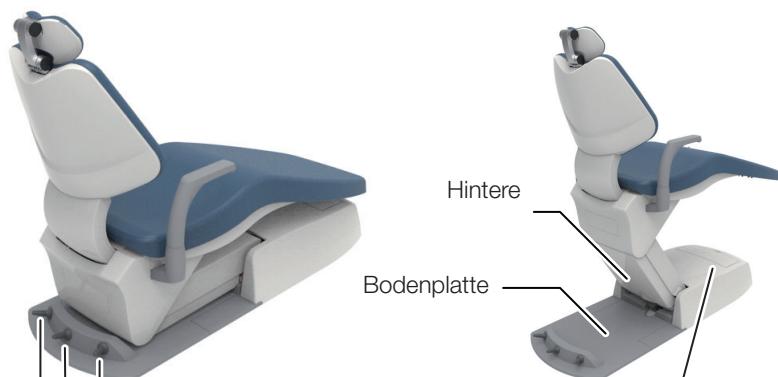


Die Position oder Verfügbarkeit des Joystick-SchHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

4-3-2 Kopfstütze

4-3-2-1 Kopfstütze (elektrohydraulisch)




4-3-2-2 Kopfstütze (manuell)

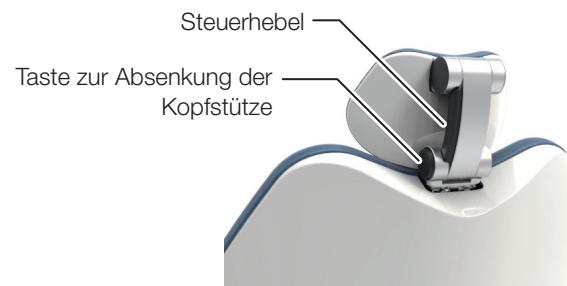


4–3–3 Fußanlasser (Kabel/Funk)

Typ 1

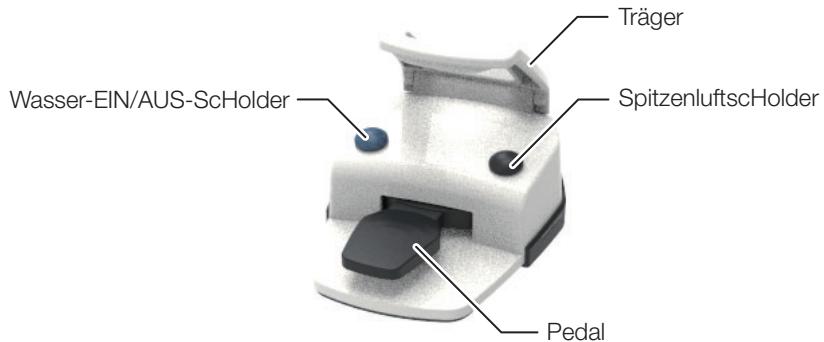


Typ 2

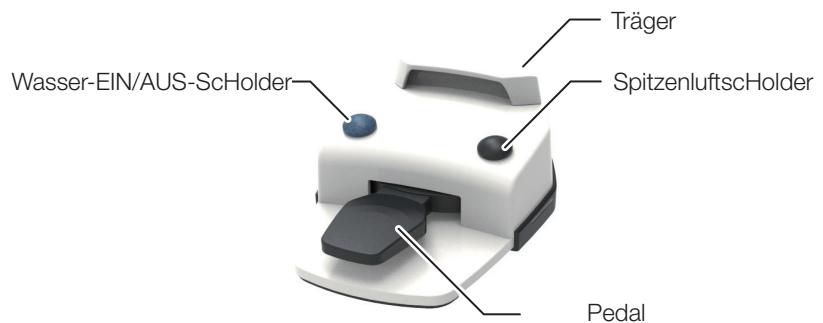

4–3–4 Fußanlasser

Typ 1

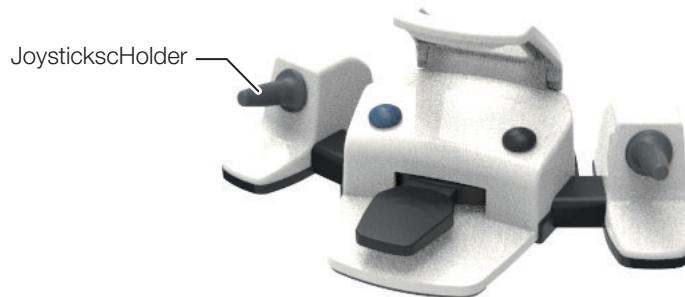

Typ 2



4-3-5 Arzteinheit

4-3-5-1 Ausleger der Arzteinheit


BodenplatteHolderung



Wagen




SchwenkHolderung

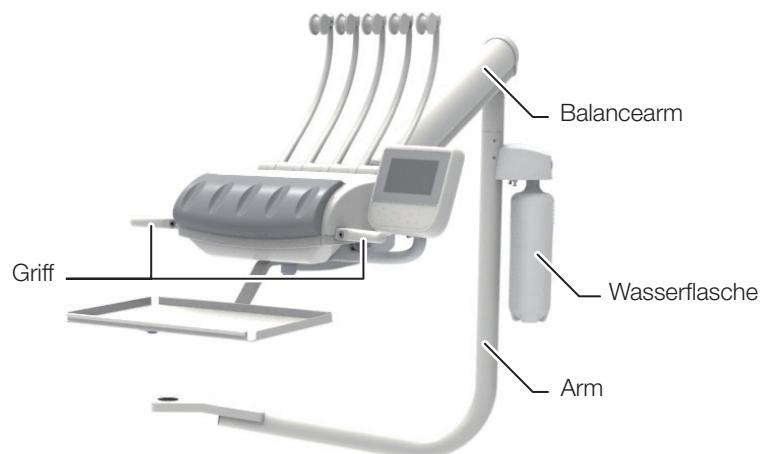


4–3–5–2 Instrumentenausleger


Holder

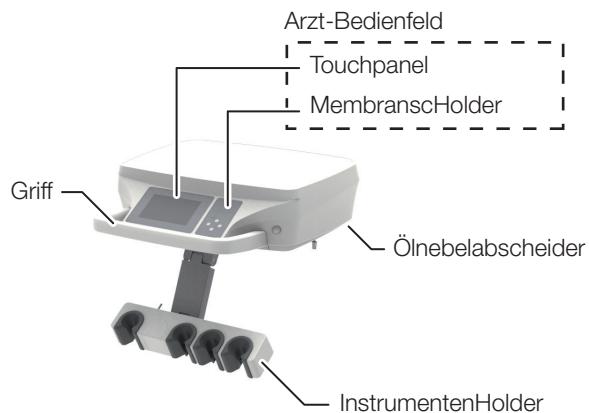


PlaceHolder

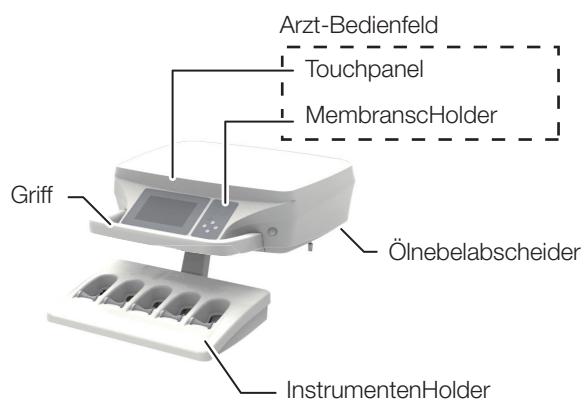

Stange

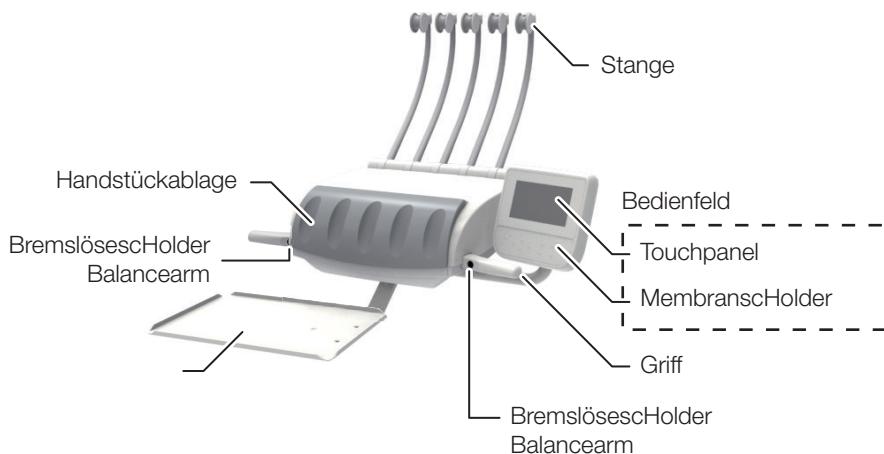


4-3-6 Mundspüleinheit

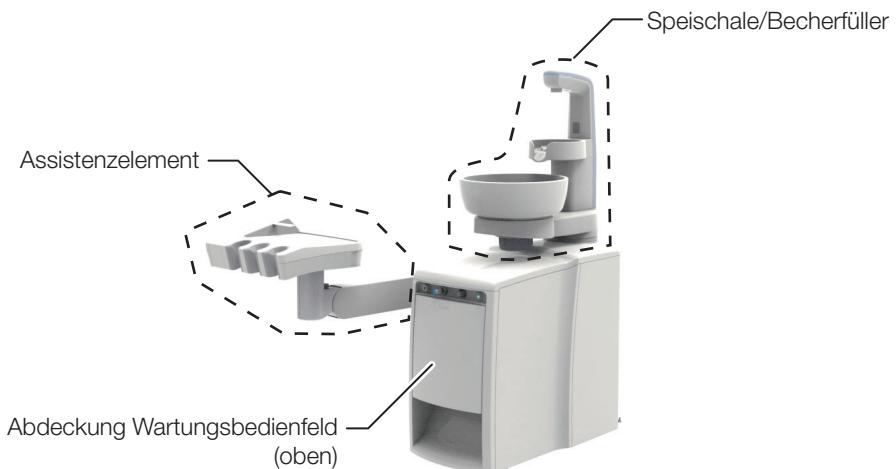


4-3-6-1 Speischale/Becherfüller



4–3–6–2 Wartungs-Bedienfeld

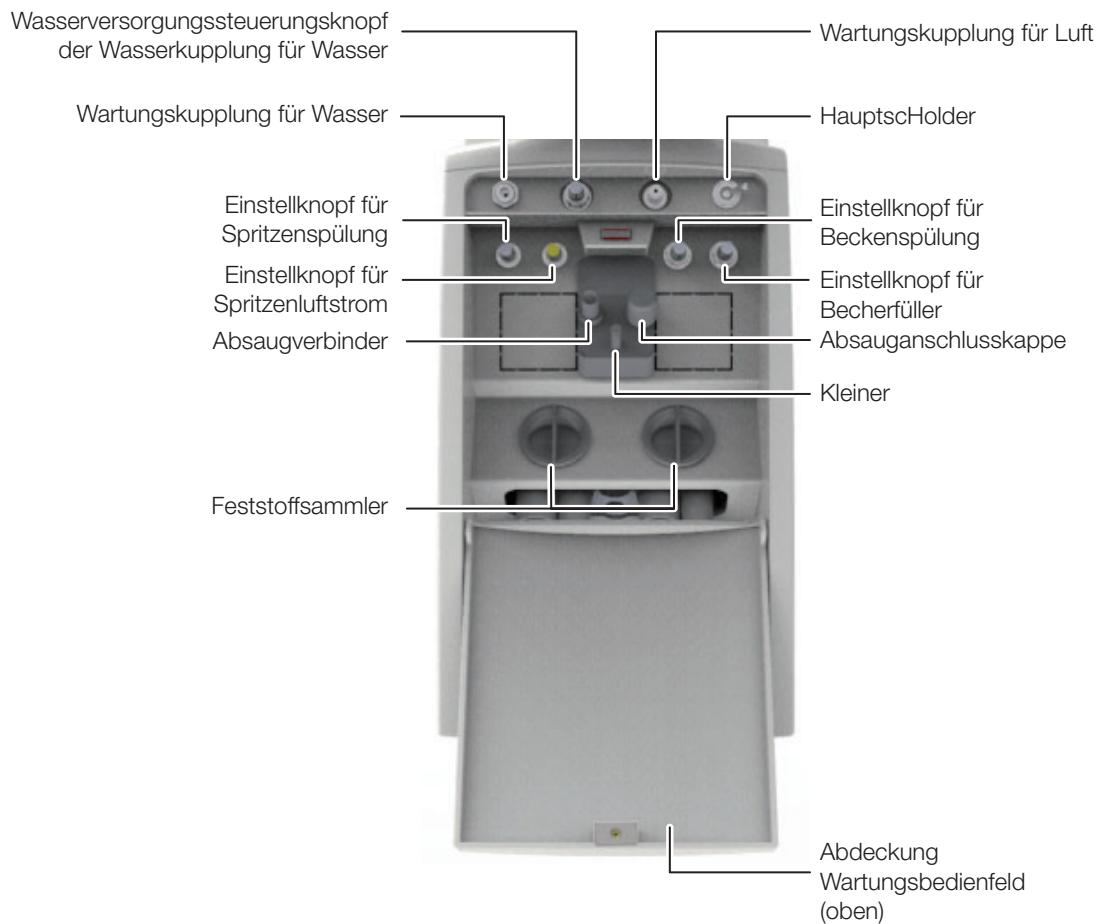


4-3-7 Vac Pac-Einheit

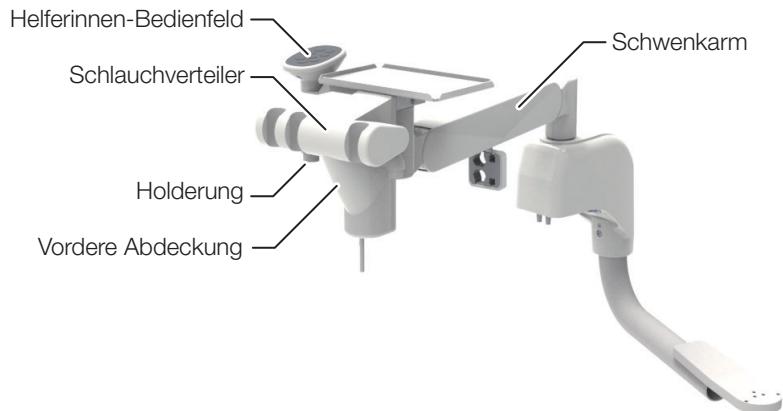


Hinweise zur Vorgehensweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Dürr-Produkte.

4-3-8 Assistenzelement

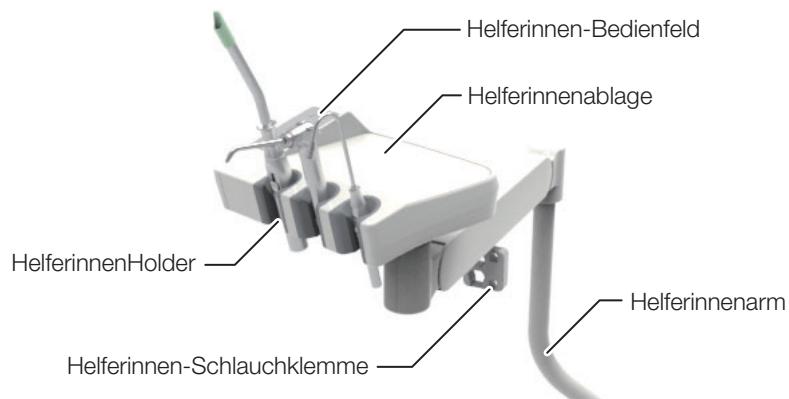

4-3-9 Anschlussclose

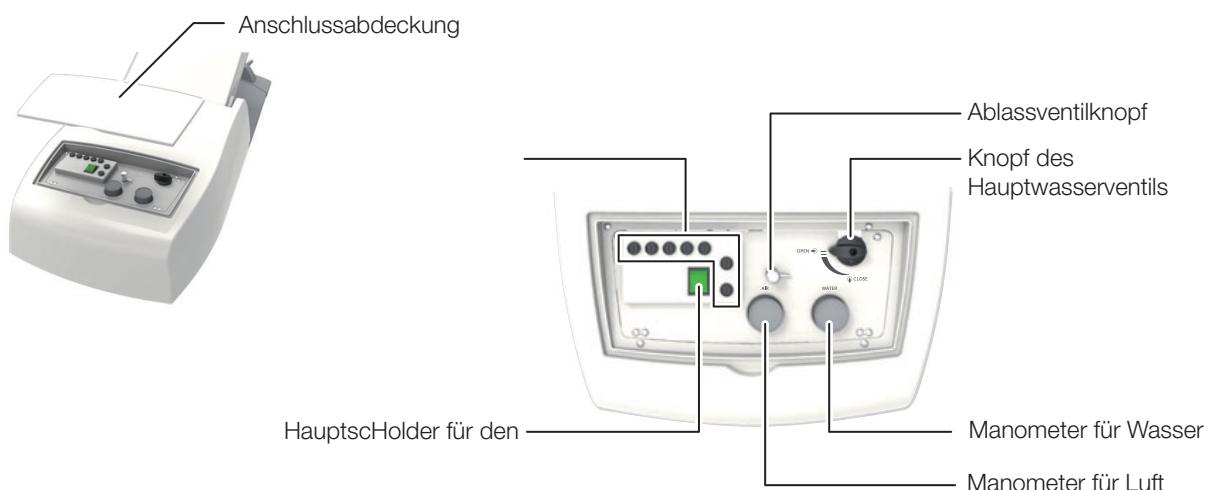

5–1 Vorbereitung vor der Verwendung

1 Hauptwasserventil öffnen


Drücken Sie den HauptscHolder für den Stuhl.

* Licht/Leuchtet beim Einschalten auf.

(1) Den mit  markierten Teil des Sitzes wie in der linken Abbildung gezeigt in eine Stellung anheben, die etwas Place oberhalb der Anschlussclose freilässt.

(2) Nehmen Sie die Anschlussabdeckung ab.

(3) Drehen Sie den Knopf des Hauptwasserventils im Uhrzeigersinn auf die Seite.

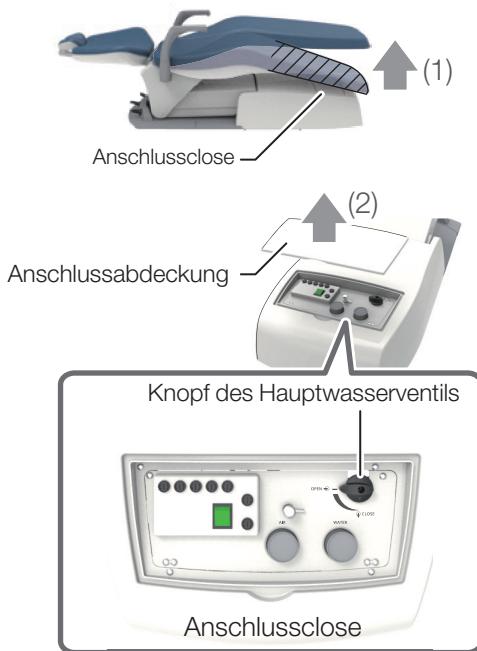

Knopf des Hauptwasserventils



Das Ventil ist geschlossen.



Das Ventil ist geöffnet.

2 Schalten Sie die Stromversorgung des Stuhls ein

Drücken Sie den HauptscHolder für den Stuhl.

* Licht/Leuchtet beim Einschalten auf.


VORSICHT

Betätigen Sie den HauptscHolder für den Stuhl mit der Hand.




5 Bedienung

Speischale

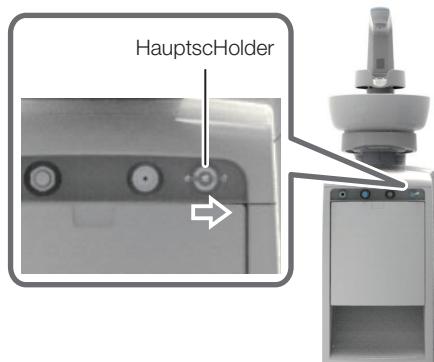

Vac Pac

Bei einer Vac Pac-Einheit befindet sich der HauptscHolder unter dem Arzttisch.

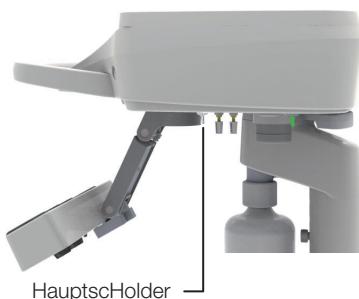

3 Schalten Sie den EURUS ein.

Drehen Sie den HauptscHolder nach rechts (I)

Beim Einschalten des HauptscHolders darf nichts auf dem Bodenplatte des Becherfüllers liegen. Möglicherweise wird sonst beim Betrieb des Becherfüllers das Wasser nicht normal zugeführt.

Beim Einschalten des HauptscHolders wird die Empfindlichkeit des Touchscreens initialisiert. Schalten Sie den HauptscHolder nicht ein, während Sie den Bildschirm mit den Fingern berühren.

Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, während Sie das Touchpanel berühren, kann dies zu einer Verringerung seiner Empfindlichkeit führen.

Wenn die Erkennung fehlerhaft ist, schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie ca. 5 Sekunden. Schalten Sie dann die Stromversorgung wieder ein.

VORSICHT



Betätigen Sie den HauptscHolder mit der Hand.

Ziehen Sie vor der ersten Anwendung die Folie vom Touchpanel ab. Die Verwendung des Touchpanels mit aufgeklebter Folie kann zu Fehlfunktionen führen und Verletzungen verursachen.




4 Überprüfen Sie den Startbildschirm und spülen Sie das zurückgebliebene Wasser aus

Schalten Sie den HauptscHolder ein. Die -Markierung wird auf dem Touchpanel angezeigt, der Einschaltton ist zu hören und die Informationen zur Programmversion werden einige Sekunden lang angezeigt.


Die Informationen zur Programmversion sind je nach Kauf- (Herstellungs-) Monat und Spezifikation verschieden.

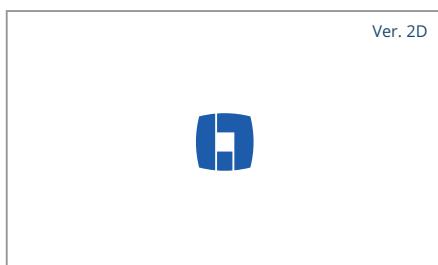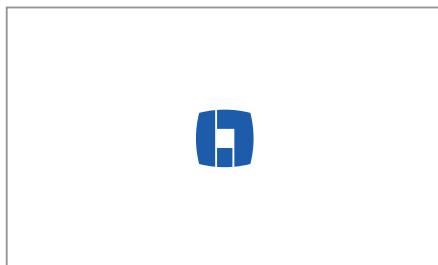


5 Bedienung

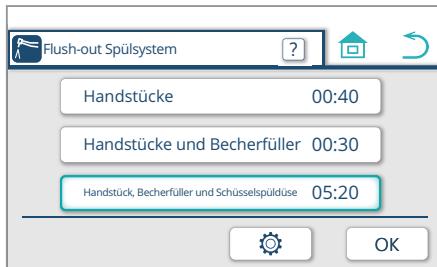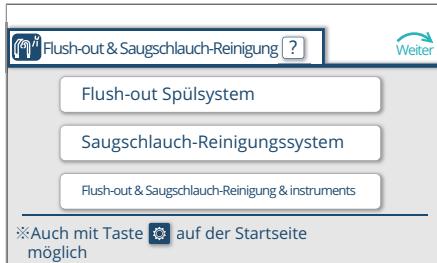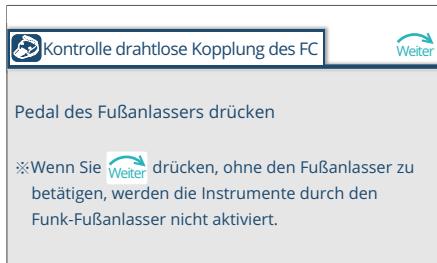

Für Ausführungen mit Vac Pac-Einheit

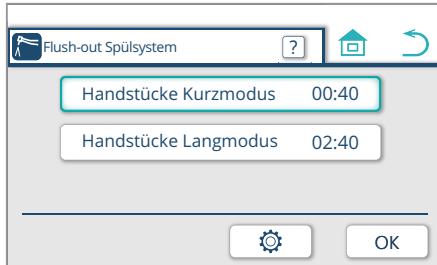

Ohne Waschfunktion für die Absaugleitung

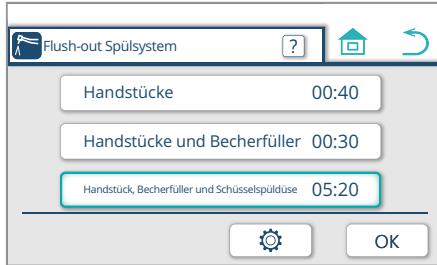

Halten Sie das Pedal des Funken Fußanlassers gedrückt, bis der Spülen-Bildschirm angezeigt wird.

Wenn das beim Niederhalten des Pedals am Fußanlasser nicht geschieht, sehen Sie unter „Fußanlasser (Kabel/Funk)“ nach [Seiten 146 bis 149].

* Der Drahtlos-Kopplungsbildschirm wird nicht angezeigt, wenn der Fußanlasser Kabel ist.

Drücken Sie den „Spülen“-Schalter.

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht vorhanden ist, wird der in der linken Abbildung dargestellte Bildschirm nicht angezeigt. Der Bildschirm mit dem Titel „Ohne Waschfunktion für die Absaugleitung“ wird angezeigt.

Der Spülen-Bildschirm wird angezeigt.

Führen Sie die Spülung durch und beachten Sie dabei den Abschnitt „Auswahl und Durchführung des Spülverfahrens“ [Seiten 171 bis 190].

* Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie Weiter.


* Bei Ausführungen mit Vac Pac-Einheit wird der links dargestellte Bildschirm angezeigt.

5 Bedienung

Startbildschirm



Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, wird der Startbildschirm angezeigt. Die Beschreibung der jeweiligen ScHolder und Anzeigen finden Sie unter „Bedienfeld für die Arzteinheit“ [Seiten 82 bis 105].



5 Reagieren Sie immer angemessen, wenn ein Fehler auftritt

Wenn beim Hochfahren ein Fehler auftritt, wird der Bildschirm für den Prüfmodus auf dem Touchpanel angezeigt. Beachten Sie die Erläuterungen [Seiten 260 bis 262] und ergreifen Sie die entsprechenden angegebenen Maßnahmen.

Drücken Sie den -ScHolder, um den nächsten Bildschirm anzuzeigen. Wenn fünf oder mehr Fehler aufgetreten sind, drücken Sie den -ScHolder, um weitere Fehler zu den auf der ersten Seite angegebenen zu überprüfen.

6 Überprüfung nach dem Hochfahren

- ① Überzeugen Sie sich davon, dass zurückgebliebenes Wasser vollständig abgelassen wurde.
- ② Betätigen Sie die ScHolder und den Fußanlasser, um zu überprüfen, ob der Stuhl und die Handstücke/Spritzen normal funktionieren.
(Schließen Sie die Handstücke/Spritzen an, bevor Sie die Funktionsprüfung durchführen.)

7 Vorbereitung des Verfahrens

- ① Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller an der Mundspüleinheit.
- ② Bringen Sie die Absaug-/Kleiner Speichelsaugerspitze am Absaug-/Kleiner Speichelsaugerhandstück an.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Wartung vor der Verwendung durchführen (Überprüfung nach dem Hochfahren, um zu bestätigen, dass das Produkt normal funktioniert).

Ein Betrieb ohne Wartungsprüfung kann zu Verletzungen und Schäden an Peripheriegeräten führen.




WARNUNG

5–2 Nach der Verwendung


1 Schalten Sie die Stromversorgung des Stuhls aus
Wenn sie ausgeschaltet ist, erlischt die Licht/Leuchte.

⚠️ VORSICHT

Betätigen Sie den HauptscHolder für den Stuhl mit der Hand.

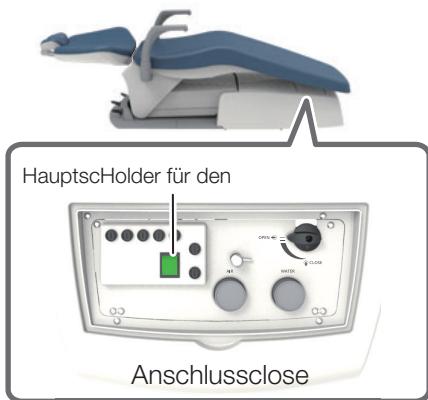

Speischale

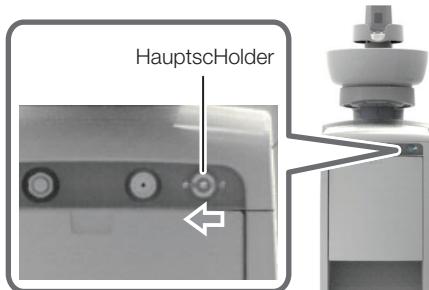

Vac Pac




2 Gerät ausschalten

Drücken Sie den HauptscHolder nach links herunter (○).

⚠️ VORSICHT

Betätigen Sie den HauptscHolder mit der Hand.

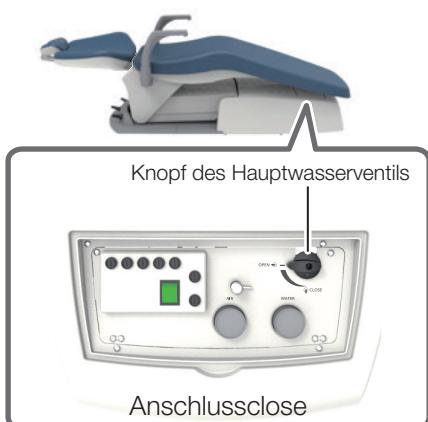

Knopf des Hauptwasserventils



Das Ventil ist geöffnet.



Das Ventil ist geschlossen.

3 Schließen Sie das Hauptwasserventil

Drehen Sie den Hauptwasserventilknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis der Knopf senkrecht steht.

⚠️ VORSICHT

Achten Sie darauf, das Hauptwasserventil am Ende des Tages zu schließen, um ein versehentliches Auslaufen zu vermeiden.

5–3 Betätigen des HauptscHolders für den Stuhl während der Behandlung (wenn der HauptscHolder für den Stuhl verfügbar ist)

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Stuhls aus
Drücken Sie den HauptscHolder für den Stuhl.

Touchpanel



Beim Ausschalten des Stuhls wird „E06: Kommunikation mit Stuhl“ auf dem Touchpanel angezeigt, da die Verbindung zwischen der Einheit und dem Stuhl unterbrochen ist, anschließend Licht/Leuchtet die LED-Anzeige der Mundspül-Einheit orange auf, was keine Fehlfunktion ist.

LED-Anzeige



2 Schalten Sie die Stromversorgung des Stuhls ein
Drücken Sie den HauptscHolder für den Stuhl.

Drücken Sie den HauptscHolder für den Stuhl, wenn mindestens 5 Sekunden nach dem Einschalten des HauptscHolders vergangen sind.

5 Bedienung

5–4 Anheben/Absenken des Stuhls und Aufrichten/Zurücklehnen der Rückenlehne (manueller Betrieb)

Wagen/SchwenkHolderung



Joystick-SchHolder für den manuellen


Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-SchHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

Arzt-Bedienfeld
MembranscHolder (Holder)




SchHolder für manuellen Betrieb

MembranscHolder (Stange)

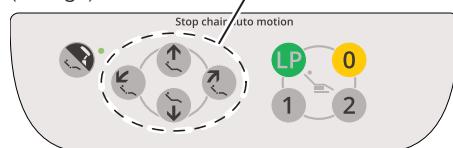

Helferinnen-Bedienfeld
(Ausführung mit Vac Pac-Einheit)



SchHolder für manuellen Betrieb

Joystick-SchHolder		Bedienfeld-SchHolder	Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber		
			Der Stuhl wird angehoben
			Der Stuhl wird abgesenkt
			Die Rückenlehne wird angehoben
			Die Rückenlehne wird geneigt

* Der Stuhl wird weiter verstellt, solange der Joystick-SchHolder nach unten gedrückt oder der SchHolder betätigt wird.

⚠️ WARNUNG


Vergewissern Sie sich vor dem Anheben/Absenken des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Achten Sie vor dem Zurücklehnen der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen die Rückenlehne und den Sitz geraten.

Achten Sie vor dem Aufrichten der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen die Rückenlehne und die Armlehne geraten.

[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein Patient Place genommen hat [Seite 20]

5 Bedienung

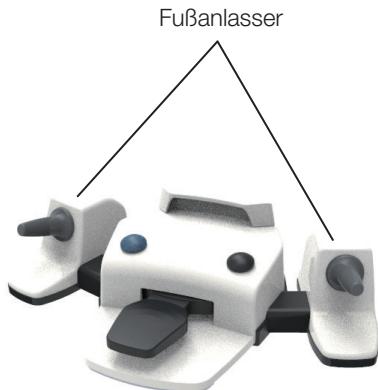

Fußanlasser

Joystick-SchHolder		Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber	
		Der Stuhl wird angehoben
		Der Stuhl wird abgesenkt
		Die Rückenlehne wird angehoben
		Die Rückenlehne wird geneigt

* Der Stuhl wird bedient, indem der Fußanlasser nach unten gedrückt wird.

WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Anheben/Absenken des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Achten Sie vor dem Zurücklehnen der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen die Rückenlehne und den Sitz geraten.

Achten Sie vor dem Aufrichten der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen die Rückenlehne und die Armlehne geraten.

[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein Patient Place genommen hat [Seite 20]

5–5 Den Stuhl in die Voreinstellungsposition bewegen (automatischer Betrieb)


Wagen/SchwenkHolderung



Joystick-SchHolder für den automatischen

Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-SchHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.


Arzt-Bedienfeld
MembranschHolder
(Holder)




SchHolder für
automatischen Betrieb

MembranschHolder
(Stange)

SchHolder für
automatischen Betrieb

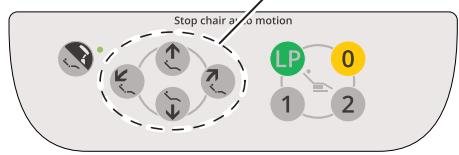


Helferinnen-Bedienfeld
(Ausführung mit
Assistenzelement)



SchHolder für
automatischen Betrieb

Helferinnen-Bedienfeld
(Ausführung mit Vac
Pac-Einheit)



	Joystick-SchHolder		Bedienfeld-SchHolder	Bedienung
	Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber		
I			1 1	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Behandlungsposition 1“ gefahren.
II			2 2	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Behandlungsposition 2“ gefahren.
III			0 0	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Einstiegs-/Ausstiegsposition“ gefahren. Durch erneutes Drücken nach Abschluss der Bewegung wird die Kopfstütze in ihre Holderung gefahren (elektrohydraulisch).
IV			LP LP	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Mundspülposition“ gefahren. Durch erneutes Drücken nach Abschluss der Bewegung wird der Stuhl wieder in die Position gefahren, die er vor der „Mundspülposition“ eingenommen hat.

Halten Sie die VoreinstellungsschHolder 1 und 2, den automatischen RückkehrschHolder 0 und den Letzte-Position-SchHolder LP nicht länger als fünf Sekunden gedrückt. Wenn Sie sie fünf Sekunden oder länger gedrückt gehalten haben, ist ein Summerton zu hören und die aktuelle Stuhlposition wird als Voreinstellungsposition gespeichert.

[Referenz] Einstellung des automatischen Betriebs [Seite 168]


⚠️ WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor der Bewegung des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

5–6 Bedienung der Kopfstütze (manueller Typ)

Einstellung der Kopfstütze

Die Kopfstütze (manueller Typ) kann flexibel an die Neigung des Kopfes des Patienten für die Behandlung im Ober-/Unterkiefer angepasst werden. Sie können ebenfalls die Kopfstütze entsprechend der Körpergröße des Patienten manuell nach oben/unten verschieben.

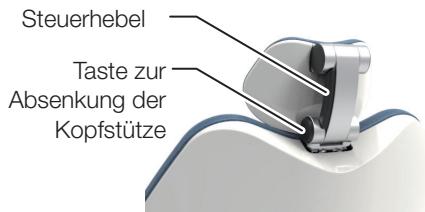

Winkel und Verstellung nach oben/nach unten der Kopfstütze



Einstellung des Winkels der Kopfstütze

1. Halten Sie Ihre Hand unter die Kopfstütze, um den Kopf des Patienten zu stützen.
2. Drücken Sie mit der anderen Hand den Steuerhebel, um die Kopfstütze zu bewegen.
3. Stellen Sie die Kopfstütze auf einen Winkel ein, der der erforderlichen Behandlung entspricht, und lassen Sie den Steuerhebel los, um die Kopfstütze zu verriegeln.

Nach-oben/unten-Einstellung der Kopfstütze

1. Um die Kopfstütze anzuheben, ziehen Sie sie langsam nach oben und halten Sie sie dabei fest.
2. Um die Kopfstütze abzusenken, legen Sie Ihre Hand auf die Kopfstütze und ziehen Sie sie langsam nach unten, während Sie die Taste zum Absenken der Kopfstütze drücken.

Belasten Sie die Kopfstütze nicht übermäßig und stoßen Sie nicht zu stark dagegen, während sie ausgefahren ist. Schlagen Sie nicht von oben auf die Kopfstütze. Andernfalls kann eine Fehlfunktion verursacht werden.


⚠️ WARNUNG

Wenn Sie die Rückenlehne mit ausgefahrener Kopfstütze verstehen möchten, achten Sie darauf, dass kein Gegenstand dies behindert oder in Kontakt mit dem Stuhl gerät. Sonst kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen.

Achten Sie bei der Bedienung der Kopfstütze darauf, dass sich Ihre Hände und Finger nicht im Steuerhebel verfangen oder zwischen der Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt werden.

Wenn Sie den Winkel der Kopfstütze einstellen oder diese nach oben oder unten bewegen, halten Sie stets die Kopfstütze mit Ihrer Hand fest und stützen Sie den Kopf des Patienten. Andernfalls kann ein Unfall oder eine Verletzung auftreten.

Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze nicht klappert oder ungewöhnliche Geräusche macht. Wenn die Kopfstütze verstellt wird, während sie klappert, kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.

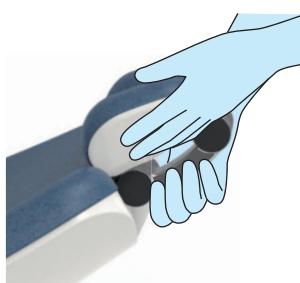


Kopfstütze (elektrohydraulisch)



Joystick-SchHolder für die Kopfstütze (elektrohydraulisch)


Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-SchHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

Arzt-Bedienfeld
MembranschHolder (Holder)

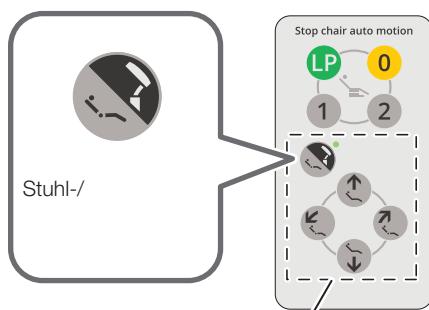

SchHolder für
manuellen Betrieb

MembranschHolder
(Stange)

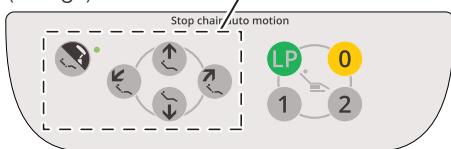

5–7 Bedienung der Kopfstütze (elektrohydraulisch Typ)

Wagen/SchwenkHolderung

Für die Bedienung im manuellen Betrieb drücken Sie den Stuhl-/KopfstützenschHolder um zur Kopfstützenfunktion umzuschalten (die Licht/Leuchte Licht/Leuchte auf).

Joystick-SchHolder	Bedienfeld-SchHolder	Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber	
		Anheben
		Einfahren
		Anheben
		Zurücklehnen

* Die Kopfstütze wird bedient, indem der Joystick-SchHolder nach unten gedrückt oder der SchHolder gedrückt wird.

Belasten Sie die Kopfstütze nicht übermäßig und stoßen Sie nicht zu stark dagegen, während sie ausgefahren ist. Schlagen Sie nicht von oben auf die Kopfstütze. Andernfalls kann eine Fehlfunktion verursacht werden.

WARNUNG

Überzeugen Sie sich vor dem Verstellen der Kopfstütze, dass der Kopf des Patienten in der richtigen Position ist. Der Bediener darf den Patienten während des Verstellvorgangs nicht aus den Augen lassen.


[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein Patient Place genommen hat [Seite 20]

Verwenden Sie die Kopfstütze nicht in einem Winkel, der für den Patienten unangenehm ist.

Überzeugen Sie sich beim Verstellen der Kopfstütze davon, dass kein Gegenstand sie behindert. Achten Sie sehr sorgfältig darauf, dass kein Gegenstand oder Körperteil zwischen Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt wird.

Wenn die Rückenlehne bei sitzendem Patienten zurückgelehnt ist, darf die Kopfstütze nicht angehoben oder abgesenkt werden, solange sich der Kopf des Patienten darauf befindet.]

5 Bedienung

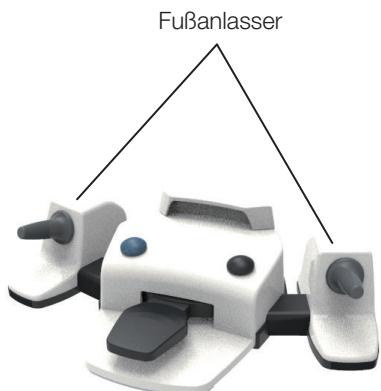

Fußanlasser

Joystick-SchHolder		Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber	
		Anheben
		Einfahren
		Anheben
		Zurücklehnen

* Der Stuhl wird bedient, indem der Fußanlasser nach unten gedrückt wird.

Belasten Sie die Kopfstütze nicht übermäßig und stoßen Sie nicht zu stark dagegen, während sie ausgefahren ist. Schlagen Sie nicht von oben auf die Kopfstütze. Andernfalls kann eine Fehlfunktion verursacht werden.

WARNUNG

Überzeugen Sie sich vor dem Verstellen der Kopfstütze, dass der Kopf des Patienten in der richtigen Position ist. Der Bediener darf den Patienten während des Verstellvorgangs nicht aus den Augen lassen.

Verwenden Sie die Kopfstütze nicht in einem Winkel, der für den Patienten unangenehm ist.

Überzeugen Sie sich beim Verstellen der Kopfstütze davon, dass kein Gegenstand sie behindert. Achten Sie sehr sorgfältig darauf, dass kein Gegenstand oder Körperteil zwischen Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt wird.
[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein Patient Place genommen hat [Seite 20]

Wenn die Rückenlehne bei sitzendem Patienten zurückgelehnt ist, darf die Kopfstütze nicht angehoben oder abgesenkt werden, solange sich der Kopf des Patienten darauf befindet.

5–8 Drehen der Armlehne

Wenn die Armlehne den Einstieg/Ausstieg oder die Behandlung behindert, kann sie nach hinten gedreht werden.

Sowohl die linke als auch die rechte Armlehne kann gedreht werden.

(1) Ziehen Sie den Ansatz der Armlehne (Rückseite) nach oben.



(2) Drehen Sie die Armlehne nach hinten, während Sie sie in der oberen Stellung halten.

Drehwinkel: 90 oder 135 Grad



(3) Um die Armlehne wieder in die ursprüngliche Position zu bringen, drehen Sie sie auf die gleiche Weise nach vorne. Die Armlehne ist verriegelt, wenn sie sich in der normalen Position befindet



VORSICHT

Vergewissern Sie sich beim Drehen des Armlehne, dass dies nicht behindert wird. Der Bediener muss darauf achten, dass seine Hände oder Finger nicht eingeklemmt werden.

Verstellen Sie den Stuhl nicht, während die Armlehne nach hinten gedreht wurde. Drehen Sie die Armlehne in die Normalposition zurück, bevor Sie den Stuhl verstehen.

5–9 Bedienung des Arzttisches BodenplatteHolderung



Verstellen des Arzttisches nach vorn/hinten und rechts/links
Halten Sie den Griff fest und bewegen Sie langsam den Arzttisch.


WARNUNG

Üben Sie keine Last über 3 kg auf den Arzttisch aus.
Sonst kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen.

Höheneinstellung des Arzttisches Der Arzttisch ist auf drei Höhen verstellbar.

Fahren Sie nach der Einstellung den Arzttisch nach rechts und links, um sich davon zu überzeugen, dass die Verstellung des Tisches nach unten blockiert ist.

* Die Stuhlsperrfunktion wird aktiviert, wenn eine starke Kraft von oben oder unten auf den Arzttisch ausgeübt wird.

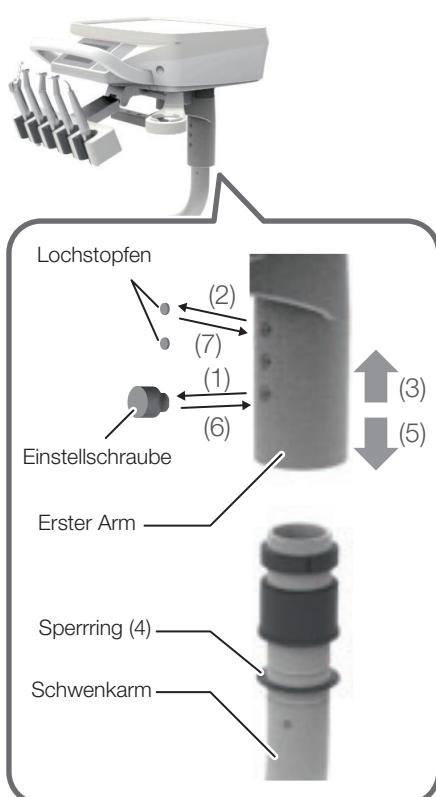

Einstellen der Höhe

- (1) Drehen Sie die Einstellschraube heraus.
- (2) Entfernen Sie die Lochstopfen (2 Stellen).
- (3) Ziehen Sie den ersten Arm nach oben.
- (4) Verschieben Sie den Sicherungsring in die Nut für die gewünschte Tischhöhe.
- (5) Führen Sie den ersten Arm in seine vorige Position zurück.
- (6) Setzen Sie die Einstellschraube in das Loch ein, das der Position des Sicherungsring entspricht.

- | | |
|---|---|
|  - - - | Sperrring: An der unteren Nut ansetzen
(50 mm niedriger als in der Werkseinstellung) |
|  - - - | Sperrring: An der mittleren Nut ansetzen
(25 mm niedriger als in der Werkseinstellung) |
|  - - - | Ausgangsposition (Werkseinstellung)
(höchste Position) |


- (7) Setzen Sie die Lochstopfen in die offenen Löcher ein (2 Stellen).

WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Einstellen der Tischhöhe, dass der HauptscHolder ausgeschaltet ist. Ein unbeabsichtigtes Betätigen der ScHolder oder des Pedals führt zu einer unerwarteten Bewegung des Produkts, was zu Verletzungen führen kann.

5 Bedienung

Wagen

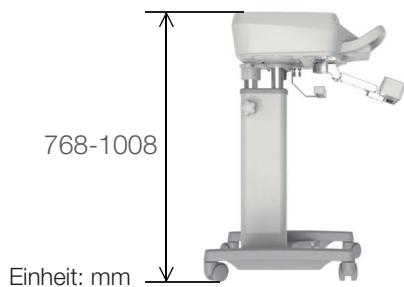

Die Höhe des Arzttisches kann in dem in der linken Abbildung gezeigten Bereich eingestellt werden.

Um die Höhe zu ändern, lösen Sie den Feststellknopf und ziehen Sie den Arzttisch nach oben/nach unten.

Nachdem Sie die Höhe auf die gewünschte Position eingestellt haben, ziehen Sie den Feststellknopf fest an.


Feststellknopf lösen → gegen den Uhrzeigersinn drehen
Feststellknopf festziehen → im Uhrzeigersinn drehen

Wenn Sie den Arzttisch nach oben/unten verstehen, ohne den Feststellknopf zu lösen, kann das Produkt beschädigt werden.

Lösen Sie unbedingt zuerst den Feststellknopf und verstehen Sie anschließend den Arzttisch nach oben/unten.



Balancearm

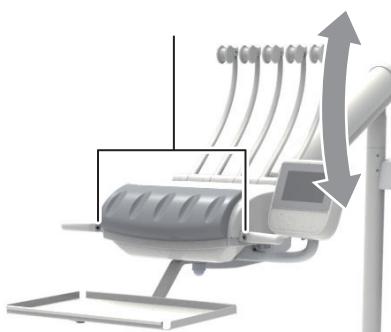


SchwenkHolderung

Höheneinstellung des Arzttisches (Stange)

Die BremslösescHolder für den Balancearm befinden sich am Griff.

Fassen Sie den Griff und drücken Sie den BremslösescHolder für den Balancearm, um die Bremse zu lösen und die Tischhöhe einzustellen.

Lassen Sie den BremslösescHolder für den Balancearm in der gewünschten Tischposition los und der Balancearm wird verriegelt.

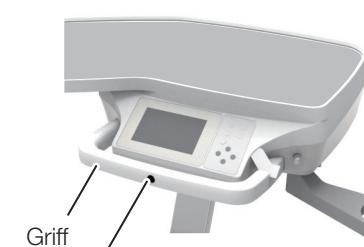

Höheneinstellung des Arzttisches (Holder)

Die Höhe des Arzttisches kann in dem in der linken Abbildung gezeigten Bereich eingestellt werden.


Um die Höhe zu ändern, lösen Sie zuerst die Bremse, indem Sie den BremslösescHolder für den Balancearm in der Mitte des Griffes drücken. Fahren Sie anschließend den Arzttisch nach oben/unten.



Wenn Sie den Arzttisch nach oben/unten verstehen, ohne die Bremse zu lösen, kann das Produkt beschädigt werden.

Lösen Sie immer zuerst die Bremse, indem Sie auf den BremslösescHolder drücken. Fahren Sie anschließend den Arzttisch nach oben/unten.

5-10 Bedienung der Helferinnenablage

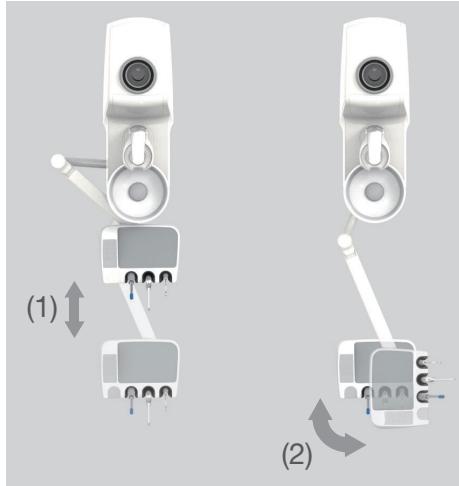

(1) Helferinnenablage nach vorn/hinten verstellen

Halten Sie die Helferinnenablage fest und schieben Sie sie langsam nach vorn/hinten.


(2) Helferinnenablage drehen

Halten Sie die Helferinnenablage fest und drehen Sie sie langsam. Es ist möglich, nur die Ablage zu drehen.

Achten Sie beim Verstellen der Helferinnenablage nach vorne/hinten darauf, dass nichts auf der Helferinnenablage liegt.

WARNUNG

Üben Sie keine Last über 1,5 kg auf die Helferinnenablage aus. Sonst kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen.

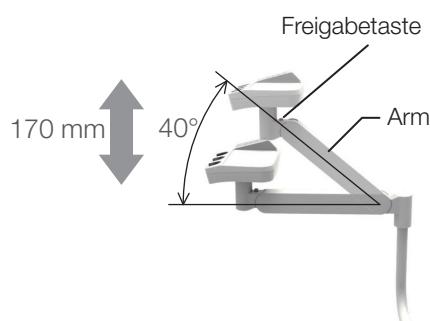

Höhenverstellung der Helferinnenablage

Die Höhe der Ablage kann durch Feststellen des Armwinkels im Bereich zwischen 0 und 40 Grad eingestellt werden (siehe die Abbildung links). Verschieben Sie die Ablage und halten Sie den Arm fest, um die Höhe zu verändern.

Höher stellen

Halten Sie die Ablage fest und schieben Sie sie nach oben.

Niedriger stellen

Schieben Sie zuerst den Arm nach oben und halten Sie die Freigabetaste gedrückt, schieben Sie ihn anschließend nach unten.

Schieben Sie die Ablage auf die gewünschte Höhe und lassen Sie die Freigabetaste los.

Achten Sie bei der Höheneinstellung der Helferinnenablage darauf, dass nichts auf der Ablage liegt.

Um eine niedrigere Höhe einzustellen, müssen Sie die Freigabetaste während der Einstellung gedrückt halten.

Wenn eine niedrigere Höhe eingestellt wird, ohne die Freigabetaste zu drücken, kann das Produkt beschädigt werden

⚠️ WARNUNG

Üben Sie keine Last über 1,5 kg auf die Helferinnenablage aus. Sonst kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen.



5-11 Handstück

Wenn ein anderes Handstück als die Spritze vom InstrumentenHolder aufgenommen wird, erscheint auf dem Touchpanel der Bedienungsbildschirm für das Handstück. Betätigen Sie anschließend den Fußanlasser, um das Gerät zu bewegen.



[Referenz]	Mikromotor	[Seiten 116 bis 129]
	Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät	[Seiten 130 bis 132]
	Luftturbine/Motor	[Seiten 133 bis 135]
	Saughandstück	[Seite 152]
	Kleiner Speichersauger-Handstück	[Seite 152]
	Fußanlasser (Kabel/Funk)	[Seite 146]

(Anzeigbeispiel) Mikromotor MX2

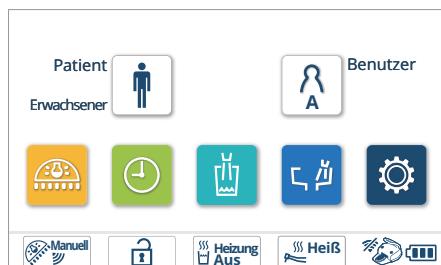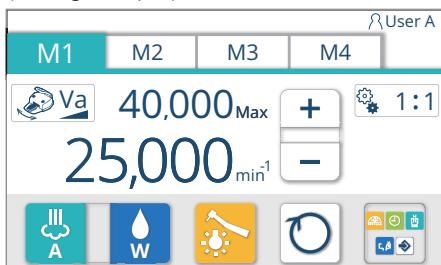

	Spritze
Instrument	Mikromotor
Handstück	Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät
	Luftturbine
	Luftmotor
	Saughandstück
	Kleiner Speichersauger-Handstück

Wenn das Handstück in den InstrumentenHolder zurückgelegt wird, wird der Startbildschirm angezeigt.




Handstück-Prioritätsfunktion (erste Priorität)

Nur das zuerst aufgenommene Handstück kann bedient werden.

Wenn zwei oder mehr Handstücke aus dem InstrumentenHolder aufgenommen werden und das zuerst aufgenommene Handstück in den Holder zurückgesetzt wird, wird eine Meldung [C12: Priorität Instrumente] angezeigt.

Diese Meldung verschwindet, wenn alle Handstücke in den InstrumentenHolder zurückgesetzt worden sind.

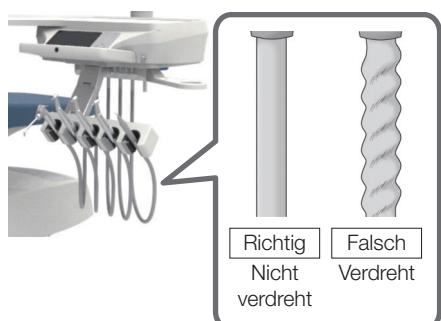

VORSICHT



Wiederholtes Aufnehmen und Zurücksetzen des Handstücks kann dazu führen, dass sich der Schlauch verdreht.

Prüfen Sie den Schlauch regelmäßig, um sicherzustellen, dass er nicht verdreht ist. Wenn er verdreht ist, entfernen Sie die Verwicklung vor dem Gebrauch. Die kontinuierliche Verwendung des Handstücks mit verdrehtem Schlauch führt dazu, dass Knicke im Schlauch entstehen oder der Draht bricht und das Handstück somit unbrauchbar wird.

5-12 Bedienfeld der Arzteinheit

Touchpanel (Startbildschirm)

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Anzeigen und ScHolder auf dem Touchpanel.

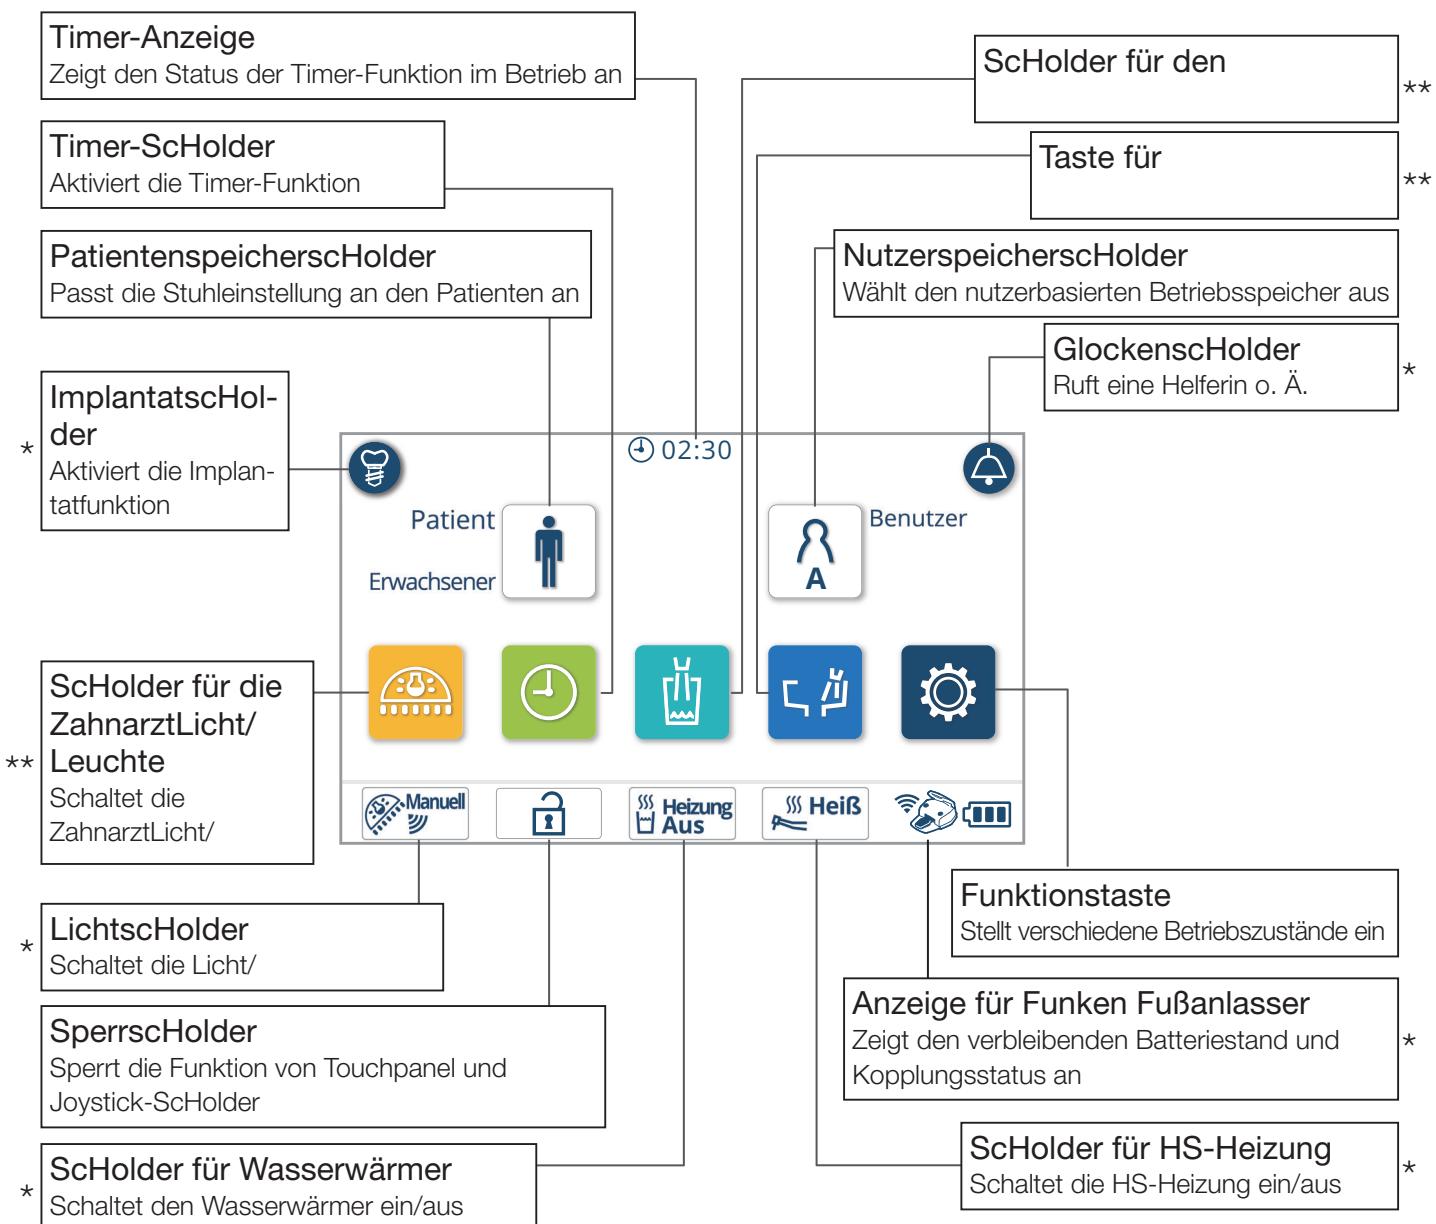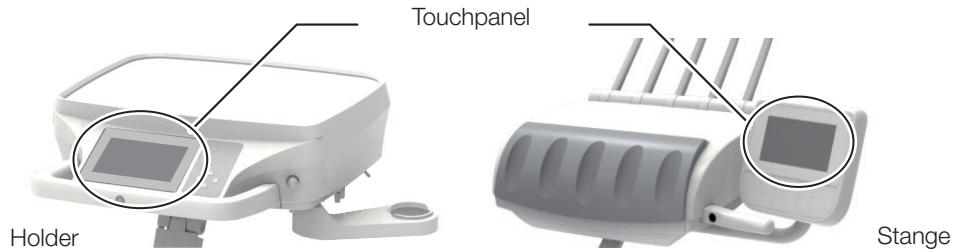


* Wird nicht angezeigt, wenn die Funktion nicht installiert ist

** Wird grau angezeigt, wenn die Funktion nicht installiert ist.

Touchpanel (Handstück-Bildschirm)


Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Anzeigen und ScHolder auf dem Touchpanel.

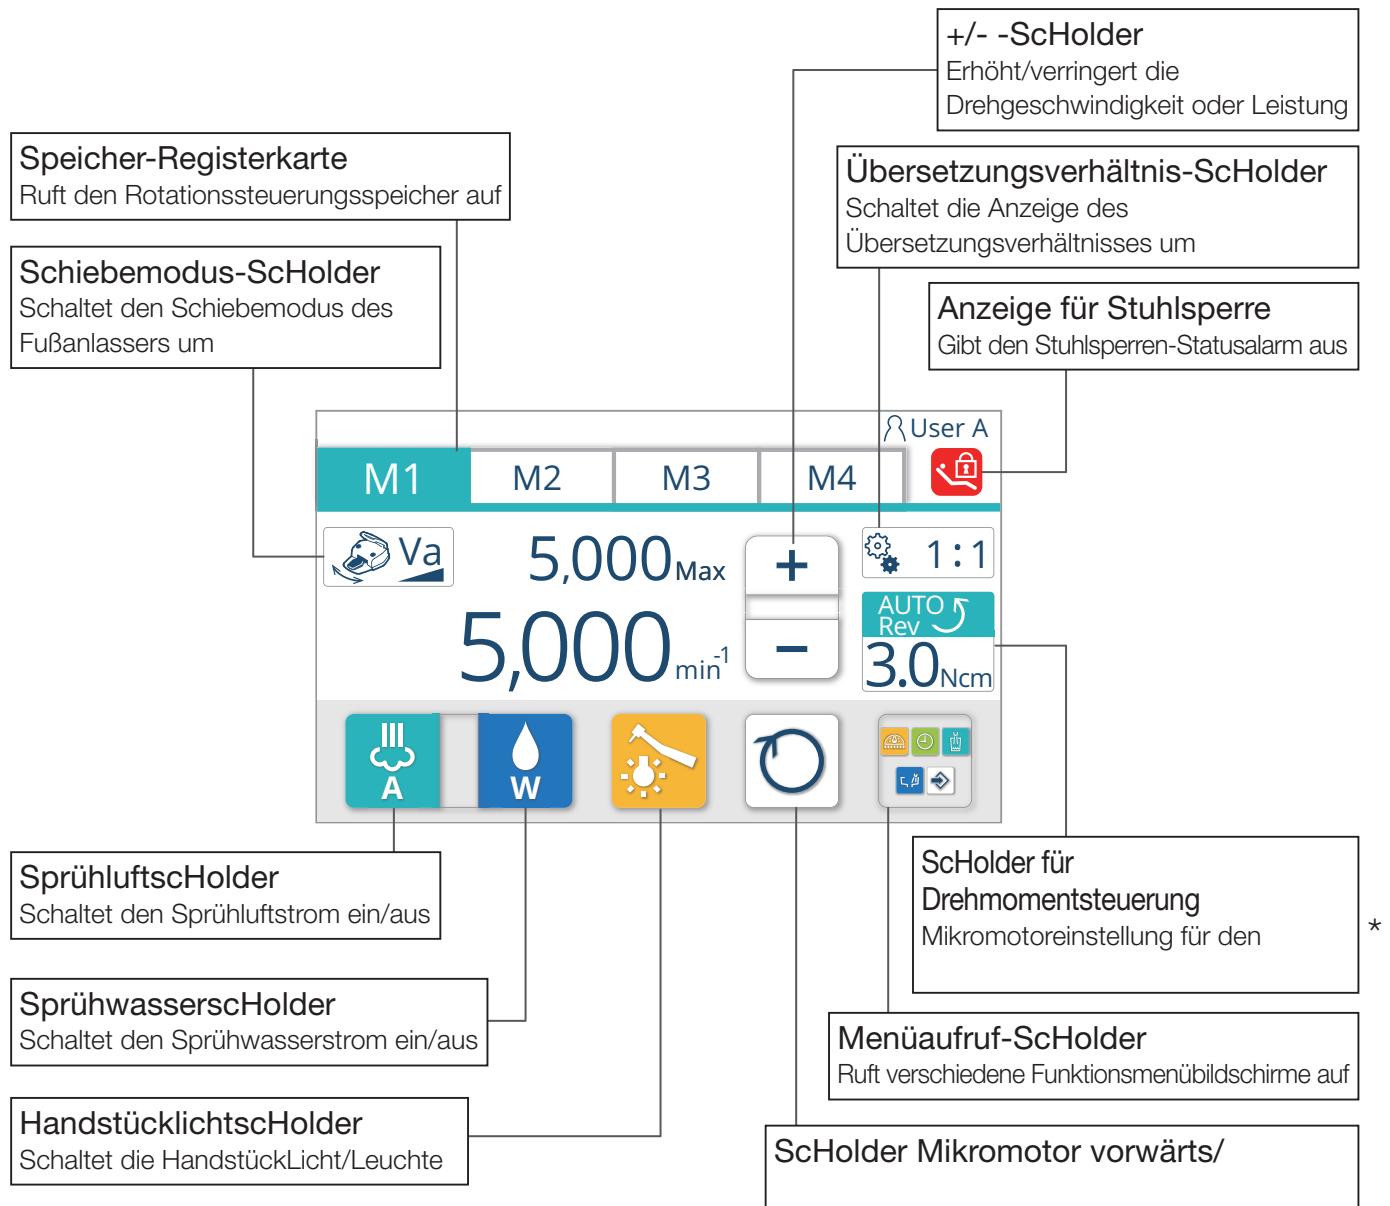

* Wird nicht angezeigt, wenn die Funktion nicht installiert ist

Touchpanel (Implantatbildschirm)


Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Anzeigen und ScHolder auf dem Touchpanel.

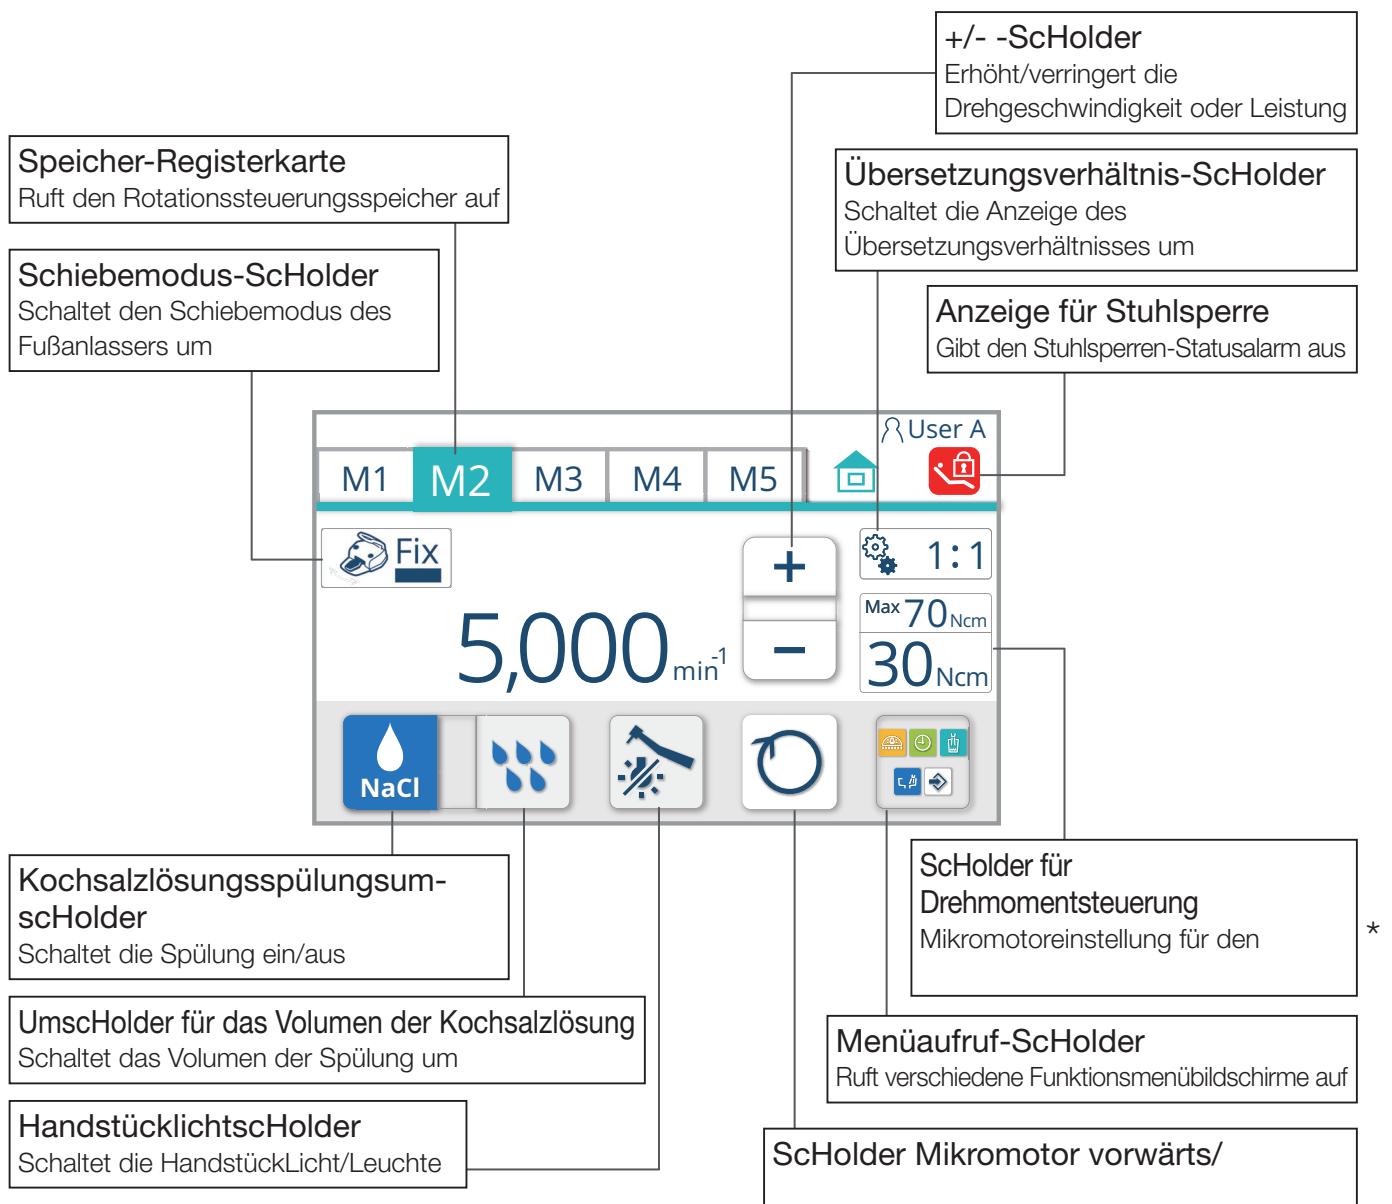

* Wird nicht angezeigt, wenn die Funktion nicht installiert ist

MembranscHolder

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Anzeigen und ScHolder auf dem Bedienfeld.

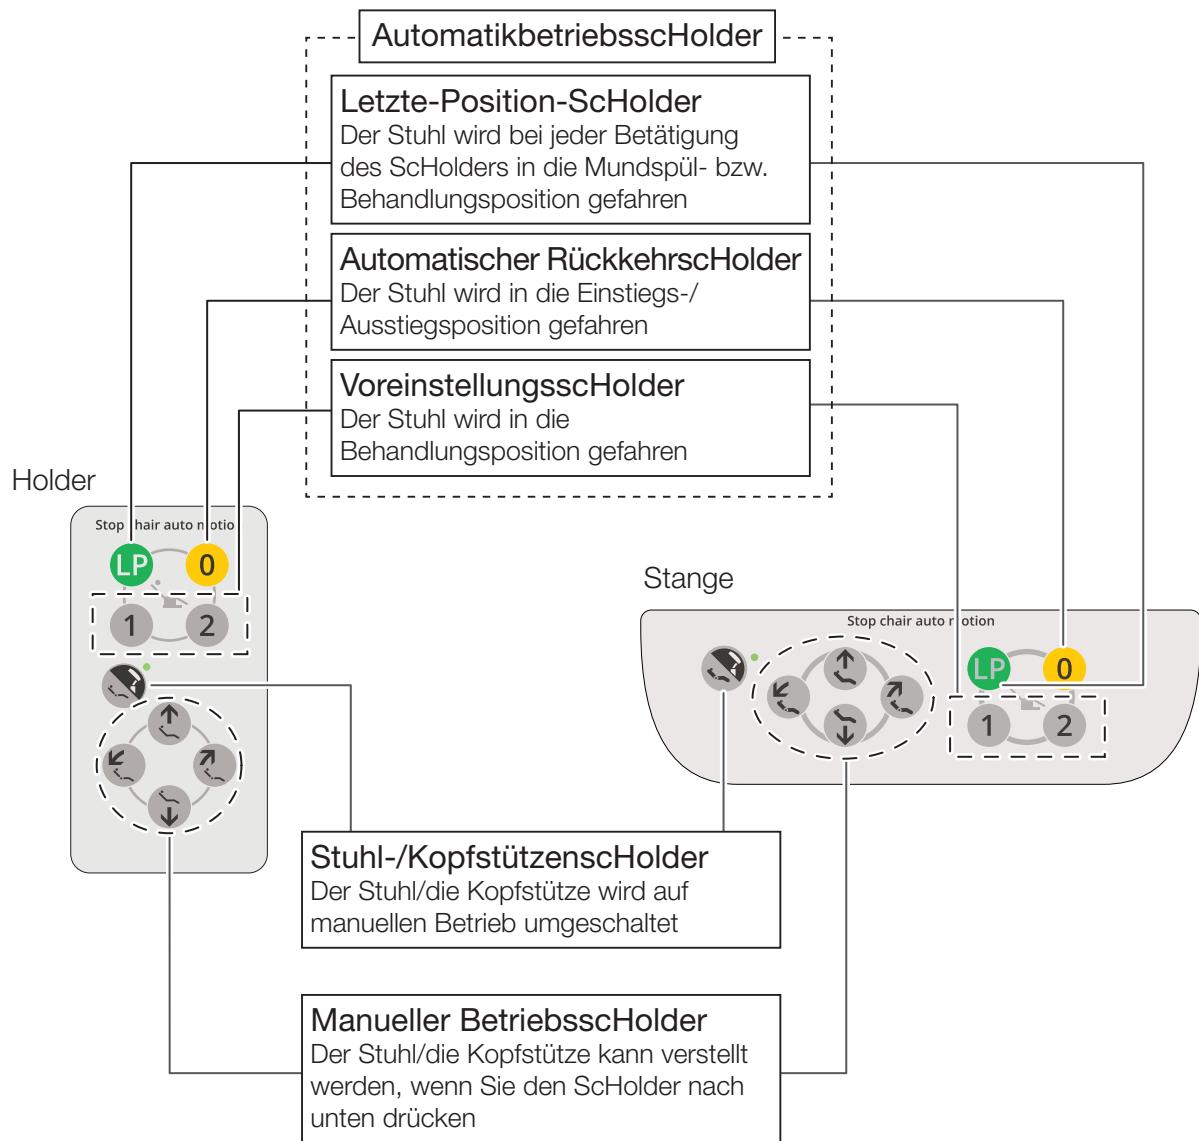

LP

Letzte-Position-SchHolder

Wenn er in der Behandlungsposition gedrückt wird, fährt der Stuhl in die Mundspülposition.

Wenn der SchHolder erneut gedrückt wird, kehrt der Stuhl in die Behandlungsposition zurück, die er vor der Mundspülung hatte.

0

Automatischer RückkehrscHolder

Der Stuhl wird in die Einstiegs-/Ausstiegsposition gefahren.

* Bei der Kopfstütze (elektrohydraulisch) wird durch abermaliges Drücken dieses Schholders, nachdem der Stuhl zum Stillstand gekommen ist, die Kopfstütze eingefahren.

1


VoreinstellungsscHolder

Wenn 1 gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 1.

2

Wenn 2 gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 2.

Halten Sie den VoreinstellungsscHolder, den automatischen RückkehrscHolder und den Letzte-Position-SchHolder nicht länger als 5 Sekunden gedrückt.
Wenn Sie ihn fünf Sekunden oder länger gedrückt gehalten haben, ist ein Summerton zu hören und die aktuelle Stuhlposition wird als Voreinstellungsposition gespeichert.
[Referenz] Einstellung des automatischen Betriebs [Seite 168]



Manueller Betriebsschalter

Zur manuellen Bedienung von „Anheben/Absenken“ und „Anheben/Zurücklehnen“ des Stuhls/der Kopfstütze.

ScHolder	Bedienung
	Der Stuhl wird angehoben/ Die Kopfstütze wird angehoben
	Der Stuhl wird abgesenkt/ Die Kopfstütze wird abgesenkt
	Die Rückenlehne wird geneigt/ Die Kopfstütze wird geneigt
	Die Rückenlehne wird angehoben/ Die Kopfstütze wird angehoben

* Der Stuhl/die Kopfstütze kann verstellt werden, wenn Sie den ScHolder nach unten drücken



Wenn die Kopfstützenfunktion ausgewählt ist, Licht/
Leuchtet die Lampe auf

Stuhl-/Kopfstützenschalter



Schaltet die Stuhl-/Kopfstützenfunktion auf den manuellen Betriebsschalter um.
Wenn die Kopfstützenfunktion ausgewählt ist, Licht/Leuchtet die Lampe auf.



WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor der Bewegung des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Treffen Sie beim Betrieb besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Verstellung und das Verhalten von Kindern.

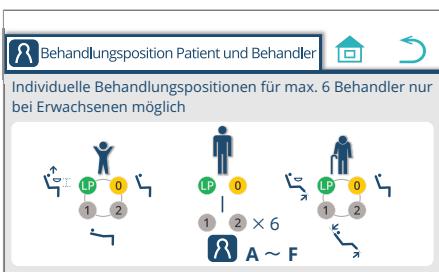

Struktur der Nutzer-/Patientenspeicher

Es können bis zu sechs Nutzerspeicher (A bis F) und bis zu drei Patientenspeicher (Erwachsene, Kinder und Senioren) eingerichtet werden.

[Erwachsener] : Erwachsenenmodus



Ein empfohlener Modus für erwachsene Patienten mit durchschnittlichem Körperbau; zusätzlich zum automatischen RückkehrscHolder **0** und dem Letzte-Position-ScHolder **LP** können die VoreinstellungsscHolder **1** **2** für bis zu sechs Nutzerspeicher (A bis F) eingerichtet werden.

[Kind] : Kindermodus



Ein empfohlener Modus für Kinder als Patient oder Patienten mit kleinem Körperbau; Der automatische RückkehrscHolder **0**, der Letzte-Position-ScHolder **LP** und die VoreinstellungsscHolder **1** **2** können entsprechend eingerichtet werden.


[Senioren] : Seniorenmodus




Ein empfohlener Modus für Senioren als Patienten oder Patienten mit besonderen Bedürfnissen; Der automatische RückkehrscHolder **0**, der Letzte-Position-ScHolder **LP** und die VoreinstellungsscHolder **1** **2** können entsprechend eingerichtet werden. Der Winkel von Rückenlehne und Beinstütze kann begrenzt werden und andere Einstellungen sind möglich.

5 Bedienung


Aufrufen der Struktur von Nutzer-/Patientenspeichern

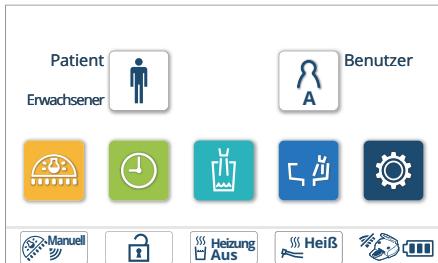

1. Drücken Sie den NutzerspeicherschHolder . Der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.

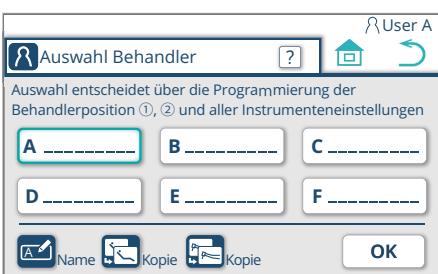

2. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den -SchHolder. Der Bildschirm „Behandlungsposition Patient und Behandler“ wird angezeigt.




Drücken Sie den -SchHolder, um vom aktuellen Bildschirm zum Startbildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie den -SchHolder, um vom aktuellen Bildschirm zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

Patientenspeicher-AuswahlSchHolder

Die Behandlungsposition des Stuhls kann entsprechend dem zu behandelnden Patienten umgeschaltet werden.


Bei jedem Drücken des Scholders wird der Modus in der Reihenfolge „Erwachsener“ > „Senior“ > „Kind“ umgeschaltet.

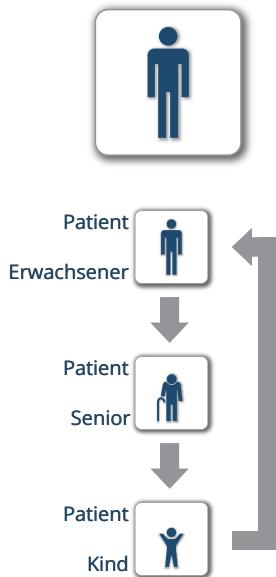




NutzerspeicherscHolder

Die voreingestellte Stuhlposition für den einzelnen Benutzer und die Anfangseinstellungen für Handstücke nach dem Einschalten können gespeichert und bei Bedarf ausgewählt werden.



1. Drücken Sie den NutzerspeicherscHolder .

Der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.

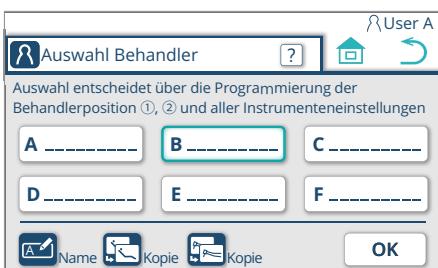

2. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den SpeicherscHolder für den Nutzer, um ihn zur Auswahl aufzurufen.


(In diesem Fall ist der Nutzer **B** ausgewählt.)

Drücken Sie **OK**, um die Einstellungen für den neu ausgewählten Nutzer aufzurufen, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.




Namen registrieren

Für jeden Nutzerspeicher kann ein Name registriert werden.

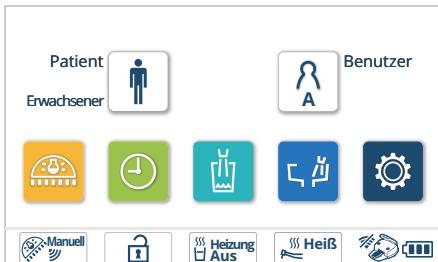


1. Drücken Sie den Nutzerspeicherschalter . Der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.

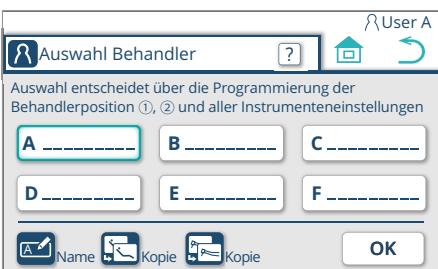

2. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den Schalter für den Nutzerspeicher, um ihn auszuwählen und einen Namen zu registrieren.
(In diesem Beispiel wird der Nutzerspeicher A ausgewählt.)

Drücken Sie den Namensregistrierungsschalter , um den Bildschirm „Eingabe Name Behandler“ für den ausgewählten Nutzer anzuzeigen.

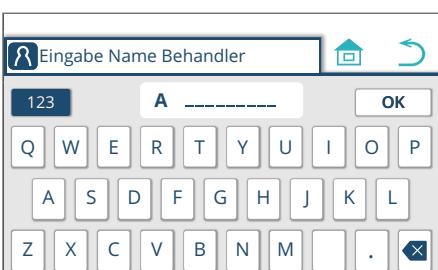


3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein.

Drücken Sie , um den Bildschirm „Auswahl Behandler“ anzuzeigen.


Ein Nutzernname kann in alphabetischem oder numerischem Format mit bis zu neun Stellen eingegeben werden.

Wenn Sie die alphanumerische Eingabe umschalten, drücken Sie den alphanumerischen Schalter .

Drücken Sie die Rücktaste , um bei der Zeicheneingabe das Zeichen vor der Cursorposition (links) zu löschen.

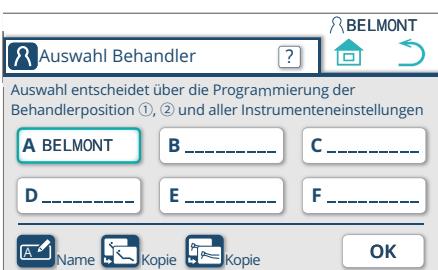


In diesem Beispiel wurde der Name „BELMONT“ eingegeben. Der registrierte Name wird für das Feld Nutzerspeicher A oben rechts angezeigt.

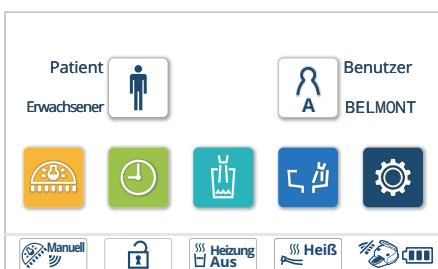


* Der registrierte Name wird rechts neben dem Nutzerspeicherschalter auf dem Startbildschirm angezeigt.

Stuhlvoreinstellung kopieren


Die Einstellungen für die StuhlvoreinstellungsschHoder 1, 2 im Erwachsenenmodus können in einen anderen Nutzerspeicher kopiert werden.



1. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den SchHoder Stuhl kopieren .

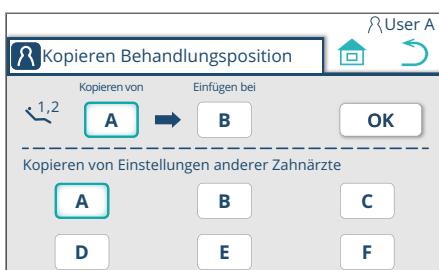


2. Wählen Sie den Nutzer für „Kopieren von“ von [A] bis [F] aus. Die SchHoderanzeige „Kopieren von“ ändert sich und zeigt den ausgewählten Nutzer an.

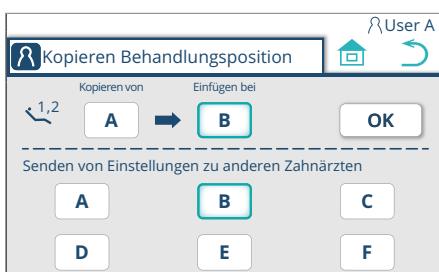

3. Drücken Sie den SchHoder „Einfügen bei“ und wählen Sie den „Einfügen bei“-Nutzer von [A] bis [F] aus.

Die SchHoderanzeige „Einfügen bei“ ändert sich und zeigt den ausgewählten Nutzer an.

Drücken Sie den -SchHoder, um den Popup-Bildschirm zur Bestätigung anzuzeigen.



4. Zur Bestätigung drücken Sie .


Der Kopiervorgang ist abgeschlossen und der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.

Drücken Sie , um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, ohne etwas zu kopieren.


5 Bedienung

Handstück-Einstellung kopieren


Die Anfangseinstellung eines Handstücks nach dem Einschalten kann in einen anderen Nutzerspeicher kopiert werden.



1. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den ScHolder „Kopieren der Instrumenteneinstellung“ .




2. Wählen Sie den Nutzer für „Kopieren von“ von [A] bis [F] aus. Die ScHolderanzeige „Kopieren von“ ändert sich und zeigt den ausgewählten Nutzer an.



3. Drücken Sie den ScHolder „Einfügen bei“ und wählen Sie den „Einfügen bei“-Nutzer von [A] bis [F] aus.

Die ScHolderanzeige „Einfügen bei“ ändert sich und zeigt den ausgewählten Nutzer an.

Drücken Sie **OK**, um den Popup-Bildschirm zur Bestätigung anzuzeigen.

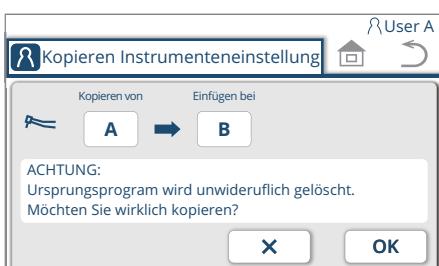

4. Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.

Der Kopiervorgang ist abgeschlossen und der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.

Drücken Sie **X**, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, ohne etwas zu kopieren.



ScHolder für die ZahnarztLicht/Leuchte

Schaltet die ZahnarztLicht/Leuchte ein/aus;

Ein/Aus wird umgeschaltet;


* Wenn Sie den ScHolder bei eingeschalteter Licht/Leuchte 2 Sekunden oder länger gedrückt halten, wird der Modus in den Komposit Safe umgeschaltet.

* Die DeckenLicht/Leuchte und das Schienenlicht können nicht bedient werden.



Timer-ScHolder

Zur Verwendung und Einstellung des Timers

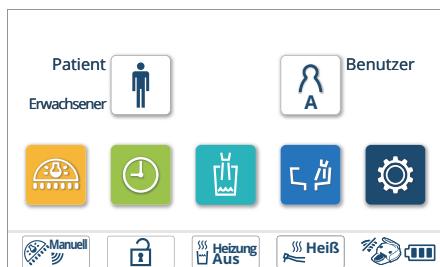

<Verwendung des Timers>

Die Zeit für den Timer kann aus vier Speicherplätzen ausgewählt werden.

1. Drücken Sie den Timer-ScHolder


Der „Timer“-Bildschirm wird angezeigt.



2. Wählen Sie einen Speicher (in diesem Beispiel ist „Timer D: 5 Minuten“ ausgewählt)

Der Bildschirm Bedienung/Einstellung für Timer D wird angezeigt.

Drücken Sie den Startbildschirm-SchHolder , um den Vorgang abzubrechen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Um zum vorigen Bedienungsbildschirm zurückzukehren, nutzen Sie den RückkehrscHolder .

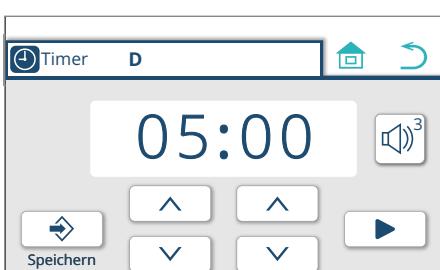

3. Timereinstellung ändern

Bei jedem Drücken des Erhöhen/Verringerungstaste für Drehzahl/Intensitäts wird die Zeit für den Timer um eine Minute für die Minutenstelle erhöht/verringert, bzw. um zehn Sekunden für die zweite Stelle.

: Eingestellte Zeit erhöhen

: Eingestellte Zeit verringern

Drücken Sie den Speichern-SchHolder , um die geänderte Einstellung im Speicher zu speichern.

5 Bedienung




4. Alarmlautstärke für den Timer ändern

Wenn der ScHolder zur Einstellung der Alarmlautstärke  gedrückt wird, wird der Bildschirm „Lautstärke-Regulierung Timer-Alarm“ angezeigt.

Drücken Sie die Berührungs-Balkenleiste  um die Alarmlautstärke in fünf Stufen einzustellen.


Drücken Sie den Alarnton-ScHolder , um den Alarm stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie den -ScHolder, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

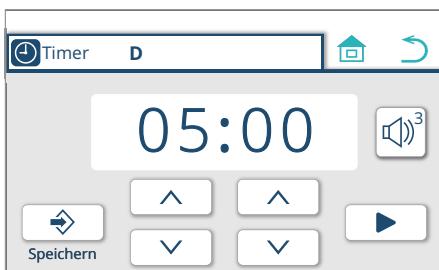


5. Drücken Sie die Starttaste , um den Countdown des Timers zu starten

Der Timer läuft herunter.



Drücken Sie die Pausentaste , um den Timer anzuhalten. Um den Timer neu zu starten, drücken Sie die Starttaste .

Drücken Sie die Stopptaste , um den Timer abzubrechen und zum Bildschirm in Abschnitt 3 zurückzukehren.

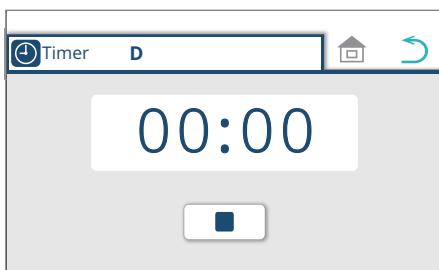


6. Sobald der Timer-Countdown abgeschlossen ist, ertönt ein Alarm

Der Alarm ertönt für die angegebene Zeit und stoppt dann automatisch.

Drücken Sie die Stopptaste , um den Alarmton zu stoppen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

* Wenn der Timer auf dem Handstück-Bildschirm bedient wird, während das Handstück aufgenommen ist, kehrt die Anzeige zum jeweiligen Handstück-Bildschirm zurück.

5 Bedienung

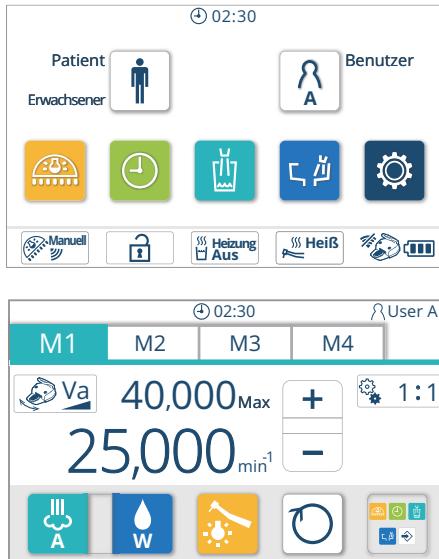


7. Rückkehr zum Startbildschirm während des Timer-Betriebs

Drücken Sie den Startbildschirm-SchHolder während der Timer läuft, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Der Timer-Status wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn der Timer-Countdown auf dem Startbildschirm abgeschlossen ist, wird der Bildschirm in Abschnitt 6 angezeigt.


* Wenn das Handstück aufgenommen wird, startet der Timer nicht, auch wenn der Timer-SchHolder nach dem Drücken des Menüaufruf-SchHolders gedrückt wird, und die Anzeige kehrt zum Handstück-Bildschirm zurück.



Sobald der Countdown des Timers bei aufgenommenem Handstück abgeschlossen ist, erscheint der Timer-SchHolder auf dem Bildschirm.


Wenn der Timer-SchHolder gedrückt wird, erscheint die Handstück-Anzeige auf dem Bildschirm.

Wenn das Handstück zurückgelegt wird, ohne den Timer-SchHolder zu drücken, erscheint die Anzeige in Abschnitt 6.



8. Modus auf Timer-Anzeige umschalten

Drücken Sie den Timer-SchHolder während des Countdowns, um die Timer-Anzeige auf dem Bildschirm wie in Abschnitt 5 gezeigt aufzurufen.





ScHolder für den Becherfüller

Dies ist ein ScHolder zum Befüllen des Bechers, der getrennt vom Sensor-Becherfüller eingebaut ist.

Wenn dieser ScHolder gedrückt wird, fließt Wasser aus der Düse des Becherfüllers. Ebenso fließt Wasser aus der Beckenspüldüse, um das Speischale zu spülen.

Der Becherfüller wird für einen bestimmten Zeitraum von einem Timer gesteuert. Um den Becherfüller anzuhalten, bevor die festgelegte Zeit abgelaufen ist, drücken Sie diesen ScHolder erneut.

Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller, bevor Sie ihn benutzen.

Sonst können die Wand und der Stuhl mit Wasser bespritzt werden.

Der Becherfüller läuft für eine bestimmte Zeit, unabhängig vom Wasserstand im Becher. Achten Sie darauf, dass der Becher nicht überläuft.



Taste für Speibeckenspülung

Es fließt Wasser aus der Beckenspüldüse, um das Speischale zu spülen (ca. sechs Sekunden).


Halten Sie den ScHolder zwei Sekunden oder länger gedrückt, um kontinuierlich zu spülen.

Drücken Sie diesen ScHolder erneut, um das Spülen zu stoppen.



Funktionstaste

Zur Einstellung verschiedener Betriebsbedingungen
[Seiten 169 - 222]

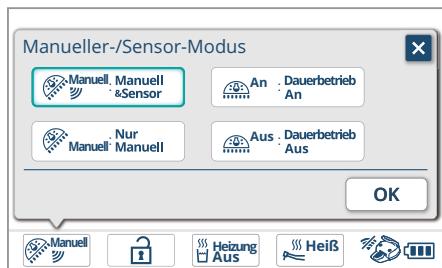

LichtscHolder

Rufen Sie den Bildschirm „Manueller-/Sensor-Modus“ auf, um den Betriebsmodus für die ZahnarztLicht/Leuchte umzuschalten.

Wählen Sie einen Betriebsmodus aus und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie **X**, um die Änderung abzubrechen und den Vorgang zu beenden.

Anzeige	Modus	Bedingung
	Sensor-/ScHoldermodus	Das Licht kann mit dem berührungslosen ScHolder an der ZahnarztLicht/Leuchte und mit dem ZahnarztLicht/LeuchtenScHolder ein- und ausgeschaltet werden.
	ScHoldermodus	Das Licht kann mit dem ZahnarztLicht/LeuchtenScHolder ein- und ausgeschaltet werden. * Das Licht kann nicht mit dem berührungslosen ScHolder an der ZahnarztLicht/Leuchte ein- und ausgeschaltet werden
	EIN-Modus	Die ZahnarztLicht/Leuchte wird kontinuierlich mit maximaler Beleuchtungsstärke eingeschaltet. * Das Licht kann weder mit dem berührungslosen ScHolder an der ZahnarztLicht/Leuchte noch mit dem ZahnarztLicht/LeuchtenScHolder ein- und ausgeschaltet werden.
	AUS-Modus	Die ZahnarztLicht/Leuchte ist dauernd ausgeschaltet * Das Licht kann weder mit dem berührungslosen ScHolder an der ZahnarztLicht/Leuchte noch mit dem ZahnarztLicht/LeuchtenScHolder ein- und ausgeschaltet werden.

5 Bedienung




SperrscHolder

Zur Reinigung des Bedienfelds oder zur Vermeidung von Unfug durch Kinder können das Touchpanel, die MembranscHolder und der Joystick gesperrt werden.

Rufen Sie den „Bediensperre“-Bildschirm auf und drücken Sie **OK**, um die Bedienung zu sperren.

Solange die Sperre andauert, wird eine Sperrnachricht auf dem Touchpanel angezeigt.

Um die Bediensperre aufzuheben, halten Sie den Stuhl-/KopfstützenscHolder ca. eine Sekunde oder länger gedrückt.

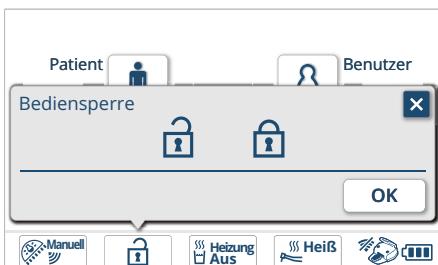

ScHolder für Wasserwärmer

Rufen Sie den Bildschirm „Heizung Becherfüller“ auf, um den Becherfüller auf warmes Wasser umzustellen.

Wählen Sie den Warmwassermodus aus (EIN/AUS) und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie **X**, um die Änderung abzubrechen und den Vorgang zu beenden.




ScHolder für HS-Heizung

Rufen Sie den Bildschirm „Wasserwärmer Instrumente“ auf, um das aus dem Handstück kommende Wasser auf warmes Wasser umzustellen und die Wassertemperatur einzustellen (zwei Temperaturen).

Wählen Sie den Warmwassermodus aus (Hoch, Niedrig, AUS) und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie **X**, um die Änderung abzubrechen und den Vorgang zu beenden.





Anzeige für Funken Fußanlasser

Zeigt den verbleibende Batteriestand und den Kopplungsstatus des Funken Fußanlassers an.



Wenn der Batterieladestand sinkt, ändert sich die Anzeige von zu . Nachdem ein Popup-Bildschirm zur Warnung angezeigt wurde, ändert sich die Anzeige zu . Sobald das Popup-Fenster angezeigt wird, tauschen Sie die Batterie umgehend gegen eine neue aus.

[Referenz] Austausch der Batterien [Seite 148]

Drücken Sie , um das Popup zu schließen.

Wenn der Funker Fußanlasser nicht gekoppelt wurde, wird



angezeigt und der Fußanlasser kann nicht genutzt werden.

Wenn er nicht nutzbar ist, schalten Sie den HauptscHolder aus und starten Sie das Gerät neu, führen Sie anschließend die Kopplung des Funken Fußanlassers durch.



GlockenscHolder

Eine Helferin o. Ä. kann durch ein extern angeschlossenes Gerät gerufen werden.




ImplantatscHolder

Aktiviert die Implantatfunktion

5 Bedienung

Luft EIN/Wasser EIN (Sprühen EIN)

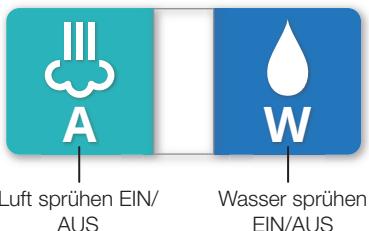

Luft sprühen EIN/
AUS Wasser sprühen
EIN/AUS

Luft AUS/Wasser EIN



Luft EIN/Wasser AUS



Luft AUS/Wasser AUS (Sprühen AUS)



Licht an



Licht aus



SprühscHolder

Schaltet das Sprühen mit dem Handstück EIN/AUS (Wasser und Luft).

Nehmen Sie ein Handstück auf und drücken Sie den ScHolder, um zwischen EIN und AUS für A (Luft) und W (Wasser) umzuschalten.

Bei einem Mikromotor/einer Luftturbine/einem Luftmotor können zwei oder vier Modi je nach Einstellung des Sprühmodus ausgewählt werden.

Wenn zwei Modi eingestellt sind, wird Sprühen EIN/AUS umgeschaltet.

Bei der Einstellung auf vier Modi kann EIN/AUS für Luft und Wasser umgeschaltet werden.

Unabhängig davon, ob zwei oder vier Modi, kann ein Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät nur W(Wasser) ein-/ausschalten.

[Referenz] Einstellung des Sprühmodus [Seite 209]

HandstücklichtscHolder

Schaltet die HandstückLicht/Leuchte ein/aus.

Das Licht wird ein- oder ausgeschaltet.

[Referenz] Einstellen des Lichtaktivierungszeitpunkts [Seite 210]

5 Bedienung




Kochsalzlösungsspülungsumschalter

Mit jeder Betätigung dieses ScHolders wird die Spülung ein- oder ausgeschaltet.



Stattdessen kann der Fußanlasser verwendet werden.

Mit jedem Treten auf diesen ScHolder wird die Spülung ein- oder ausgeschaltet.

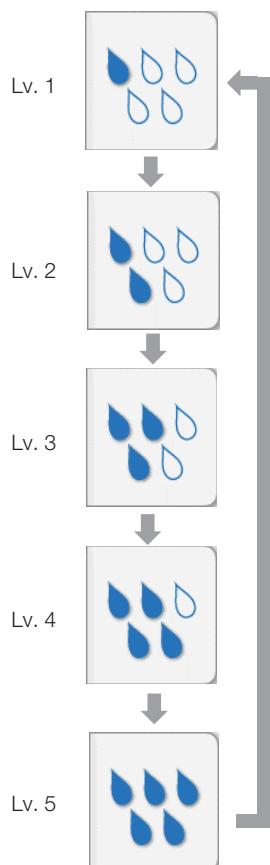

Umschalter für das Volumen der Kochsalzlösung

Mit jeder Betätigung dieses ScHolders ändert sich das Volumen der Spülung.

Die Stufen können wie folgt geändert werden: Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Stufe 4 → Stufe 5 → Stufe 1. Es gibt fünf Stufen des Volumens der Spülung, und je höher die Stufe ist, desto größer ist das Volumen der Spülung. Verwenden Sie den Kochsalzlösungsspülungsumschalter, um die Volumeneinstellung ein- oder auszuschalten.

Vorwärtsdrehung
(im Uhrzeigersinn)



Rückwärtsdrehung
(gegen den
Uhrzeigersinn)



ScHolder Mikromotor vorwärts/rückwärts

Schaltet die Drehrichtung des Mikromotors um.

Es wird zwischen Vorwärtsdrehung (im Uhrzeigersinn) und Rückwärtsdrehung (gegen den Uhrzeigersinn) umgeschaltet.

Die Drehrichtung ist unmittelbar nach dem Einschalten auf „vorwärts“ eingestellt.

* Die Drehrichtung kann nicht umgeschaltet werden, wenn der Mikromotor sich gerade dreht.

Reziprokmodus (nicht schaltbar)



Mikromotor-vorwärts/
rückwärts-ScHolder

(Beim Betrieb des Implantatmotors)
Stattdessen kann der Fußanlasser verwendet werden.

Mit jedem Treten auf diesen ScHolder wird die Drehrichtung (vorwärts/rückwärts) des Mikromotors umgeschaltet.



Menüaufruf-ScHolder

Ruft die Menübildschirme zur Ausführung der folgenden Funktionen auf, wenn ein Handstück aufgenommen ist.

ZahnarztLicht/Leuchte ein/aus

[Referenz] ScHolder für die ZahnarztLicht/Leuchte [Seite 94]

Verwendung und Einstellung des Timers

[Referenz] Timer-ScHolder [Seiten 94 - 96]

Becherfüller

[Referenz] ScHolder für den Becherfüller [Seite 97]

Speischale spülen

[Referenz] ScHolder für Beckenspülung [Seite 97]

Speicher der Handstück-Betriebszustandseinstellung

[Referenz] SpeicherscHolder (Handstückeinstellungsbildschirm) [Seite 103]



Speichertaste (Handstück-Einstellungsbildschirm)

Dieser ScHolder wird angezeigt, wenn Drehrichtung, Sprühzustand und andere Einstellungen aus dem Speicher auf dem Handstück-Bildschirm geändert wurden. Drücken Sie den ScHolder, um den aufgerufenen Speicherwert (M1 bis M4) mit der geänderten Einstellung zu überschreiben.



Schiebemodus-ScHolder

Schaltet den Schiebemodus (Va/Fix) des Fußanlassers um.

[Referenz] Mikromotor [Seite 116]



+/- -ScHolder

Beim Mikromotor wird die maximale Drehzahl erhöht/verringert.
[Referenz] Mikromotor [Seite 117]



Übersetzungsverhältnis-ScHolder

Die Anzeige kann auf eine Drehung umgeschaltet werden, die dem Gegenwinkel-Übersetzungsverhältnis des Mikromotors entspricht.

[Referenz] Mikromotor [Seite 119]


Automatische Rückwärtsfunktion und Drehmomentwert 3,0 Ncm



Schieber für Drehmomentsteuerung

Der Zustand von Drehmomentwert und automatischer Rückwärtsfunktion kann eingestellt werden, wenn der Mikromotor eine Einstellung im niedrigen Drehzahlbereich akzeptiert.


[Referenz] Mikromotor [Seiten 121, 122, 124 bis 127]

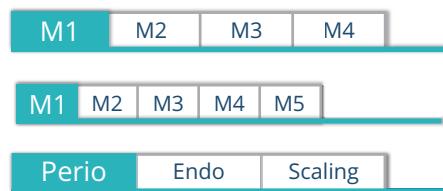

Speicher-Registerkarte

Die voreingestellten Speicherwerte der Handstückeinstellung können aufgerufen und umgeschaltet werden.

Das Speicherregister wird je nach Handstück möglicherweise nicht angezeigt.

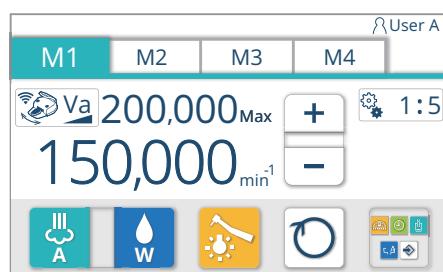


[Referenzen] Mikromotor [Seite 116]

Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät [Seite 130]

Turbine [Seite 133]

Implantatmotor [Seite 136]

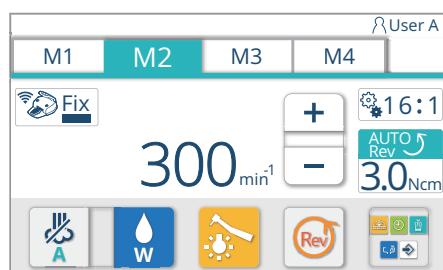

Vor der Auswahl



Nach der Auswahl



ModusscHolder für Handstück

Wenn Sie den ScHolder auf dem Bildschirm zur Änderung der anfänglichen Spülzeit drücken, wird der Einstellbildschirm für die Spülzeit der „Handstückspülung“ angezeigt.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung [Seiten 181-186]

Vor der Auswahl



Nach der Auswahl



SpülmodusscHolder für Becherfüller

Wenn Sie den ScHolder auf dem Bildschirm zur Änderung der anfänglichen Spülzeit drücken, wird der Einstellbildschirm für die Spülzeit der „Becherfüllerspülung“ angezeigt.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller) [Seiten 183, 184]

Vor der Auswahl



Nach der Auswahl



SpülmodusscHolder für Becherfüller, Speischale

Wenn Sie den ScHolder auf dem Bildschirm zur Änderung der anfänglichen Spülzeit drücken, wird der Einstellbildschirm für die Spülzeit der „Becherfüller-, Speischalespülung“ angezeigt.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller + Speischale) [Seiten 185, 186]



Timer-ScHolder für Spülung

Wenn Sie den ScHolder auf dem Bildschirm für die Spüleinstellung drücken, wird der Bildschirm für die Änderung der anfänglichen Spülzeit angezeigt.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung [Seiten 181-188]



Speichertaste (Einstellbildschirm für Spülung/Timer)



Wenn Sie den ScHolder auf dem Einstellbildschirm für Spülung/Timer drücken, wird die Zeit mit einer eingestellten Zeit überschrieben.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung [Seiten 181-188]

Verwendung des Timers[Seite 94]

5-13 Helferinnen-Bedienfeld

Ausführung mit Assistenzelement

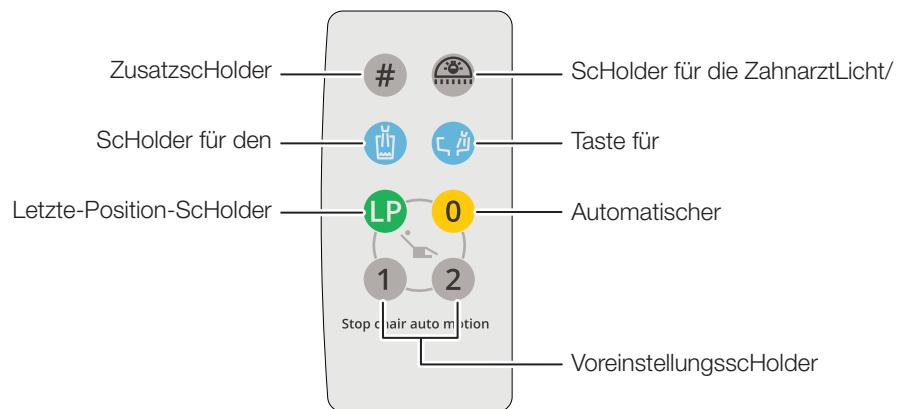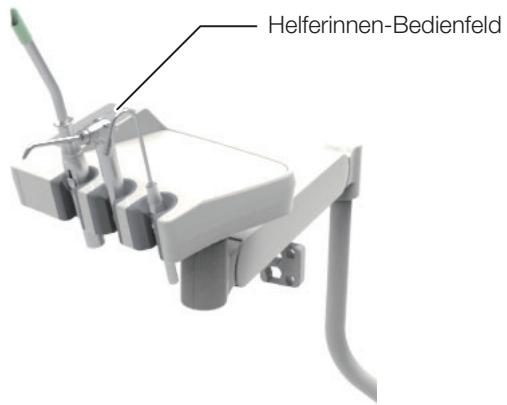

ScHolder für die ZahnarztLicht/Leuchte

Schaltet die ZahnarztLicht/Leuchte ein/aus;

Ein/Aus wird umgeschaltet;

* Wenn Sie den ScHolder bei eingeschalteter Licht/Leuchte 2 Sekunden oder länger gedrückt halten, wird der Modus in den Komposit Safe umgeschaltet.

* Die DeckenLicht/Leuchte und das Schienenlicht können nicht bedient werden.



ZusatzscHolder

Wenn dieser ScHolder zwei Sekunden oder länger gedrückt gehalten wird, wird der berührungslose ScHolder für die ZahnarztLicht/Leuchte deaktiviert.

Die LED-Anzeige im Speischale Licht/Leuchtet rosa.

Wenn dieser ScHolder zwei Sekunden oder länger gedrückt gehalten wird, wird der Sensor der ZahnarztLicht/Leuchte aktiviert.

Die LED-Anzeige im Speischale Licht/Leuchtet in der ursprünglichen Farbe.



ScHolder für den Becherfüller

Dies ist ein ScHolder zum Befüllen des Bechers, der getrennt vom Sensor-Becherfüller eingebaut ist.

Wenn dieser ScHolder gedrückt wird, fließt Wasser aus der Düse des Becherfüllers. Ebenso fließt Wasser aus der Beckenspüldüse, um das Speischale zu spülen.

Der Becherfüller wird für einen bestimmten Zeitraum von einem Timer gesteuert. Um den Becherfüller anzuhalten, bevor die festgelegte Zeit abgelaufen ist, drücken Sie diesen ScHolder erneut.

Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller, bevor Sie ihn benutzen.

Sonst können die Wand und der Stuhl mit Wasser bespritzt werden.

Der Becherfüller läuft für eine bestimmte Zeit, unabhängig vom Wasserstand im Becher. Achten Sie darauf, dass der Becher nicht überläuft.



Taste für Speibeckenspülung

Es fließt Wasser aus der Beckenspüldüse, um das Speischale zu spülen (ca. sechs Sekunden).

- Halten Sie den ScHolder zwei Sekunden oder länger gedrückt, um kontinuierlich zu spülen.
- Drücken Sie diesen ScHolder erneut, um das Spülen zu stoppen.



Letzte-Position-ScHolder

Der Stuhl wird in die Gurgelposition gefahren, wenn dieser ScHolder in die Behandlungsposition gedrückt wird.

Drücken Sie die Taste erneut, um den Stuhl vor dem Mundspülen wieder in die Behandlungsposition zu bringen.



Automatischer RückkehrscHolder

Der Stuhl wird in die Einstiegs-/Ausstiegsposition gefahren.

* Bei der Kopfstütze (elektrohydraulisch) wird durch abermaliges Drücken dieses ScHolders, nachdem der Stuhl vollständig zum Stillstand gekommen ist, die Kopfstütze eingefahren.



VoreinstellungsscHolder

Wenn 1 gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 1.

Wenn 2 gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 2.



Halten Sie den VoreinstellungsscHolder, den automatischen RückkehrscHolder und den Letzte-Position-ScHolder nicht länger als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie ihn fünf Sekunden oder länger gedrückt gehalten haben, ist ein Summerton zu hören und die aktuelle Stuhlposition wird als Voreinstellungsposition gespeichert.

[Referenz] Einstellung des automatischen Betriebs [Seite 168]




WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor der Bewegung des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Treffen Sie beim Betrieb besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Verstellung und das Verhalten von Kindern.

Ausführung mit Vac Pac-Einheit

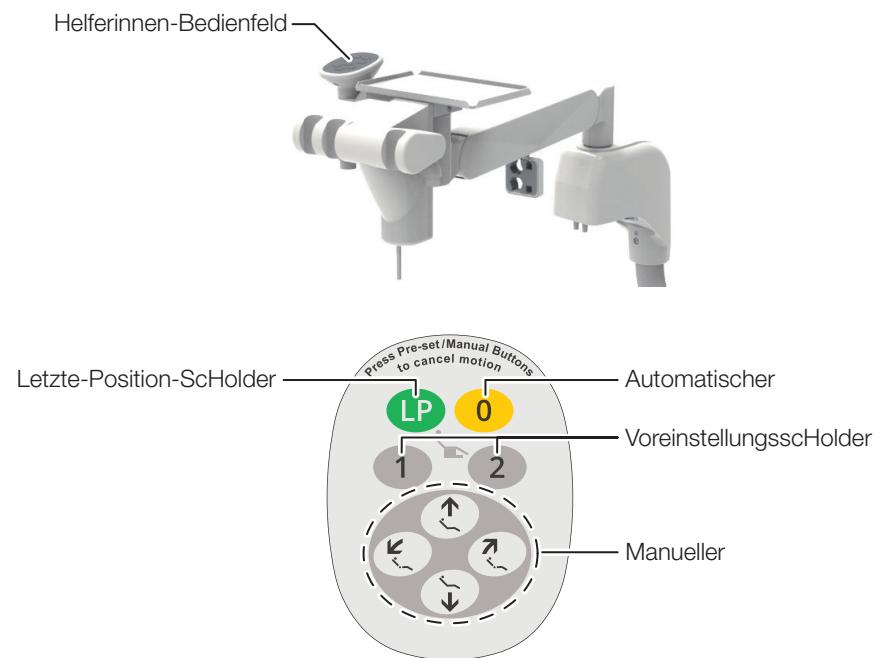

LP

Letzte-Position-Schalter

Der Stuhl wird in die Gurgelposition gefahren, wenn dieser Schalter in die Behandlungsposition gedrückt wird.

Drücken Sie die Taste erneut, um den Stuhl vor dem Mundspülen wieder in die Behandlungsposition zu bringen.

0

Automatischer Rückkehrschalter

Der Stuhl wird in die Einstiegs-/Ausstiegsposition gefahren.

* Bei der Kopfstütze (elektrohydraulisch) wird durch abermaliges Drücken dieses Schalters, nachdem der Stuhl vollständig zum Stillstand gekommen ist, die Kopfstütze eingefahren.

1

Voreinstellungsschalter

Wenn **1** gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 1.

Wenn **2** gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 2.


2

Halten Sie den Voreinstellungsschalter, den automatischen Rückkehrschalter und den Letzte-Position-Schalter nicht länger als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie ihn fünf Sekunden oder länger gedrückt gehalten haben, ist ein Summerton zu hören und die aktuelle Stuhlposition wird als Voreinstellung gespeichert.

[Referenz] Einstellung des automatischen Betriebs [Seite 168]

Manueller Betriebsschalter

Zur manuellen Bedienung von „Anheben/Absenken“ und „Anheben/Zurücklehnen“ des Stuhls.

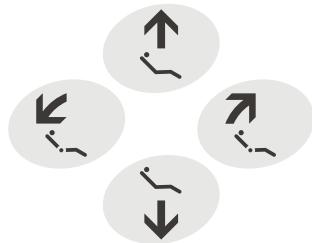

ScHolder	Bedienung
	Der Stuhl wird angehoben
	Der Stuhl wird abgesenkt
	Die Rückenlehne wird geneigt
	Die Rückenlehne wird angehoben

*Der Stuhl/die Kopfstütze kann verstellt werden, wenn Sie den ScHolder nach unten drücken



WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor der Bewegung des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Treffen Sie beim Betrieb besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Verstellung und das Verhalten von Kindern.

5-14 Abbruchfunktion




Helperinnen-Bedienfeld
(Ausführung mit
Assistenzelement)



Helperinnen-Bedienfeld
(Ausführung mit Vac
Pac-Einheit)



Arzt-Bedienfeld
MembranschHolder
(Holder)



Arzt-Bedienfeld
MembranschHolder (Stange)



Fußanlasser

Treten Sie auf das Pedal.

Helperinnen-Bedienfeld

Drücken Sie einen der SchHolder in dem -Rahmen.

Drücken Sie einen der SchHolder.

MembranschHolder

Drücken Sie einen der SchHolder.

5-15 Sperrfunktion

5-15-1 Stuhlverriegelungsfunktion

Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, werden die unten aufgeführten Anzeigen auf dem Touchpanel angezeigt. (Wenn Kraft auf die Hintere Stuhlabdeckung ausgeübt wird, wird die Verriegelungsfunktion aktiviert.)


Startbildschirm



Startbildschirm:



Handstück-Bildschirm

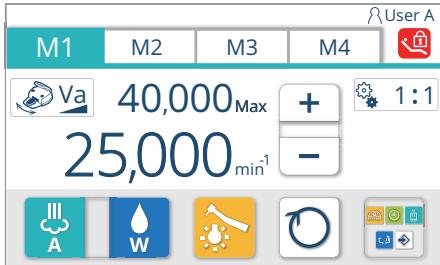

Handstück-Bildschirm:

Wenn die Verriegelungsfunktion aktiviert ist, wird die Bewegung des Stuhls gestoppt und ein Popup-Fenster wird geöffnet, das über den ungewöhnlichen Zustand informiert.

Überprüfen Sie das Popup-Fenster und beseitigen Sie umgehend die Störung.

Beheben Sie die Störung oder drücken Sie , um das Popup zu schließen.


Die Funktionen, die gesperrt werden, und die Entriegelungsschritte sind wie folgt.
[Referenz] [Seiten 112 bis 114]

Die LED-Anzeige im Speischale Licht/Leuchtet orange.

5 Bedienung

Zustand 1	Anzeige auf dem Touchpanel
Wenn der Fußanlasser während des automatischen Stuhlbetriebs getreten wird	 <p>Stuhlsperre durch Fußanlasser Zur Entsperrung Fußpedal betätigen</p>
	<p>Entriegelung</p> <p>Nehmen Sie den Fuß vom Pedal, prüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.</p>
	<p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Alle Stuhlfunktionen</p>
Zustand 2	Anzeige auf dem Touchpanel
Wenn während des automatischen Stuhlbetriebs eine Kraft in Pfeilrichtung auf die Arzteinheit ausgeübt wird (BodenplatteHolderung)	 <p>Stuhlsperre durch Arzttisch-Kollision Zur Aufhebung des Notstop Arzttisch in Behandlungsposition schwenken.</p>
	<p>Entriegelung</p> <p>Entfernen Sie das Hindernis, das den Notstop ausgelöst hat, überprüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.</p>
	<p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Automatische Stuhlfunktionen</p>

5 Bedienung

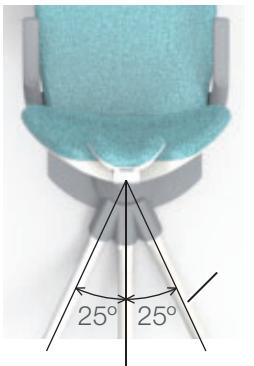
Zustand 3	Anzeige auf dem Touchpanel
<p>Wenn der Arztarm im automatischen Stuhlbetrieb in einen Verstellbereich gedreht wird (BodenplatteHolderung)</p> 	 <p>Entriegelung</p> <p>Drehen Sie den Arztisch, bis die Verriegelungsanzeige auf dem Touchpanel verschwindet.</p> <p>Gesperzte Funktionen</p> <p>Automatische Stuhlfunktionen</p>
<p>Zustand 4</p> <p>Wenn während des automatischen Stuhlbetriebs eine Kraft auf den Helferinnenarm von unten/oben ausgeübt wird</p> 	 <p>Entriegelung</p> <p>Entfernen Sie das Hindernis, das den Notstopps ausgelöst hat, überprüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.</p> <p>Gesperzte Funktionen</p> <p>Automatische Stuhlfunktionen</p>

5 Bedienung

Zustand 5	Anzeige auf dem Touchpanel
Während der Bewegung des Stuhls wirkt eine Kraft auf die Hintere Stuhlabdeckung in der angegebenen Pfeilrichtung ein	
	Entriegelung Entfernen Sie das Hindernis, das den Notstopp ausgelöst hat, überprüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.
	Gesperrte Funktionen Automatischer Betrieb und manueller Betrieb des Stuhls (Absenken/Zurücklehnen der Rückenlehne)

5–15–2 Handstücksperrfunktion

Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, werden die unten aufgeführten Anzeigen auf dem Touchpanel angezeigt und das Handstück kann nicht benutzt werden. Die Funktionen, die gesperrt werden, und die Entriegelungsschritte sind wie folgt.

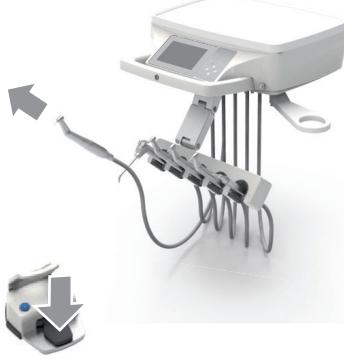
Bedingung	Anzeige auf dem Touchpanel
	
Entriegelung	
Nehmen Sie den Fuß vom Fußanlasserspedal und treten Sie dann wieder darauf.	
Gesperrte Funktionen	Handstückfunktionen

5-16 Mikromotor

Mikromotor-Schiebemodus einstellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

[Beispiel für MX2]

Schiebemodus (Va/Fix)

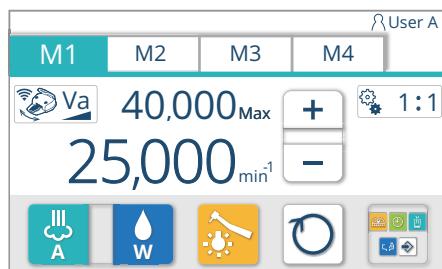

Wenn der Mikromotor aus dem InstrumentenHolder aufgenommen wird, wird der Mikromotor-Bildschirm angezeigt.

Ein Speicher kann aus den vier Speicherplätzen ausgewählt werden (M1 bis M4). Die Speicher können durch Drücken des Speicherregisters umgeschaltet werden.

Als Schiebemodus kann Va oder Fix ausgewählt werden.

Va (Variabel)

Durch Einstellen der maximalen Drehzahl und Verschieben des Pedals nach links oder rechts kann die Drehzahl im Bereich bis zur maximalen Drehzahl eingestellt werden.


Die Drehzahl wird beim Schieben nach links verringert und beim Schieben nach rechts erhöht.

Die Drehzahl kann durch Treten auf das Pedal auf die maximale Drehzahl eingestellt werden.

Fix (Fest)

Die Drehzahl kann bis zum eingestellten Wert durch die Stärke des Auftretens geregelt werden, unabhängig von der Stellung des Pedals.

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder.
2. Drücken Sie auf den Schiebemodus , um den Schiebemodus-Einstellbildschirm anzuzeigen.

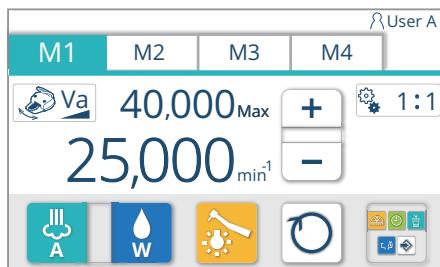


3. Wählen Sie einen Schiebemodus aus.


4. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von . Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für den Schiebemodus werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie ohne auf zu drücken.

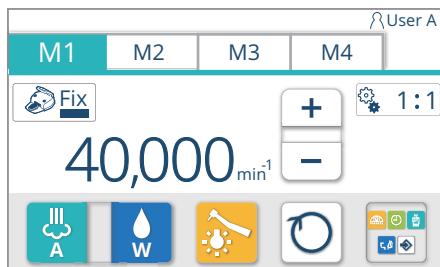

[Beispiel für MX2]

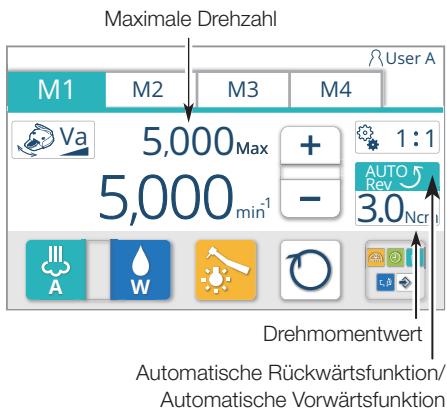

Maximale Drehzahl einstellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder


2. Drücken Sie den ScHolder , um die maximale Drehzahl einzustellen. Der Einstellbereich für die maximale Drehzahl ist je nach Modell des Mikromotors verschieden (siehe die Abbildung unten).

Die automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion und der Drehmomentwert werden nur angezeigt, wenn der niedrige Drehzahlbereich eingestellt wird (NLX plus/MX2).

Mikromotor Modell	Einstellbereich der maximalen Drehzahl (Übersetzungsverhältnis 1:1)									
	100	1000	2000	5000	6000	10000	20000	30000	40000	
NBX						Drehzahlbereich				
						Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl				
						1.000				
NLX plus						Niedriger Drehzahlbereich				
						Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl				
	Alle	100				500				
							Hoher Drehzahlbereich			
							Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl			
							1.000			
NLX nano						Drehzahlbereich				
						Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl				
						1.000				
MX2						Niedriger Drehzahlbereich				
						Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl				
	Alle	100				500				
							Hoher Drehzahlbereich			
							Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl			
							1.000			
MCX						Drehzahlbereich				
						Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl				
						1.000				

(Einheit: min⁻¹)

[Beispiel für MX2]

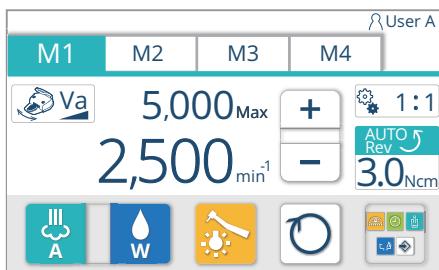

Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

Wenn die folgende Einstellung des Handstückzustands geändert wird, kann sie mit den folgenden Schritten gespeichert werden.

- Maximale Drehzahl

[Referenz] Maximale Drehzahl einstellen [Seite 117]



- Sprühzustand (EIN/AUS/Wasser/Luft)

[Referenz] SprühscHolder [Seite 101]

- Handstücklichtzustand (EIN/AUS)

[Referenz] HandstücklichtscHolder [Seite 101]

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
 2. Wählen Sie ein Speicherregister von M1 bis M4 und drücken Sie darauf
 3. Handstückzustand ändern (maximale Drehzahl/Sprüh-/ Handstücklichtzustand).
 4. Drücken Sie den MenüaufrufscHolder  , um den Menübildschirm aufzurufen
 5. Drücken Sie den SpeicherscHolder 
- Der Speichereinstellbildschirm für den Startzustand wird angezeigt.

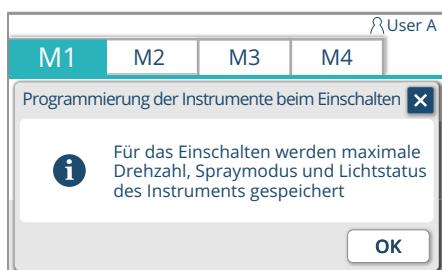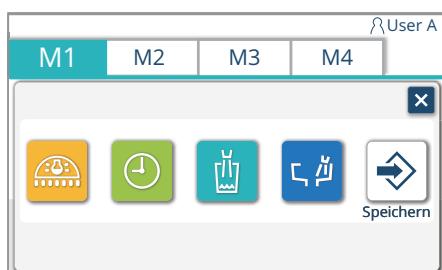

6. Bestätigen Sie die angezeigte Einstellung und drücken Sie  , um sie zu speichern.

* Wenn  nicht gedrückt wird, sondern  , ist die geänderte Einstellung gültig, bis der HauptscHolder ausgeschaltet wird, aber die Einstellung kehrt in den Zustand vor der Änderung zurück, sobald der HauptscHolder ausgeschaltet wird.

[Beispiel für MX2]

Speicher-Registerkarte Übersetzungsverhältnis



Anzeige der Übersetzungsumwandlung (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

Diese Funktion dient zur Anzeige eines Werts, der annähernd der tatsächlichen Drehzahl entspricht, indem das Verhältnis von Gegenwinkel-Handstück/am Mikromotor angebrachtes gerades Handstück umgewandelt wird.

Die folgenden vier Arten von Übersetzungsverhältnissen werden für die Umwandlung verwendet.



1:5 (fünffache Geschwindigkeit), 1:1 (gleiche Geschwindigkeit),
4:1 (auf ein Viertel der Geschwindigkeit verlangsamt),
16:1 (auf ein Sechzehntel der Geschwindigkeit verlangsamt)

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder.
2. Wählen Sie einen Speicher aus den RegistersHoldern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf.
3. Drücken Sie den ÜbersetzungssHolder **1:1**, um den Übersetzungs-Einstellbildschirm anzuzeigen.
4. Wählen Sie ein Übersetzungsverhältnis aus.
5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von **OK**.


Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für das Übersetzungsverhältnis werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie **×**, ohne auf **OK** zu drücken.

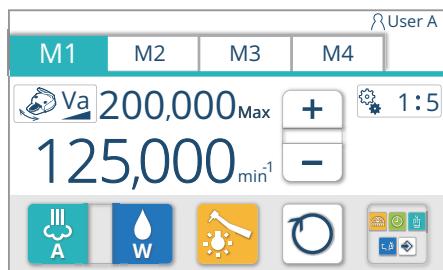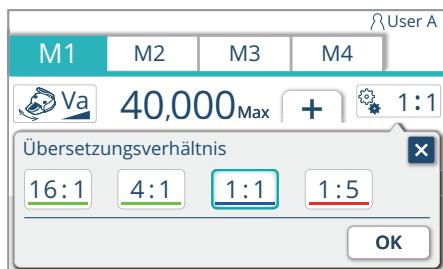

Überhitzungsschutzfunktion (NBX/NLX plus/MX2/MCX)

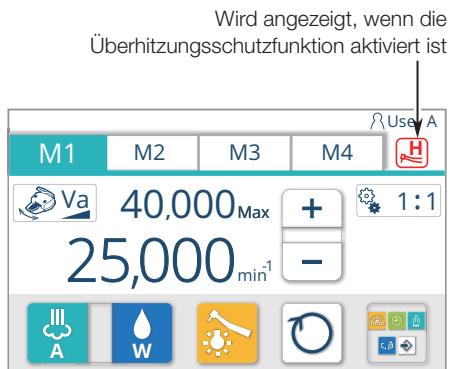

Wenn das Produkt über lange Zeit bei hoher Belastung verwendet wird, wird die Überhitzungsschutzfunktion aktiviert und das Drehmoment wird automatisch verringert, um eine Überhitzung der Mikromotoreinheit zu verhindern. Wenn das passiert, ist ein Summerton zu hören und **H** wird angezeigt. Solange diese Anzeige zu sehen ist, bleibt die Überhitzungsschutzfunktion aktiviert. Wenn die Rotation gestoppt oder das Produkt bei geringerer Belastung genutzt wird, wird die Überhitzungsschutzfunktion nach einiger Zeit deaktiviert.



Schalten Sie den Hauptschalter nicht aus und wieder ein, um die Überhitzungsschutzfunktion zu deaktivieren. Dies kann durch eine Überhitzung der Mikromotoreinheit zu einem Durchbrennen führen.



Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Mikromotor.




NLX plus

Beim Mikromotor NLX plus können der Drehmomentwert, die Anwendbarkeit der automatischen Rückwärtsfunktion und die Anwendbarkeit der automatischen Vorwärtsfunktion eingestellt werden, wenn die maximale Drehzahl auf den niedrigen Drehzahlbereich eingestellt ist (100 bis 5.000 min⁻¹).

Automatisch rückwärts ist eine Funktion, die automatisch auf Rückwärtsdrehung umschaltet (gegen den Uhrzeigersinn), wenn die Last im niedrigen Drehzahlbereich den voreingestellten Drehmomentwert übersteigt (0,3 - 3,0 Ncm).

Automatisch vorwärts ist eine Funktion, die automatisch auf Rückwärtsdrehung umschaltet (gegen den Uhrzeigersinn), wenn die Last im niedrigen Drehzahlbereich den voreingestellten Drehmomentwert übersteigt (0,3 - 3,0 Ncm) und anschließend wieder zur Vorwärtsdrehung zurückkehrt (im Uhrzeigersinn), wenn die Last verschwindet.

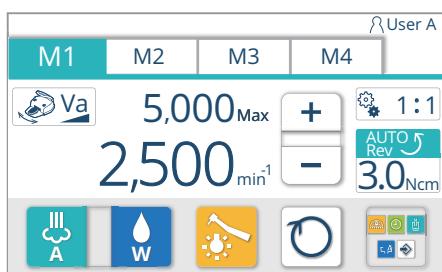

Einstellung eines Drehmomentwerts

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder.

2. Wählen Sie einen Speicher aus den Registerscholdern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf.

3. Drücken Sie den Drehmoment-Steuerscholder **AUTO Rev 3.0 Ncm**, um den Drehmoment-Einstellbildschirm anzuzeigen.

4. Drücken Sie den **+** **-**-Scholder, um den gewünschten Drehmomentwert einzustellen.

<Folgende Optionen stehen zur Verfügung:>

0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,9/1,0/1,2/1,4/1,8/2,1/2,3/2,7/3,0

Beim Drücken von **+** wird der nächsthöhere Drehmomentwert aus den genannten Optionen eingestellt.


Beim Drücken von **-** wird der nächstniedrigere Drehmomentwert aus den genannten Optionen eingestellt.

5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von **OK**.


Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für den Drehmomentwert werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie **X**, ohne auf **OK** zu drücken.

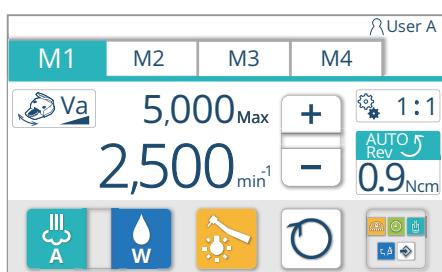

Speicher-Registerkarte

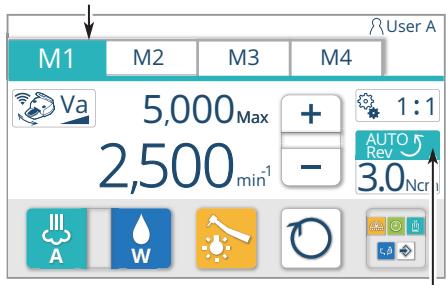

Automatische Rückwärtsfunktion/
Automatische Vorwärtsfunktion

Einstellung der automatischen Rückwärtsfunktion/automatischen Vorwärtsfunktion


1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Speicher aus den RegistersHoldern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
3. Drücken Sie den DrehmomentsteuersHolder **AUTO Rev 3.0 Ncm**, um den Einstellungsbildschirm für die automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion anzuzeigen
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die automatische Rückwärt-/Vorwärtsfunktion
 - **AUTO Rev**: Einstellung auf „Keine automatische Rückwärtsfunktion“
 - **AUTO Rev**: Einstellung auf „Automatische Rückwärtsfunktion“
 - **AUTO Fwd**: Einstellung auf „Automatische Vorwärtsfunktion“

5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von **OK**

Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für die automatische Rückwärtsfunktion und automatische Vorwärtsfunktion werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie **X**, ohne auf OK zu drücken **OK**

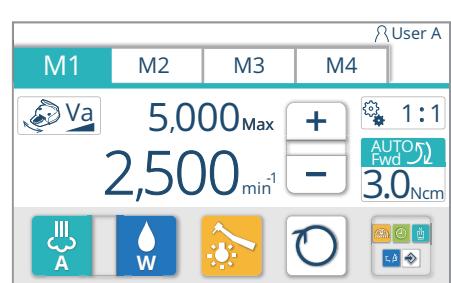

VORSICHT

Wenn eine Feile mit Linksgewinde am NLX plus angebracht ist, wählen Sie immer „Keine automatische Rückwärtsfunktion“ aus und ändern Sie die Drehrichtung mit dem Vorwärts/Rückwärts-SchHolder am Mikromotor. Wenn diese Einheit auf „Automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion“ eingestellt ist, kann die Feile beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

5 Bedienung



MX2

Beim Mikromotor MX2 plus können der Drehmomentwert, die Anwendbarkeit der automatischen Rückwärtsfunktion, die Anwendbarkeit der automatischen Vorwärtsfunktion und die Zeitspanne der automatischen Vorwärtsfunktion eingestellt werden, wenn die maximale Drehzahl auf den niedrigen Drehzahlbereich eingestellt ist (100 bis 5.000 min⁻¹). Die Anwendbarkeit des Reziprokmodus kann eingestellt werden.

Automatisch rückwärts ist eine Funktion, die automatisch auf Rückwärtsdrehung umschaltet (gegen den Uhrzeigersinn), wenn die Last im niedrigen Drehzahlbereich den voreingestellten Drehmomentwert übersteigt (0,4 - 3,5 Ncm).

Automatisch vorwärts ist eine Funktion, die automatisch auf Rückwärtsdrehung umschaltet (gegen den Uhrzeigersinn), wenn die Last im niedrigen Drehzahlbereich den voreingestellten Drehmomentwert übersteigt (0,4 - 3,5 Ncm) und anschließend nach Ablauf der vorgegebenen Zeitspanne (automatische Vorwärtsdrehung) wieder zur Vorwärtsdrehung zurückkehrt (im Uhrzeigersinn).



Im Reziprokmodus oszilliert der Mikromotor im voreingestellten Winkel, mit der voreingestellten Beschleunigung und dem voreingestellten Drehmomentwert. Dieser Modus ermöglicht nur den Start oder Stop des Betriebs.

* Die Drehzahl kann nicht angepasst werden.

Beim Treten auf den Fußanlasser wird  angezeigt, wie in der Abbildung links dargestellt. Wenn Sie nicht auf den Fußanlasser treten, wird  angezeigt.

Die Einstellung von  unten auf dem Bildschirm kann nicht geändert werden.


Um den Reziprokmodus zu verwenden, sind bestimmte Winkelstücke und Feilen erforderlich.

Geeignete Winkelstücke werden im Folgenden dargestellt:
CA ENDO (REF 1600955) von Bien Air

Geeignete Feilen werden im Folgenden dargestellt:
WaveOne® Gold von Dentsply Maillefer


 RECIPROC® von VDW

5 Bedienung

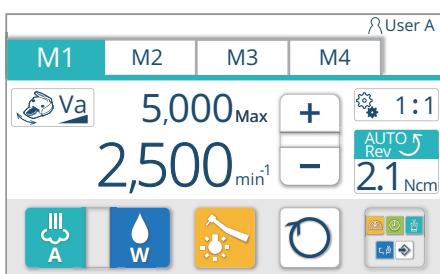

Einstellung eines Drehmomentwertes

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
 2. Wählen Sie einen Speicher aus den RegistersHoldern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
 3. Drücken Sie den Drehmoment-SteuersHolder **2.1 Ncm**, um den Drehmoment-Einstellbildschirm anzuseigen
 4. Drücken Sie den **+** **-**-ScHolder, um den gewünschten Drehmomentwert einzustellen
<Folgende Optionen stehen zur Verfügung:>
0,4/0,7/1,1/1,4/1,8/2,1/2,5/2,8/3,2/3,5
Beim Drücken des **+**-ScHolders wird der nächsthöhere Drehmomentwert aus den genannten Optionen eingestellt.
Beim Drücken des **-**-ScHolders wird der nächstniedrigere Drehmomentwert aus den genannten Optionen eingestellt.
 5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von **OK**
Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.
- * Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie **X**, ohne auf OK zu drücken **OK**

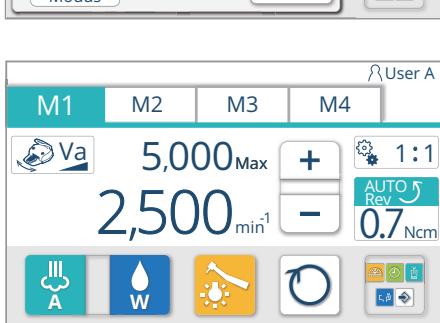

Speicher-Registerkarte



Automatische Rückwärtsfunktion/
Automatische Vorwärtsfunktion

Einstellung der automatischen Rückwärtsfunktion/automatischen Vorwärtsfunktion


1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Speicher aus den Registerscholdern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
3. Drücken Sie den Drehmomentsteuerschholder **2.1 Ncm**, um den Einstellbildschirm für die automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion anzuzeigen
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die automatische Rückwärts-/Vorwärtsfunktion
 - **AUTO Rev**: Einstellung auf „Keine automatische Rückwärtsfunktion“
 - **AUTO Rev**: Einstellung auf „Automatische Rückwärtsfunktion“
 - **AUTO Fwd**: Einstellung auf „Automatische Vorwärtsfunktion“
 - **Reziprok Modus**: Einstellung auf „Reziprokmodus“
[Referenz] Einstellen des Reziprokmodus [Seiten 127 bis 129]

5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von **OK**

Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für die automatische Rückwärtsfunktion, automatische Vorwärtsfunktion und den Reziprokmodus werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie **X**, ohne auf OK zu drücken **OK**

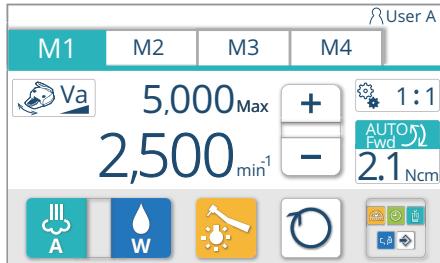

VORSICHT

Wenn eine Feile mit Linksgewinde o. Ä. am MX2 angebracht ist, stellen Sie immer „Keine automatische Rückwärtsfunktion“ ein und schalten Sie die Drehrichtung mit dem Vorwärts-/Rückwärtsschalter am Mikromotor um.


Wenn diese Einheit auf „Automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion“ eingestellt ist, kann die Feile beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

5 Bedienung



Einstellen der automatischen Vorwärtsfunktion

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
 2. Wählen Sie einen Speicher aus den Registerschaltern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
 3. Drücken Sie den Drehmoment-Schalter **AUTO Rev 2.1 Ncm**, um den Bildschirm für die automatische Rückwärtsfunktion anzuzeigen
 4. Wählen Sie in der Einstellung für die automatische Rückwärtsfunktion/ automatische Vorwärtsfunktion die automatische Vorwärtsfunktion **AUTO Fwd** aus
 5. Drücken Sie den **+** **-**-Schalter, um eine Zeit zwischen 0,0 und 25,4 Sekunden zu wählen
Die Auswahl erfolgt in einem Intervall von 0,1 Sekunden.
Wenn der **+** **-**-Schalter gedrückt gehalten wird, beträgt das Zeitintervall 0,5 Sekunden.
 6. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von **OK**
Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.
Die Einstellungen für die Dauer der automatischen Vorwärtsfunktion werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.
- * Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie **×**, ohne auf OK zu drücken **OK**

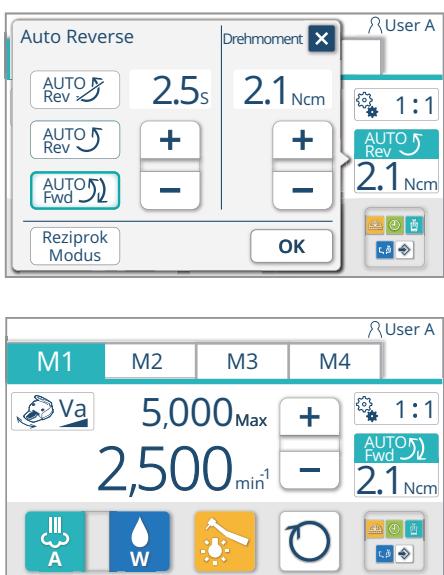


5 Bedienung

Den Reziprokmodus einstellen

Starteinstellung


(Beispiel) Mikromotor MX2 Auto-Rev

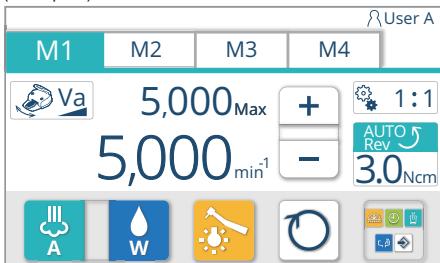

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder

2. Stellen Sie die Drehzahl durch Drücken von **+** **-** auf 5.000 min-1 oder weniger ein.

3. Drücken Sie den Drehmomentregelholder **3.0 Ncm**

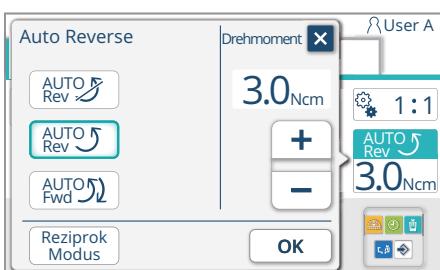

4. Drücken Sie den ReziprokscHolder

Reziprok Modus

Wenn der ReziprokscHolder ausgewählt ist, wird die Rahmenfarbe blau.

* Der **Reziprok Modus**-ScHolder wird nicht angezeigt, wenn Japanisch als Sprache eingestellt ist oder ein anderer Mikromotor als der MX2 verwendet wird.

* Durch Drücken des **X**-ScHolders kehrt die Anzeige zum Mikromotor-Bildschirm zurück.

5. Drücken Sie den **OK**-ScHolder

Je nach der Situation wird der Mikromotorbildschirm (reziproker Modus) sofort angezeigt oder ein Bildschirm wird angezeigt, der zum Erwerb einer Lizenz auffordert.

[Wenn der Bildschirm mit der Aufforderung angezeigt wird, eine Lizenz zu erwerben.]

* Die Schritte 6. bis 9. werden nur bei der Ersteinrichtung ausgeführt. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird sofort der Mikromotorbildschirm (reziproker Modus) angezeigt.

* Beim Drücken des **OK**-ScHolders kehrt die Anzeige zum Drehmoment-Einstellbildschirm zurück.

6. Drücken Sie den **OK**-ScHolder

Der Bildschirm zur Eingabe des Aktivierungscodes wird angezeigt.

7. Den Aktivierungscode erhalten Sie auf der folgenden Website

[Referenz] So erhalten Sie den Aktivierungscode [Seite 129]

<https://dental.bienair.com/waveone/>

Wenn Sie den Aktivierungscode abrufen, ist der oben links auf dem Bildschirm angezeigte ID-Code erforderlich.

8. Geben Sie in Schritt 7 den erhaltenen Aktivierungscode ein.

Wenn Sie die alphanumerische Eingabe umschalten, drücken Sie den alphanumerischen ScHolder **123**. Bei jedem Drücken des ScHolders wechselt die Anzeige in der Reihenfolge **123** - **ABC** - **123**.

9. Drücken Sie nach der Eingabe des Codes den **OK**-ScHolder


5 Bedienung

Mikromotorbildschirm (reziproker Modus)



Ein Summer ertönt und der Mikromotorbildschirm (reziproker Modus) wird angezeigt.

Die Einstellung des Reziprokmodus wird im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

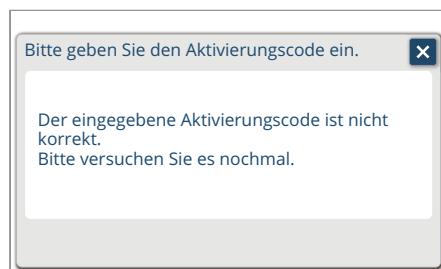

Wenn der Aktivierungscode falsch ist, wird der links abgebildete Bildschirm angezeigt.

Fahren Sie nach dem Drücken des **X**-Scholders mit der Einstellung ab Schritt 8 fort.


Mikromotorbildschirm (reziproker Modus)



Den Reziprokmodus aufheben

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
Der Mikromotorbildschirm (reziproker Modus) wird angezeigt.


2. Drücken Sie den **Reziprok Modus**-Schholder.

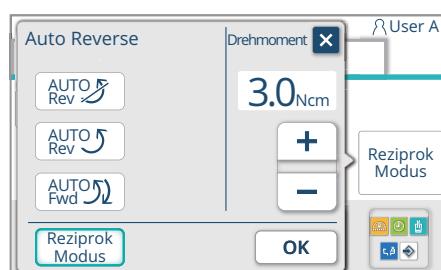

3. Drücken Sie einen der folgenden Schholder: **AUTO Rev ⌈**, **AUTO Rev ⌉** oder **AUTO Fwd ⌈**
Wenn der Schholder ausgewählt ist, wird die Rahmenfarbe blau.

* Durch Drücken des **X**-Scholders kehrt die Anzeige zum Mikromotor-Bildschirm zurück.

(Beispiel) Mikromotor MX2 Auto-Rev

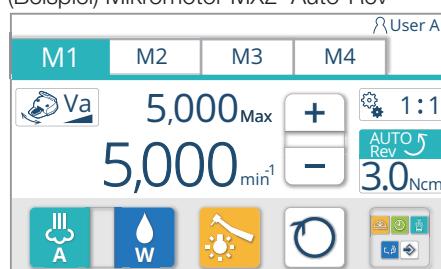

4. Drücken Sie den **OK**-Schholder
Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

5 Bedienung

Website zum Abrufen des Aktivierungscodes



Bildschirm zur Dateneingabe

So erhalten Sie den Aktivierungscode

Wählen Sie die in der linken Abbildung gezeigte „Behandlungseinheit“.

1. Geben Sie die folgenden Informationen in die Felder 1 bis 6 ein.





- 1 Wählen Sie „Belmont“
- 2 Geben Sie Ihren Namen ein
- 3 Geben Sie Ihre Adresse ein
- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
- 5 Geben Sie den Lizenzcode ein, der in der Verpackung des Winkelstücks enthalten ist.
- 6 Geben Sie den ID-Code ein, der auf dem Touchpanel der Arzteinheit angezeigt wird.
[Referenz] Den Reziprokomodus einstellen – Starteinstellung – 7. [Seite 127]

2. Geben Sie die Informationen in die Felder 1 bis 6 ein und drücken Sie **GENERATE THE ACTIVATION CODE**

Der Aktivierungscode wird in Feld 7 angezeigt.

3. Geben Sie den erhaltenen Aktivierungscode in das Feld ein, wenn Sie in Schritt 8 – Starteinstellung – Den Reziprokomodus einstellen dazu aufgefordert werden [Seite 127].

Der Inhalt der Anzeige kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

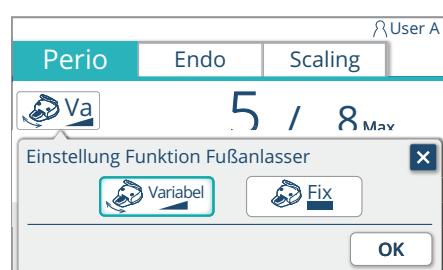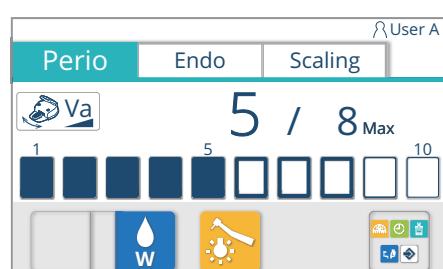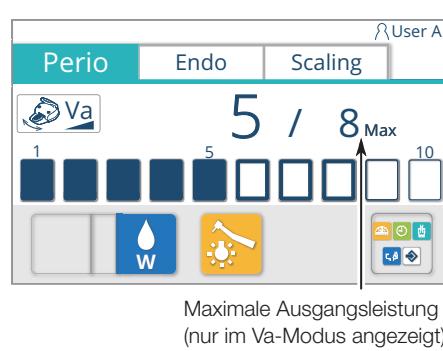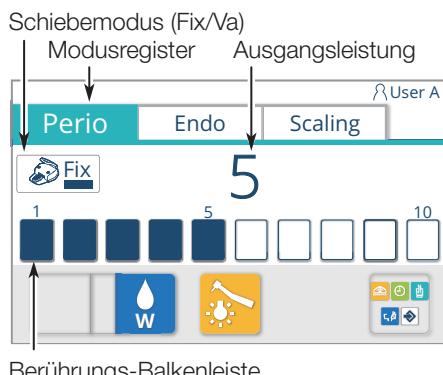

5-17 Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät

ScHoldereinstellung Perio/Endo/Scaling

Wenn der Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder genommen wird, wird der Bildschirm für elektrische Zahnsteinentfernungsgerät angezeigt und der Modus wird oben links angezeigt.

Als Modus kann „Perio“, „Endo“ oder „Scaling“ ausgewählt werden.

Der Modus wird durch Drücken des Modusregisters umgeschaltet.

* Bei der Nutzung von NO PAIN kann der Modus nicht ausgewählt werden.

Als Schiebemode kann Fix oder Va ausgewählt werden.

* Wir empfehlen die Auswahl von „Fest“.

Fix (Fest)

Die Ausgangsleistung wird auf den eingestellten Wert fixiert.

1. Nehmen Sie den Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder

2. Drücken Sie auf den Schiebemode-SchHolder , um den Schiebemode-Einstellbildschirm anzuzeigen

3. Wählen Sie einen Schiebemode aus

4. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von 

Der Bildschirm für elektrische Zahnsteinentfernungsgerät wird angezeigt.

Die Einstellungen für den Schiebemode werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie , ohne auf OK zu drücken 

Va (Variabel)

Durch Verschieben des Pedals nach links oder rechts kann die Ausgangsleistung im Bereich bis zur maximalen Ausgangsleistung eingestellt werden.

Die Ausgangsleistung wird beim Schieben nach links verringert und beim Schieben nach rechts erhöht.


Die Berührungs-Balkenleiste und die Ausgangsanzeige werden entsprechend der Pedalposition angezeigt.

Die maximale Ausgangsleistung kann mit der Berührungs-Balkenleiste    eingestellt werden.

Die Ausgangsleistung des elektrischen Zahnsteinentfernungsgeräts kann nicht verändert werden, wenn der Zahnsteinentfernungsgerät in Betrieb ist. Ändern Sie die Ausgangsleistung des Zahnsteinentfernungsgeräts nach dem Ausschalten mit der Berührungs-Balkenleiste   .

5 Bedienung


Schiebemodus Va

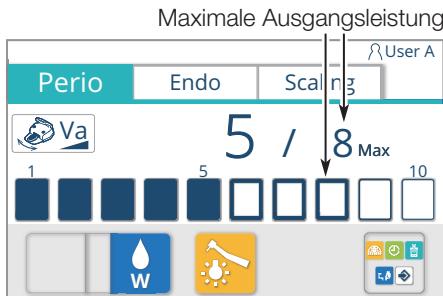

Einstellung der maximalen Ausgangsleistung im Schiebemodus Va

1. Nehmen Sie den Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder
2. Drücken Sie auf die Berührungs-Balkenleiste , die dem gewünschten Wert der maximalen Ausgangsleistung entspricht, und wählen Sie eine maximale Ausgangsleistung von 1 bis 10 aus


Schiebemodus Fix

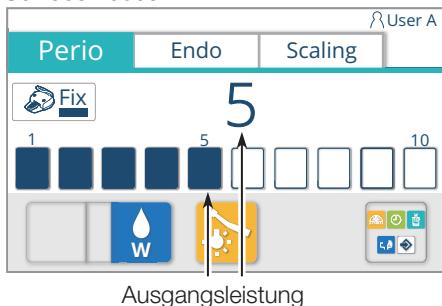

Einstellung der maximalen Ausgangsleistung im Schiebemodus Fix


1. Nehmen Sie den Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder
2. Berühren Sie die Balkengrafik , die dem gewünschten Leistungswert entspricht, um eine Leistung zwischen 1 und 10 oder zwischen 0 und 10 auszuwählen.
(Die Leistung 0 kann nur ausgewählt werden, wenn der Zahnsteinentfernungsgerät NSK VARIOS VS170 oder NSK VARIOS VS170 LUX verwendet wird.)
* Wenn die Leistung 0 beträgt, vibriert der Zahnsteinentfernungsgerät nicht. Setzen Sie sie auf 0, wenn Sie den Zahnsteinentfernungsgerät nur für die Spülung verwenden möchten.

(Beispiel) Wenn die Leistung 1 beträgt

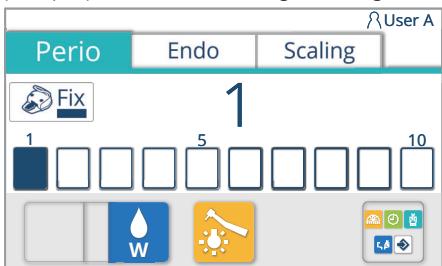

Einstellung der Leistung auf 0

Wenn die Leistung auf 1 gesetzt ist, berühren Sie die Balkengrafik . Die Leistung wird auf 0 gesetzt.

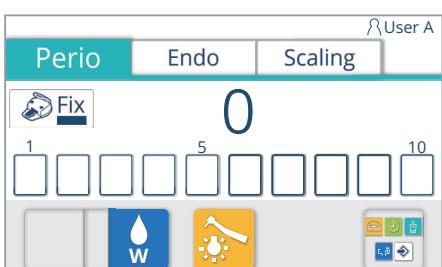

Bei Verwendung einer anderen Spitze außer der Spezifikation mit ausgeschalteter Wasserversorgung ist ein Zahnsteinentfernungsgerät mit eingeschalteter Wasserversorgung (fließendem Wasser) zu verwenden.


Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Zahnsteinentfernungsgerät.

VORSICHT


Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten

Wenn die folgende Einstellung des Handstückzustands geändert wird, kann sie mit den folgenden Schritten gespeichert werden.


- Maximale Ausgangsleistung
[Referenz] Einstellen der maximalen Ausgangsleistung [Seite 131]
- Sprühzustand (Wasser EIN/AUS)
[Referenz] SprühscHolder [Seite 101]
- Handstück-Lichtzustand (EIN/AUS)
[Referenz] HandstücklichtscHolder [Seite 101]

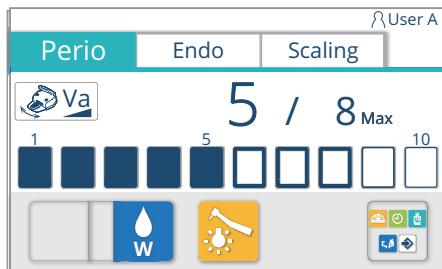

1. Nehmen Sie den Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Modus aus den Modusregistern aus und drücken Sie darauf
3. Handstückzustand ändern (maximale Drehzahl/Sprüh-/Handstücklichtzustand).
4. Drücken Sie den MenüaufrufscHolder , um den Menübildschirm aufzurufen

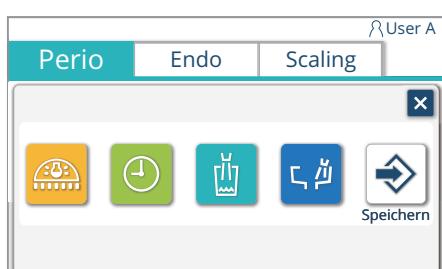

5. Drücken Sie den SpeicherscHolder  Der Speichereinstellbildschirm für den Startzustand wird angezeigt.

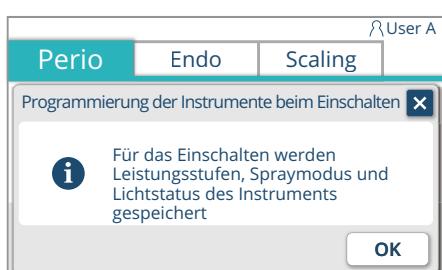


6. Bestätigen Sie die Einstellung, die aufgezeichnet werden soll, und drücken Sie , um sie zu speichern.

* Wenn nicht , sondern  gedrückt wird, ist die geänderte Einstellung gültig, bis der HauptscHolder ausgeschaltet wird, aber die Einstellung kehrt in den Zustand vor der Änderung zurück, sobald der HauptscHolder ausgeschaltet wird.






Bei Verwendung einer Spitze, die nicht der Spezifikation mit Wasserzufuhr AUS entspricht,
verwenden Sie das Zahnsteinentfernungsgerät mit Wasserzufuhr EIN (Wasser läuft)."

Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Zahnsteinentfernungsgerät.

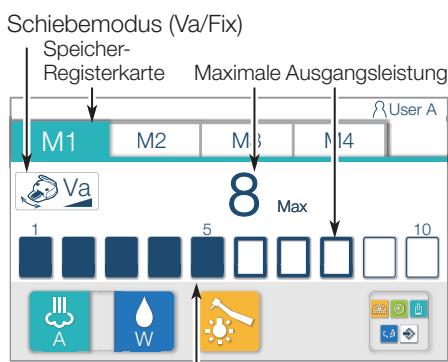

Berührungs-Balkenleiste (oberer Grenzwert der Ausgangsleistung)

(Anzeigbeispiel)
Maximale Ausgangsleistung: 10/
Betriebsausgangsleistung: 5

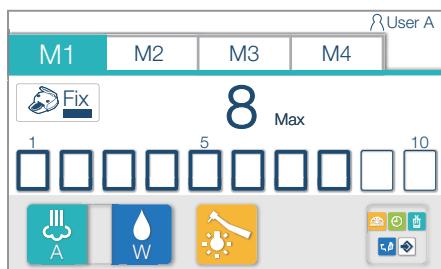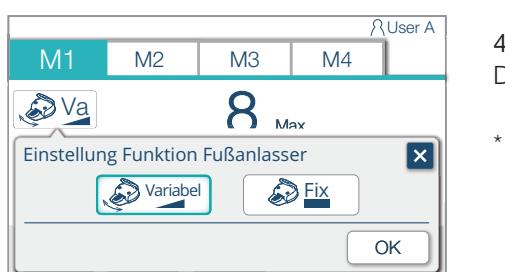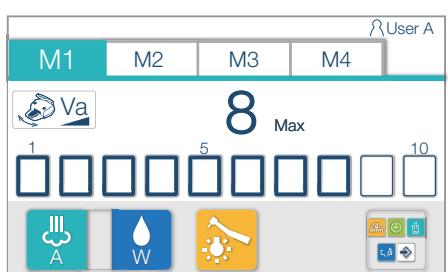

5-18 Luftturbine/Motor

Einstellen des Schiebemode

Die Anfangseinstellung eines Handstücks nach dem Einschalten kann in einen anderen Nutzerspeicher kopiert werden.

Wenn die Luftturbine/der Motor aus dem InstrumentenHolder genommen wird, wird der Turbinen-Bildschirm angezeigt.

Ein Speicher kann aus den vier Speicherplätzen ausgewählt werden (M1 bis M4). Die Speichernummer kann durch Drücken des Speicherregisters umgeschaltet werden.

Als Schiebemode kann entweder Va oder Fix ausgewählt werden.

Der Speicher der Luftturbine/des Motors kann nicht einzeln auf Va oder Fix eingestellt werden.

Die Einstellung Va/Fix muss für M1 bis M4 gleich sein.

Va (Variabel)

Stellen Sie die maximale Ausgangsleistung wie auf [Seite 134] beschrieben ein. Im Betrieb kann die Ausgangsleistung innerhalb des Bereichs bis zu dieser maximalen Ausgangsleistung durch Verschieben des Fußanlasserpedals nach links (zur Verringerung) oder nach rechts (zur Erhöhung) oder durch Drücken (zur Erhöhung) oder Loslassen (zur Verringerung) des Pedals eingestellt werden.

Fix

Stellen Sie die maximale Ausgangsleistung wie auf [Seite 134] beschrieben ein. Der obere Grenzwert der Ausgangsleistung kann auf den Wert der maximalen Ausgangsleistung eingestellt werden, indem das Pedal unabhängig von der Stellung des Pedals für die Fußanlasser gedrückt wird.

1. Nehmen Sie die Luftturbine/den Motor aus dem InstrumentenHolder

2. Drücken Sie auf den Schiebemode-ScHolder , um den Schiebemode-Einstellbildschirm anzuzeigen


3. Wählen Sie einen Schiebemode aus

4. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von 
Der Turbinenbildschirm wird angezeigt.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie , ohne auf OK zu drücken 

(Anzeigbeispiel)

Maximale Ausgangsleistung: Wechsel von 8 auf 10

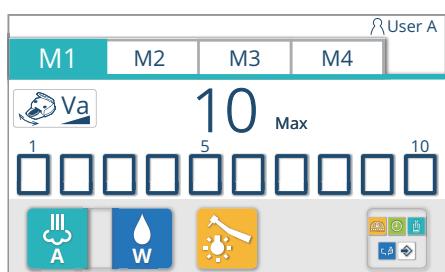

Einstellen der maximalen Ausgangsleistung

1. Nehmen Sie die Luftturbine/den Motor aus dem InstrumentenHolder
2. Drücken Sie auf die Berührungs-Balkenleiste die dem gewünschten Wert der maximalen Ausgangsleistung entspricht, und wählen Sie eine maximale Ausgangsleistung von 1 bis 10 aus

Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten

Wenn die folgende Einstellung des Handstückzustands geändert wird, kann sie mit den folgenden Schritten gespeichert werden.




- Maximale Ausgangsleistung
[Referenz] Einstellen der maximalen Ausgangsleistung [Seite 134]
- Sprühzustand (EIN/AUS/Wasser/Luft)
[Referenz] SprühscHolder [Seite 101]
- Handstück-Lichtzustand (EIN/AUS)
[Referenz] HandstücklichtscHolder [Seite 101]

1. Nehmen Sie die Luftpumpe/den Motor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Speicher aus den RegisterscHoldern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
3. Handstückzustand ändern (maximale Ausgangsleistung/Sprüh-/Handstücklichtzustand)
4. Drücken Sie den MenüaufrufscHolder  , um den Menübildschirm aufzurufen

5. Drücken Sie den SpeicherscHolder 
- Der Speichereinstellbildschirm für den Startzustand wird angezeigt.

6. Bestätigen Sie die angezeigte Einstellung und drücken Sie  , um sie zu speichern

* Wenn nicht  , sondern  gedrückt wird, ist die geänderte Einstellung gültig, bis der HauptschHolder ausgeschaltet wird, aber die Einstellung kehrt in den Zustand vor der Änderung zurück, sobald der HauptschHolder ausgeschaltet wird.

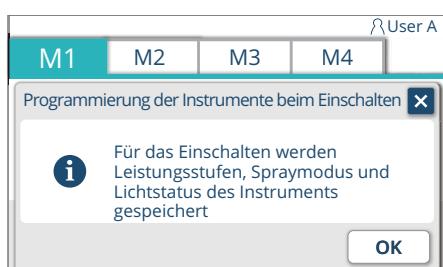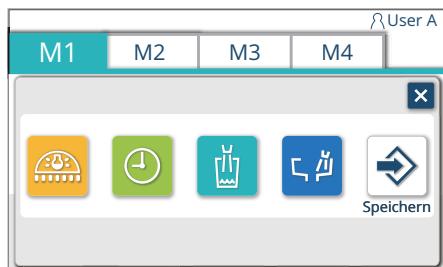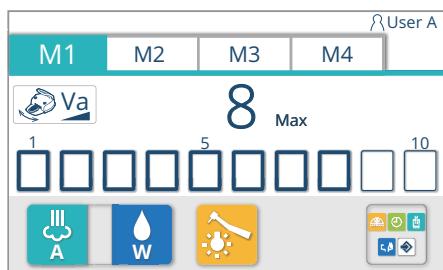

Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für die jeweilige Luftpumpe/den Motor.

5–19 Implantatmotor

5–19–1 Anschlussmethode

Holder




1. Schließen Sie das Mikromotorkabel MX-i-LED 3. Generation an den Motoranschluss an.


Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig ausgerichtet ist.

* Schließen Sie ihn so an, dass die roten Markierungen ausgerichtet sind.

Stange

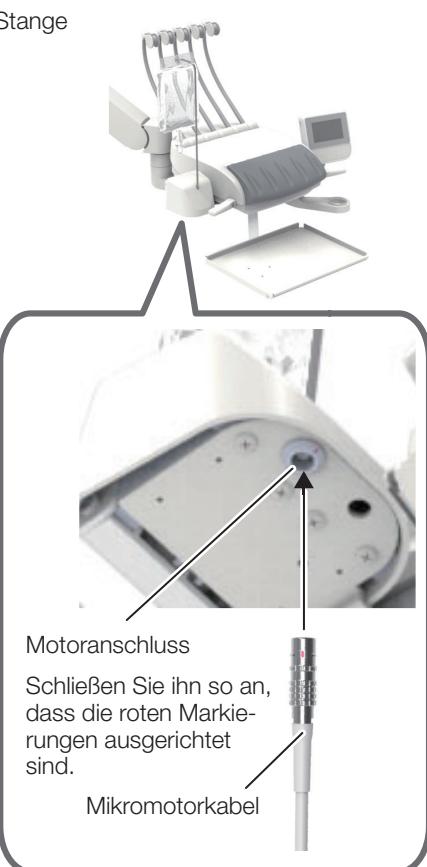

5 Bedienung

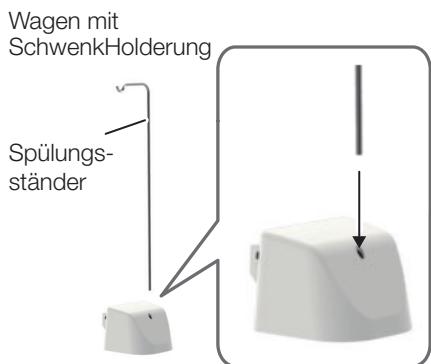

2. Setzen Sie den Spülungsständer in die Öffnung an der Rückseite der Abdeckung der Pumpe ein.
Der Ständer wird verwendet, um eine Kochsalzlösungsflasche aufzuhängen.



3. Vergewissern Sie sich, dass die Spülungsleitung nicht abgelaufen oder beschädigt ist.



Verwenden Sie die Original-Spülungsleitungen von Bien-Air. Sie sind steril und Einwegartikel. Sie dürfen nicht wiederverwendet werden.

VORSICHT



4. Nehmen Sie eine Einwegspülungsleitung aus dem Beutel.

5 Bedienung



5. Schließen Sie die Spülungsleitung an das Sprührohr eines Handstücks (gerades oder Winkelstück) an.

6. Öffnen Sie die Abdeckung der Pumpe. Bringen Sie die Kassette der Spülungsleitung an der Spülungspumpe an.

Vergewissern Sie sich, dass die Kassette ordnungsgemäß festgeklemmt ist.

7. Schließen Sie die Abdeckung der Pumpe.

Wenn Sie beim Schließen der Abdeckung einen Widerstand verspüren, öffnen Sie die Abdeckung erneut und überprüfen Sie, ob die Kassette ordnungsgemäß eingesetzt ist.

Wenn die Abdeckung ordnungsgemäß geschlossen ist, rastet sie ein.

VORSICHT

Wenn die Abdeckung offen ist oder keine Spülungsleitung angeschlossen ist, darf die Pumpe nicht betrieben werden. Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Abdeckung der Pumpe darauf, dass Sie sich nicht Ihre Finger einklemmen.




8. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Spülungsleitung. Führen Sie dann die Spitze der Spülungsleitung in die Kochsalzlösungsflasche ein.





VORSICHT

Wenn die Kochsalzlösungsflasche leer ist, kann sie nicht automatisch vom Gerät erkannt werden. Überprüfen Sie vor der Verwendung den verbleibenden Stand der Kochsalzlösung.

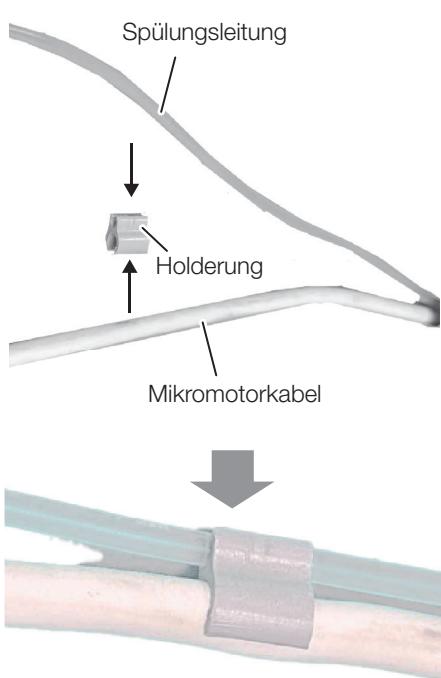


9. Befestigen Sie die Spülungsleitung mit der Holderung am Mikromotorkabel.

5–19–2 Betriebsmethode

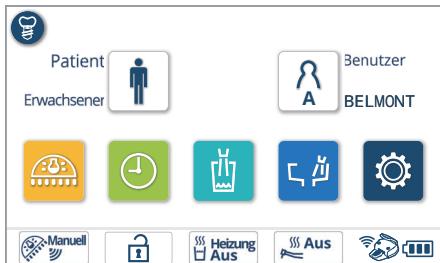


1. Drücken Sie den ImplantatscHolder.

Der Implantatspeicherbildschirm wird angezeigt.



(Wenn Sie M2 auswählen)



2. Wählen Sie einen Implantatspeicher aus.

Der Implantatbildschirm wird angezeigt.
Sie können aus den fünf Speichern M1 bis M5 auswählen. Wählen Sie die Registerkarte des gewünschten Speichers aus.

Stattdessen kann der Fußanlasser (mit Joystickscholdern) verwendet werden.
[Referenz] Seite 56

Mit jedem Treten auf den Fußanlasser wird der ausgewählte Speicher wie folgt geändert: M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M1.

Wenn er von M5 auf M1 wechselt, ändert sich der Betriebston, um Ihnen mitzuteilen, dass der Schaltzyklus abgeschlossen ist.


Wenn Sie den -SchHolder drücken, kehren Sie zum Startbildschirm zurück.



Wenn Sie den ImplantatscHolder erneut drücken, wird die Registerkarte der Speichernummer angezeigt, die beim Schließen des Implantatbildschirms angezeigt wurde.

5-19-3 Einstellung der Handstückbedingungen

Sie können die Einstellungen mit den unten gezeigten Schaltern vornehmen.

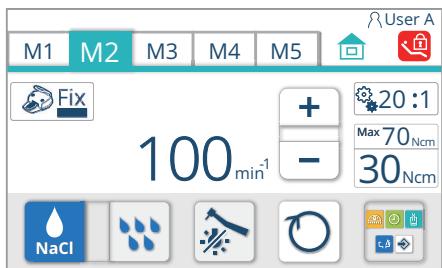

Einstellung des Schiebemode

Der Schiebemode kann nur auf „Fest“ eingestellt werden.


Fest

In diesem Modus können Sie durch Betätigung des Pedals die Drehzahl bis zur festgelegten Drehzahl einstellen, unabhängig davon, ob das Pedal nach rechts oder links zeigt.



(Anzeigbeispiel)

Wenn Sie auf 100 min^{-1} geändert ist

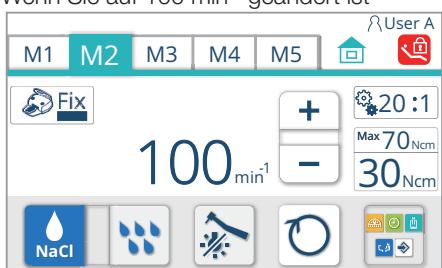

Einstellung der maximalen Leistung

1. Drücken Sie den Plusschalter („+“) oder den Minusschalter („-“).

Mit diesen Schaltern können Sie die maximale Drehzahl erhöhen oder verringern.


Zwischen 2.000 und 250 min^{-1} in Schritten von 50 min^{-1}

Zwischen 250 und 50 min^{-1} in Schritten von 25 min^{-1}

Zwischen 50 und 5 min^{-1} in Schritten von 5 min^{-1}

(Wenn das Übersetzungsverhältnis auf $20:1$ festgelegt ist)

Wenn das Handstück in Betrieb ist, wird die aktuelle Drehzahl angezeigt. Wenn es nicht in Betrieb ist, wird die festgelegte maximale Drehzahl angezeigt.

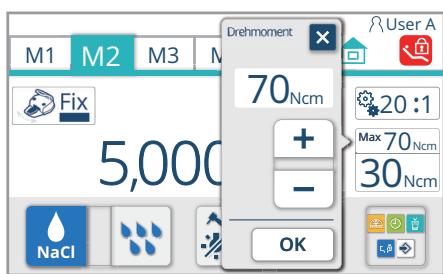


Einstellung des Drehmomentwertes

1. Drücken Sie den Drehmomentsteuerungsschalter.
 2. Wählen Sie aus den Optionen M1 bis M5 die Registerkarte aus, die dem Speicher entspricht, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.
 3. Drücken Sie den Drehmomentsteuerungsschalter um den Drehmomentwerteinstellungsbildschirm anzuzeigen.
 4. Drücken Sie den Schalter oder , um das Drehmoment auf den gewünschten Wert einzustellen.
Der Drehmomentwert wird angezeigt und kann nur eingestellt werden, wenn er kleiner als 100 min^{-1} ist und das Übersetzungsverhältnis 20:1 beträgt.
<Auswählbare Werte>
Zwischen 10 und 70 Ncm in Schritten von 5 Ncm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 oder 70
Durch Drücken des -Schalters wird der Drehmomentwert in den obigen Schritten erhöht.
Durch Drücken des -Schalters wird der Drehmomentwert in den obigen Schritten verringert.
 5. Drücken Sie den -Schalter, um die Änderung zu speichern.
Der Implantatbildschirm wird angezeigt.
- * Drücken Sie nicht den -Schalter, um die Änderung der Einstellung abzubrechen. Drücken Sie stattdessen den -Schalter.


Einstellung des Standardeinschaltspeichers

Wenn Sie eine der folgenden Handstückeinstellungen ändern, können Sie die Änderungen mit den folgenden Schritten speichern:


- Maximale Leistung
[Referenz] Einstellung der maximalen Leistung [Seite 141]
- Drehmomentwert
[Referenz] Einstellung des Drehmomentwerts [Seite 142]
- Status der Kochsalzlösungsspülung (EIN oder AUS)
[Referenz] KochsalzlösungsspülungsumscHolder [Seite 102]
- Volumen der Kochsalzlösungsspülung
[Referenz] UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösung [Seite 102]
- Status des Handstücklichts (EIN oder AUS)
[Referenz] HandstücklichtscHolder [Seite 101]

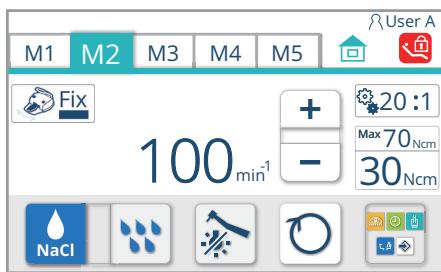

1. Wählen Sie aus den Optionen M1 bis M5 die Registerkarte aus, die dem Speicher entspricht, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.
2. Ändern Sie die gewünschten Handstückbedingungen (maximale Leistung, Status der Kochsalzlösungsspülung, Volumen der Kochsalzlösungsspülung und/oder Status des Handstücklichts).
3. Drücken Sie den „Menü anzeigen“-ScHolder, um den Menübildschirm anzuzeigen.
4. Drücken Sie den „Speichern“-ScHolder. Der Standardspeichereinstellungsbildschirm wird angezeigt.

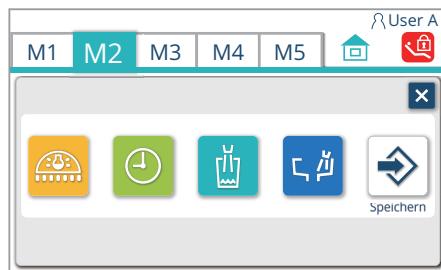

5. Überprüfen Sie den angezeigten Inhalt und drücken Sie **OK**, um ihn zu speichern.
- * Wenn Sie den **OK**-ScHolder nicht drücken und stattdessen den **✖**-ScHolder drücken, bleiben die Änderungen so lange wirksam, bis Sie den HauptscHolder ausschalten; wenn Sie ihn jedoch ausschalten, werden die Änderungen verworfen und die vorherigen Einstellungen wiederhergestellt.

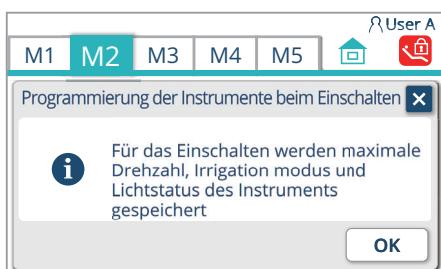

VORSICHT

Lesen Sie die dem Mikromotor beiliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.



Anzeige der Übersetzungsumwandlung (MX-i LED 3. Generation)

Diese Funktion wandelt das Übersetzungsverhältnis des am Mikromotor angeschlossenen geraden oder Winkelhandstücks um und zeigt einen Wert an, der der tatsächlichen Drehzahl nahe kommt.

Die beiden folgenden Übersetzungsverhältnisse können verwendet werden:



1:1 (konstante Drehzahl)
20:1 (Verzögerung 1/20)

1. Wählen Sie aus den Optionen M1 bis M5 die Registerkarte aus, die dem Speicher entspricht, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.
2. Drücken Sie den ÜbersetzungsverhältnisumscHolder 1:1, um den Übersetzungsverhältnisänderungsbildschirm anzuzeigen.
3. Wählen Sie das gewünschte Übersetzungsverhältnis aus.
4. Drücken Sie den -ScHolder, um die Änderung zu speichern.

Der Implantatbildschirm wird angezeigt.

Die Einstellung des ÜbersetzungsverhältnisumscHolders wird als Teil der Standardeinstellungen beim Einschalten gespeichert.

* Drücken Sie nicht den -ScHolder, um die Änderung der Einstellung zu speichern. Drücken Sie stattdessen den -ScHolder.

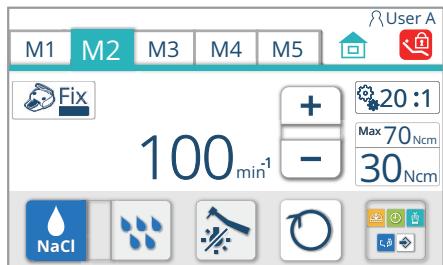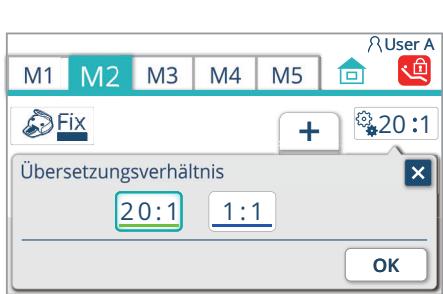

5–20 Spritzen

BT14	3-WEGE-Spritze
SYR-20	3-WEGE-Spritze
Typ 77	3-WEGE-Spritze
LUZZANI	6-WEGE-Spritze (Minilight)
LUZZANI	3-WEGE-Spritze (Minilight)
LUZZANI	3-WEGE-Spritze (Minimate)
DCI 3439	3-WEGE-Spritze
DCI 3459	3-WEGE-Spritze

VORSICHT

Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für die jeweilige Spritze.

Bedienung der BT14 3-WEGE-Spritze/SYR-20 3WEGE-Spritze/ Typ 77 3-WEGE-Spritze

(1) Wasser/Luft sprühen

Drücken Sie den W-Hebel/die Wassertaste, damit Wasser austritt.

Drücken Sie den A-Hebel/die Luftpaste, damit Luft austritt.

Drücken Sie beide Hebel/Tasten gleichzeitig, damit gesprührt wird.


Wasser kommt aus der Mitte der Düse und Luft tritt aus dem Umfang der Spitze aus.

(2) Drehung der Düse

Die Düse dreht sich um 360°.

Wenn die Luft unmittelbar nach der Verwendung von Wasser oder dem Anbringen der Düse zugeführt wird, kann etwas zurückgebliebenes Wasser aus der Düse austreten. Bei der Zufuhr von Luft den Hebel A/die Luftpaste zwei bis drei Mal drücken, um sicherzustellen, dass kein Wasser austritt.


BT14 3-WEGE-Spritze

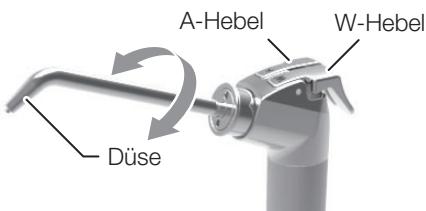


SYR-20 3-WEGE-Spritze

Winkeltyp


Gerade Ausführung

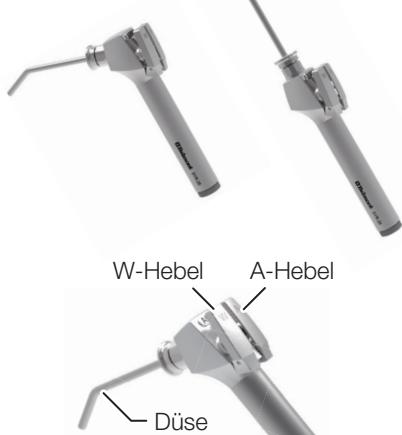

Typ 77 3-WEGE-Spritze

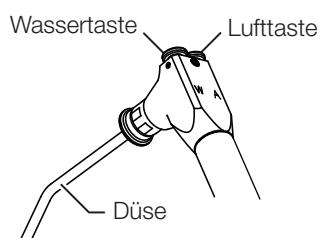


Düsenspitze
(Für alle Typen gemeinsam)

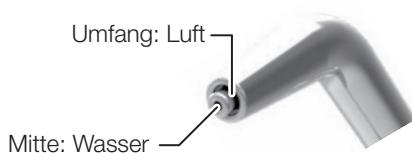


Typ : ES (Kabel)



Typ : ESF (Funk)

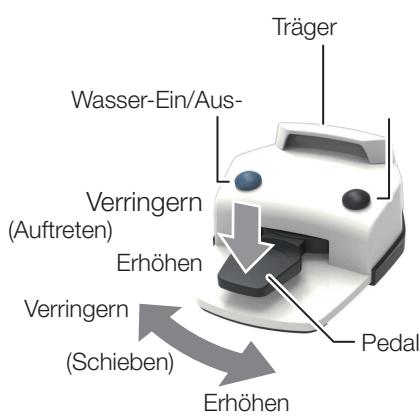

Typ 1

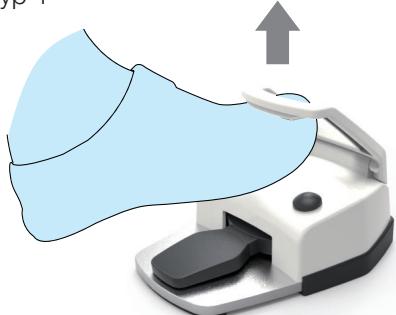

Typ 2



5-21 Fußanlasser (Kabel/Funk)

Pedal

<Wenn der Mikromotor verwendet wird>

Die Drehgeschwindigkeit und die Ausgangsleistung können durch die Stärke der Pedalverschiebung und des Auftretens eingestellt werden.
(Innerhalb des Bereichs der angegebenen maximalen Drehgeschwindigkeit)

Im Va-Modus wird die Drehgeschwindigkeit durch Verschieben des Pedals nach links verringert und durch Verschieben nach rechts erhöht.

<Wenn die Luftturbine/der Motor verwendet wird>

Der Betrieb ist nur bei einer maximalen Ausgangsleistung von 10 möglich und das Ein-/Ausschalten kann durch Auftreten ausgeführt werden. Es ist nicht möglich, die Ausgangsleistung durch die Stärke des Verschiebens/Auftretens einzustellen.

<Wenn der Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät verwendet wird>

Die Funktion wird durch Treten auf das Pedal eingeschaltet.

Es ist nicht möglich, die Ausgangsleistung während des Betriebs durch Verschieben einzustellen.

* Die Ausgangsleistung des elektrischen Zahnsteinentfernungsgeräts kann nicht verändert werden, wenn der Zahnsteinentfernungsgerät in Betrieb ist. Ändern Sie die Ausgangsleistung des Zahnsteinentfernungsgeräts nach dem Ausschalten und aktivieren Sie anschließend den Zahnsteinentfernungsgerät erneut.

Die Ausgangsleistung kann durch Verschieben des Pedals eingestellt werden. Es ist nicht möglich, die Ausgangsleistung durch die Stärke des Auftretens einzustellen.
(Innerhalb des Bereichs der angegebenen maximalen Ausgangsleistung)

Die vorhandene Ausgangsleistung durch Verschieben des Pedals nach links verringert und durch Verschieben nach rechts erhöht.

Wasser-Ein/Aus-SchHolder

Der Sprühmodus kann umgeschaltet werden.

SpitzenluftscHolder

Luft tritt aus der Spitze des Mikromotors oder der Luftturbine/des Motors aus.

Typ 1

Der Fußanlasser kann bewegt werden, indem er über den Fuß gehängt wird.


Typ 2

Der Fußanlasser kann von Hand bewegt werden.

Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Legen Sie die Batterien ein wie unter „Austausch der Batterien im Funken Fußanlasser“ beschrieben [Seite 146].

5-21-1 Überprüfung der Kopplung mit dem Funken Fußanlasser


Ausführung mit Mundspüleinheit

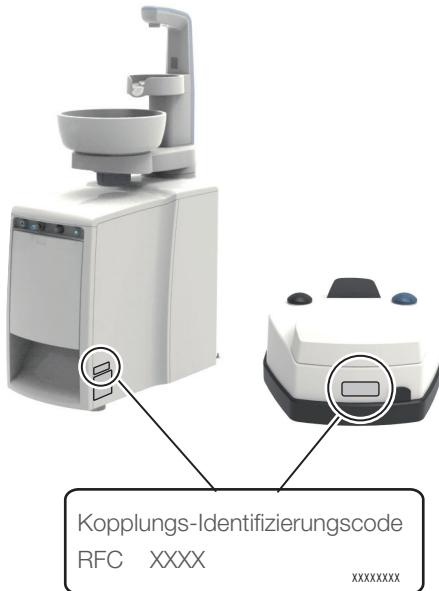

Am Funken Fußanlasser und an der Seite der Mundspüleinheit sind Aufkleber mit dem Kopplungs-Identifizierungscode angebracht.

Vergewissern Sie sich, dass derselbe Kopplungs-Identifizierungscode angezeigt wird.

Ausführung mit Vac Pac-Einheit

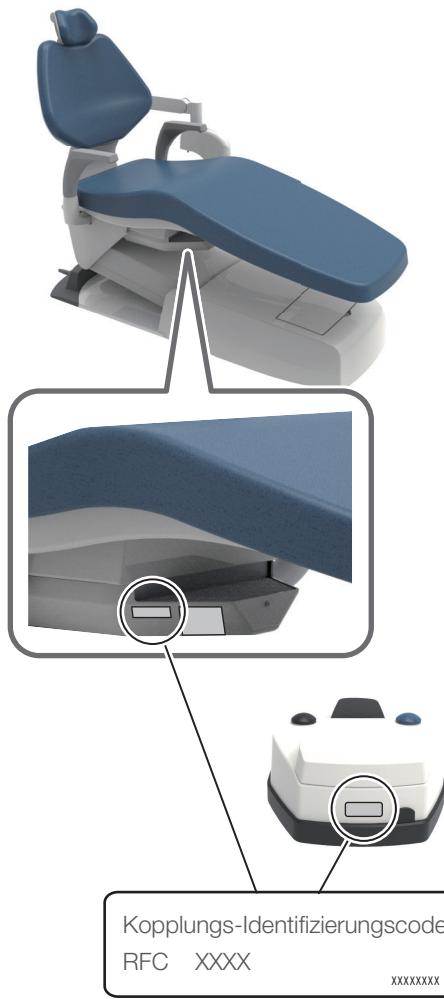

Am Funken Fußanlasser und am unteren Teil des Sitzes sind Aufkleber mit dem Kopplungs-Identifizierungscode angebracht.

Vergewissern Sie sich, dass derselbe Kopplungs-Identifizierungscode angezeigt wird.



Betätigen Sie den Funken Fußanlasser in einem Abstand von einem Meter zum Produkt.



WARNUNG

Wenn auf derselben Etage mehr als ein Patientenstuhl dieses Typs verwendet wird, achten Sie darauf, dass Sie keinen Funken Fußanlasser bedienen, der mit einem anderen Gerät gekoppelt ist.

5–21–2 Austausch der Batterien im Funken Fußanlasser

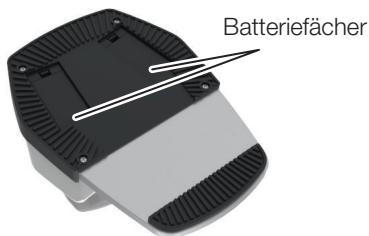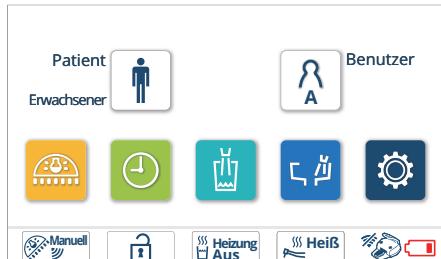



VORSICHT

Wenn die Batteriestandsanzeige auf dem Startbildschirm zu wird, tauschen Sie die Batterien unverzüglich gegen neue aus.

1. Schalten Sie den HauptscHolder aus

2. Entfernen Sie den Deckel der beiden Batteriefächer an der Rückseite des Funken Fußanlassers

Schalten Sie den HauptscHolder aus, wenn Sie die Batterien austauschen. Sonst wird möglicherweise ein scHolder oder ein Pedal versehentlich gedrückt, was zu einer unbeabsichtigten Bewegung führen kann, die zu Schäden oder Verletzungen führt, oder das Produkt funktioniert nicht mehr normal.

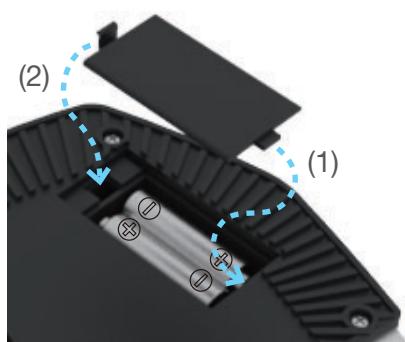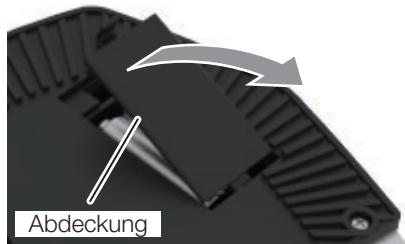

3. Legen Sie zwei neue/geladene AA-Batterien in jedes Fach ein. Verwenden Sie Alkali-Trockenbatterien oder NiMH-Akkus.

Achten Sie darauf, dass Sie jede Batterie in der richtigen Ausrichtung (positiv/negativ) einlegen.

4. Setzen Sie den Deckel der Batteriefächer in der mit Pfeilen (1, 2) gekennzeichneten Reihenfolge auf.

VORSICHT

Verwenden Sie ausschließlich Batterien der angegebenen Typen. Mischen Sie keine neuen Batterien mit alten Batterien oder verschiedene Batterietypen (z. B. Alkali-Trockenbatterien mit NiMH-Akkus). Beachten Sie, dass eine unsachgemäße Verwendung von Batterien zum Auslaufen oder Platzen führen kann.

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät eine Woche oder länger nicht benutzt wird.

Anschlusspunkt

Es gibt einen Anschlusspunkt, von dem die Gummikappe entfernt wird.



Funker Fußanlasser



5-21-3 Kabelverbindung für einen Funken Fußanlasser

Wenn Funker Fußanlasser auch nach dem Austausch der Batterien nicht normal funktioniert, kann das Gerät verwendet werden, indem das in der Verpackung enthaltene Kabel angeschlossen wird.

Die für den Funken Fußanlasser verwendeten elektromagnetischen Wellen könnten bei entsprechenden Umständen am Einsatzort des Produkts unterbrochen werden, was die Funktionen des Handstücks beeinträchtigen kann. Dies ist keine Fehlfunktion des Produkts.

Schalten Sie stets den HauptscHolder aus, bevor Sie das Kabel anschließen. Andernfalls funktioniert das Gerät möglicherweise nicht normal.

Nehmen Sie vor der Verwendung des Kabels die Batterien aus den Batteriefächern. Andernfalls funktioniert das Gerät möglicherweise nicht normal.

Wenn Sie das Kabel entfernen, halten Sie es beim Herausziehen immer am bezeichneten Teil fest. Andernfalls kann die Verbindung unterbrochen werden.

Der Kabelanschluss ist nur für den temporären Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.

Herstellen der Verbindung

Wenn Sie das Kabel an den Stuhl oder die Mundspüleinheit anschließen, nehmen Sie die Gummikappe ab und stecken Sie den Stecker ein, bis ein Klicken zu hören ist. Die Pfeilmarkierung muss nach oben zeigen.



Dasselbe gilt beim Anschluss des Kabels auf der Seite des Funken Fußanlassers.

* Bewahren Sie die Gummikappe des Funken Fußanlassers auf, damit sie nicht verloren geht.


Entfernen

Wenn Sie das Kabel entfernen, halten Sie es beim Herausziehen immer an dem in der Abbildung gezeigten Teil fest und setzen Sie anschließend die Gummikappe wieder auf.

Denken Sie daran, die Gummikappe aufzusetzen, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn Sie es benutzen, ohne die Gummikappe aufzusetzen, kann Wasser und Staub eindringen und einen Defekt verursachen.

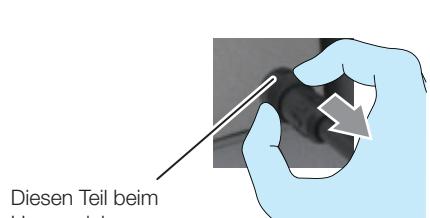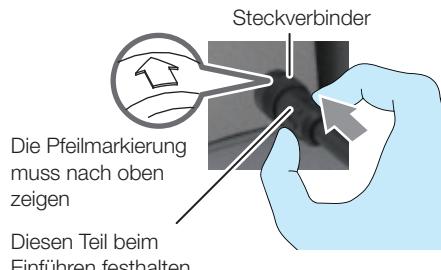

5–21–4 Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung des Funken Fußanlassers



Funkstörungen durch dieses Produkt.

Dieses Produkt enthält Funkeinrichtungen, die das volle 2,4-GHz-Band nutzen ((1)) und Störungen des mobilen Identifizierungsbandes ((4)) sind unvermeidbar. Das FSK-System ((2)) wird als Modulationsverfahren verwendet und der angenommene Störabstand beträgt 10 Meter ((3)).

Der angenommene Störabstand ist die Entfernung, bei der Hochfrequenzstörungen an lokalen Funkstationen oder bestimmten Funksendern mit geringer Leistung erwartet werden.

Viele andere Geräte, einschließlich der unten beschriebenen, nutzen dasselbe Frequenzband wie dieses Produkt: Industrielle Geräte wie Mikrowellenöfen, wissenschaftliche und medizinische Geräte, lokale Funkstationen für die mobile Objektidentifikation in Produktionsanlagen (Funkstationen, die eine Lizenz benötigen), bestimmte Funkstationen mit geringer Leistung (Funkstationen, die keine Lizenz benötigen) und Amateurfunksender (Funkstationen, die eine Lizenz benötigen).

- 1) Vergewissern Sie sich, dass keine lokalen Funkstationen für die mobile Objektidentifikation oder bestimmte Funkstationen mit geringer Leistung in der Nähe in Betrieb sind, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
- 2) Wenn Sie feststellen, dass dieses Produkt schädliche Hochfrequenzstörungen an einer lokalen Funkstation zur mobilen Objektidentifizierung verursacht, schalten Sie unverzüglich alle Funkanlagen ab und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
- 3) Wenn Probleme auftreten, z. B. wenn dieses Produkt schädliche Hochfrequenzstörungen an einer bestimmten Funkstation mit geringer Leistung für die mobile Objektidentifikation verursacht, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Die unten aufgeführten Geräte können Hochfrequenzstörungen im 2,4-GHz-Band verursachen:

- WLAN-Geräte
Empfangscomputer (in Funknetzwerken von Krankenhäusern verwendet), Maus, Tastatur (Bluetooth, 2,4-GHz-Band), Mikroskope, Intraoralkameras, Panorama-Röntgengeräte, CTs usw.
- Vorrichtungen zur mobilen Objektidentifikation (wie z. B. Diebstahlschutzeinrichtungen, Eingangs- und Ausgangsüberwachungssysteme usw.)
- Sonstige (wie z. B. Kauter, Mikrowellenherde usw.)

Zertifizierung der Geräte

In diesem Produkt verbaute Drahtlos-Instrumente sind als Hochfrequenzgeräte für Verbindungen mit geringer Leistung gemäß der Gesetzgebung über Funkanlagen zertifiziert.

Zertifikate sind auf dem Hochfrequenzgerät angegeben. Daher ist für die Nutzung dieses Produkts keine Lizenz erforderlich. Wenn Sie jedoch eine der unten aufgeführten Handlungen an diesem Produkt ausführen, verstößen Sie möglicherweise gegen das Gesetz und können bestraft werden.

- Zerlegen oder Modifizieren der in dieses Produkt eingebauten Hochfrequenzgeräten
- Entfernen der Zertifikatsschilder von den in dieses Produkt eingebauten Hochfrequenzgeräten

Technische Daten des Funken Fußanlassers

Übertragungssystem: F1D (FSK)

Maximale Übertragungsleistung: 1 mW

Batterie: 4 x AA-Batterien

(Alkali-Batterien oder NiMH-Akkus)

Batterielebensdauer: Etwa 1.640 Stunden

- Verwendung von Eneloop-AA-Batterien

- In der Praxis für 15 bis 20 Patienten pro Tag genutzt

- An 5 Tagen pro Woche genutzt, davon an einem nur vormittags

* Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Nutzungsumgebung ab
(Nutzungshäufigkeit, Funkqualität usw.).

* Eneloop ist ein eingetragenes Warenzeichen der Panasonic Group.

5-22 Wartungs-Bedienfeld

(1) Wartungskupplung für Wasser

Dient der Wasserversorgung externer Geräte.

(2) Wasserversorgungssteuerungsknopf der (1) Wasserkupplung für Wasser.

Wird verwendet, um die der (1) Wartungskupplung für Wasser zugeführte
Wassermenge einzustellen.


(3) Wartungskupplung für Luft

Dient der Luftversorgung externer Geräte.

(4) HauptscHolder



5-23 Handstück (HelperinnenHolder)

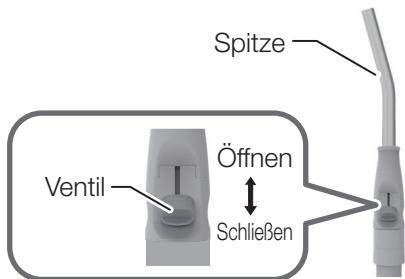


Saughandstück

Nehmen Sie das Saughandstück aus dem HelperinnenHolder und das Absaugen beginnt.

Da ein Verzögerungs-Schaltkreis vorhanden ist, wird der Absaugvorgang nicht sofort gestoppt, wenn das Saughandstück in den HelperinnenHolder zurückgeführt wird. Das Absaugen geht noch ca. 4 Sekunden weiter.

Die Saugmenge kann durch Öffnen oder Schließen des Ventils geregelt werden.

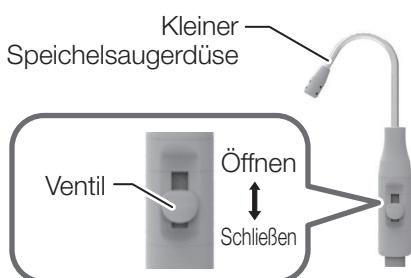


Kleiner Speichersauger-Handstück

Nehmen Sie das Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem HelperinnenHolder und das Saugen beginnt.

Da ein Verzögerungs-Schaltkreis vorhanden ist, wird der Absaugvorgang nicht sofort gestoppt, wenn das Kleiner Speichersauger-Handstück in den HelperinnenHolder zurückgeführt wird. Es geht noch ca. 4 Sekunden weiter.

Die Saugmenge kann durch Öffnen oder Schließen des Ventils geregelt werden.

5-24 Helperinnen-Schlauchklemme

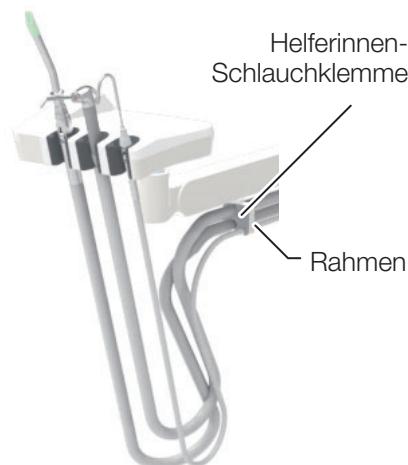


Der Schlauch kann fixiert werden, um zu verhindern, dass die Handstück-Schläuche den Boden berühren.

Die Helperinnen-Schlauchklemme kann vom Rahmen abgenommen werden, was die Reinigung erleichtert.


[Referenz] Helperinnen-Schlauchklemme [Seite 242]



Touchpanel

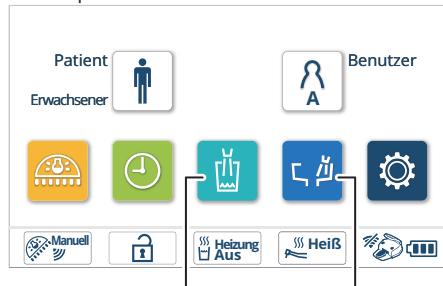

Helperinnen-Bedienfeld

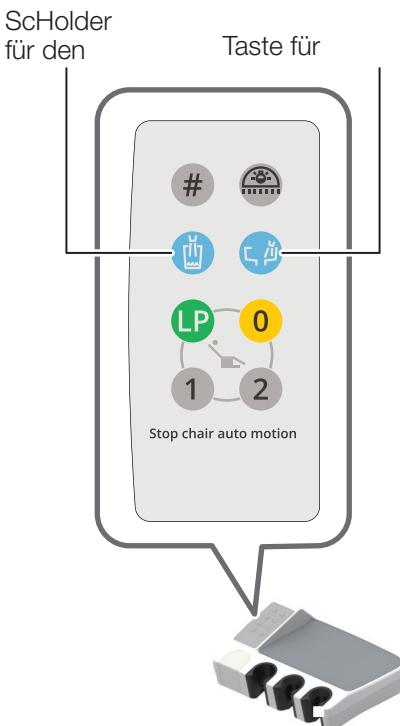

5–25 Einen Becher füllen

Zum Füllen eines Bechers stehen die folgenden beiden Verfahren zur Auswahl:

- Sensor-Becherfüller Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller, dann wird er bis zum angegebenen Füllstand mit Wasser befüllt.
(Becher, Wasserstanderkennung)
 - Manuelle Becherfüllung: Drücken Sie den BecherfüllerschHolder, um für eine festgelegte Zeit Wasser einzufüllen.

Becherfüllmethode	
Automatischer Becherfüller mit Sensorsteuerung (Becher, Wasserstandserkennung)	<p>Wenn ein Becher unter dem Becherfüller steht, erkennt ein Sensor den Becher und füllt ihn mit der festgelegten Menge Wasser.</p> <p>Um das Befüllen abzubrechen, drücken Sie den BecherfüllerschHolder   auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld.</p> <p>Wenn ein Becher mit einem verbliebenen Rest Wasser unter dem Becherfüller steht, wird er mit der korrekten (reduzierten) Wassermenge befüllt.</p> <p>* Auch wenn ein voll gefüllter Becher unter dem Becherfüller steht, wird eine kleine Menge Wasser zugeführt, um den Füllstand zu erkennen.</p> <p>[Ref] Wasserstand des Becherfüllers festlegen [Seite 213]</p>
Manuelle Becherfüllung	<p>Wenn der BecherfüllerschHolder   auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld gedrückt wird, wird für die festgelegte Zeit Wasser zugeführt.</p> <p>Um den Befüllvorgang abzubrechen, drücken Sie den BecherfüllerschHolder   erneut.</p>

Wenn „Speischale spülen“ auf „kontinuierliches Spülen“ eingestellt ist, wird während der Becherfüllung Wasser aus der Beckenspüldüse abgegeben, um das Speischale zu spülen.

Um die Spülung abzubrechen, drücken Sie den Taste für Speibeckenspülung  auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld.

Wenn sich Wassertropfen oder Schmutz auf der Oberfläche des Becherfüllersensors befinden, funktioniert der Becherfüller möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wischen Sie in diesem Fall die Tropfen bzw. den Schmutz ab, nachdem Sie den Sensor in den deaktivierten Modus geschaltet haben.

Sensor-Deaktivierungsmodus (Becherfüller-Service Modus)

Der Sensor-Deaktivierungsmodus kann durch Gedrückthalten des Becherfüllers Holders   auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld für 2 Sekunden oder länger aktiviert werden. Im Sensor-Deaktivierungsmodus werden kontinuierlich Pieptöne ausgegeben und die Sensorsteuerung des automatischen Becherfüllers ist deaktiviert. Die LED-

Anzeige an der Speischaleeinheit wird rosa.
Um den Sensor-Deaktivierungsmodus zu beenden, drücken Sie den
Becherfüllerschalter  erneut. Die LED-Anzeige kehrt zur ursprünglichen
Farbe zurück.

5–26 LED-Anzeige

LED-Anzeige



[EIN, Blau]

Alle Funktionen sind ordnungsgemäß verfügbar.

Blau



[EIN, Orange]

Das System befindet sich in einem der folgenden Zustände:

- Die Stuhlverriegelungsfunktion ist aktiviert.
- Die Handstück-Sperrfunktion ist aktiviert.

[Ref] Stuhlverriegelungsfunktion [Seiten 111 bis 114]

Handstücksperrfunktion [Seite 115]

Orange



[Blinkt orange]

Der Wasserstand in der Wasserflasche ist zu niedrig.

Rosa



[EIN, Rosa]

Das System befindet sich in einem der folgenden Zustände:

- Die Sensorsteuerung für den automatischen Becherfüller befindet sich im Sensor-Deaktivierungsmodus.
- Die ZahnarztLicht/Leuchte ist im Schiebermodus.
- Der Wasserstand des Becherfüllers wird gerade eingestellt.

[Ref] Sensor-Deaktivierungsmodus [Seite 153]

Betriebsmodus der ZahnarztLicht/Leuchte [Seite 98]

Wasserstand des Becherfüllers einstellen [Seite 213]

Da die Farbe der LED-Anzeige einen Hinweis auf den Zustand von Stuhlverriegelung/Handstücksperrfunktion und einen Moduswechsel gibt, prüfen Sie immer die korrekte Funktion der LED-Anzeige, bevor Sie Ihre tägliche Arbeit beginnen.


5-27 Wasserflasche

Füllen Sie Wasser nach, wenn der Füllstand der Wasserflasche zu niedrig ist.

Austausch der Wasserflasche

[Entfernen der Wasserflasche]

(1) Stellen Sie den FLASCHENLUFT-SchHolder nach unten (AUS).

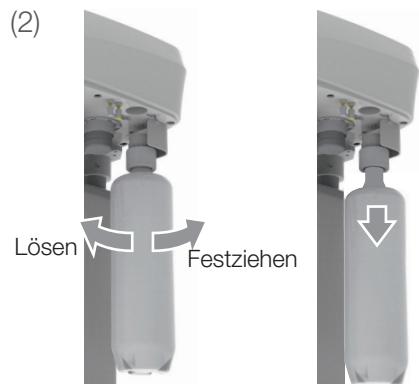

(2) Drehen Sie die Wasserflasche und nehmen Sie sie heraus.


Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Verbindung gelöst.

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Verbindung festgezogen.

[Anbringung]

In der umgekehrten Reihenfolge von (1) bis (4) wieder anbringen.

* Wenn Sie kein Wasser aus einer Wasserflasche nutzen, stellen Sie den WASSER-KippschHolder nach hinten (STADT).

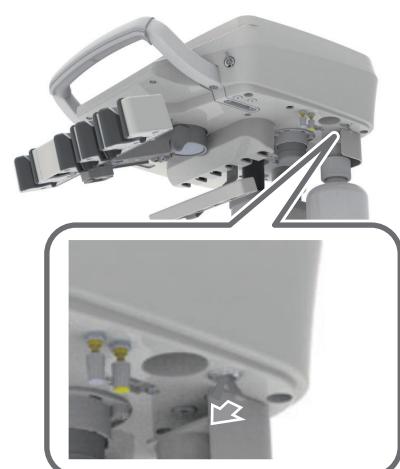

Instrumentenausleger
Holder



5–28 USB-Anschluss

An den USB-Anschluss können ein Arzttisch für eine USB-Intraoralkamera oder andere Geräte angeschlossen werden.

Das Anschlusskabel muss je nach der Spezifikation des Geräts, das hinzugefügt werden soll, innerhalb des Arzttischs verlaufen.

Instrumentenausleger
Stange



5-29 EURUS-Licht/Leuchte



Berührungsloser ScHolder



Schalten Sie den HauptscHolder des Geräts ein; die ZahnarztLicht/Leuchte Licht/Leuchtet auf und die KontrollLicht/Leuchte ebenfalls.

Die ZahnarztLicht/Leuchte kann mit dem berührungslosen ScHolder oder dem ZahnarztLicht/LeuchtenScHolder

auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld ein- und ausgeschaltet werden.

Ein- oder Ausschalten der ZahnarztLicht/Leuchte mit dem berührungslosen ScHolder.

Der berührungslose ScHolder wird durch einen Sensor aktiviert. Der Sensor erkennt ein Objekt in der Breite des Sensorfensters in einem Abstand von ca. 65 mm oder weniger.

Fahren Sie mit der Hand über den ScHolder, um ihn einzuschalten, und erneut, um ihn auszuschalten.

* Wenn die Oberfläche des berührungslosen ScHolders verschmutzt ist, kann das die Empfindlichkeit des ScHolders beeinträchtigen. Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Beleuchtungsstärke im Behandlungsmodus einstellen

Die Beleuchtungsstärke kann durch Drehen des Beleuchtungsstärke-Reglers eingestellt werden.

Die Beleuchtungsstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Licht im EIN-Modus eingeschaltet wurde.

Vom Behandlungsmodus in den Composite-Safe-Modus wechseln

Halten Sie Ihre Hand für die angegebene Zeit innerhalb des 65-mm-Abstands über den berührungslosen ScHolder oder drücken Sie den ZahnarztLicht/LeuchtenScHolder

auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld für die angegebene Zeit, um den Betrieb in den Composite-Safe-Modus umzuschalten.


Die Beleuchtungsstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Licht im Composite-Safe-Modus eingeschaltet wurde.

Wiederholen Sie den obigen Schritt, um in den Behandlungsmodus zurückzukehren.

* Wenn die Licht/Leuchte im Composite-Safe-Modus aus- und wieder eingeschaltet wird, befindet sie sich im Behandlungsmodus.



Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die Bedienungsanleitung für die jeweilige ZahnarztLicht/Leuchte, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

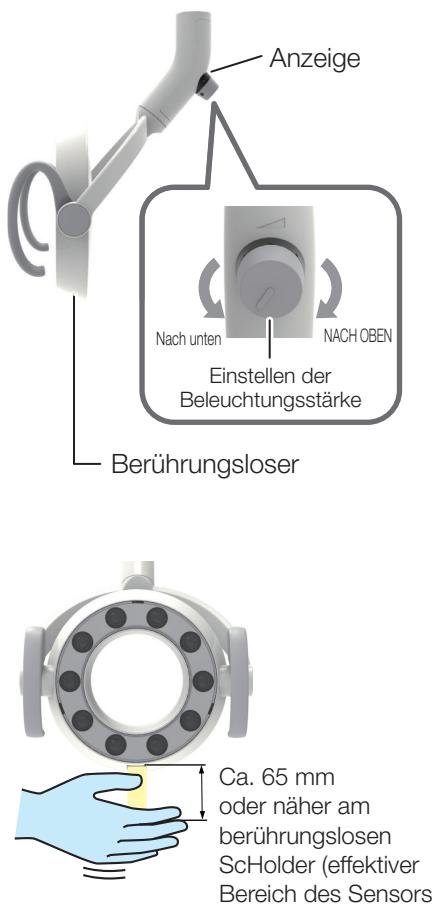

5-30 900 ZahnarztLicht/Leuchte

Schalten Sie den HauptscHolder des Geräts ein; die ZahnarztLicht/Leuchte Licht/Leuchtet auf und die Anzeige wird grün.

Die ZahnarztLicht/Leuchte kann mit dem berührungslosen ScHolder oder dem ZahnarztLicht/LeuchtentScHolder auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld ein- und ausgeschaltet werden.

Ein- oder Ausschalten der ZahnarztLicht/Leuchte mit dem berührungslosen ScHolder.

Der berührungslose ScHolder wird durch einen Sensor aktiviert. Der Sensor erkennt ein Objekt in einem Abstand von ca. 65 mm oder weniger zum ScHolder. Fahren Sie mit der Hand über den ScHolder, um ihn einzuschalten, und erneut, um ihn auszuschalten.

* Wenn die Oberfläche des berührungslosen ScHolders verschmutzt ist, kann das die Empfindlichkeit des ScHolders beeinträchtigen. Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Die Beleuchtungsstärke im Behandlungsmodus einstellen

Die Beleuchtungsstärke kann durch Drehen des Beleuchtungsstärke-Reglers eingestellt werden.

Die Beleuchtungsstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Licht im EIN-Modus eingeschaltet wurde.

Vom Behandlungsmodus in den Composite-Safe-Modus wechseln

Halten Sie Ihre Hand für die angegebene Zeit innerhalb des 65-mm-Abstands über den berührungslosen ScHolder oder drücken Sie den ZahnarztLicht/LeuchtentScHolder auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld für die angegebene Zeit, um den Betrieb in den Composite-Safe-Modus umzuschalten; die Anzeige blinkt grün.

Die Beleuchtungsstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Licht im Composite-Safe-Modus eingeschaltet wurde.


Wiederholen Sie den obigen Schritt, um in den Behandlungsmodus zu schalten; die Anzeige Licht/Leuchte konstant grün.

Modus	Anzeige
Behandlungsmodus	EIN, Grün
Composite-Safe-Modus	Blinkt grün

* Wenn die Licht/Leuchte im Composite-Safe-Modus aus- und wieder eingeschaltet wird, befindet sie sich im Behandlungsmodus.



Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die der jeweiligen ZahnarztLicht/Leuchte beiliegende Gebrauchsanweisung, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

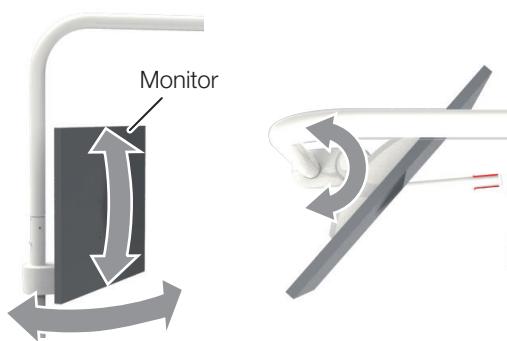

5-31 MonitorHolderung

Der Monitor kann in eine Position geschwenkt werden, in der Sie ihn leicht sehen können. Halten Sie den Monitor beim Einstellen der Position fest, während Sie ihn verstellen.

Lassen Sie den Monitor beim Verstellen nicht gegen die Wand oder einen anderen Gegenstand stoßen.

VORSICHT

Setzen Sie den Monitor und die MonitorHolderung keiner übermäßigen Belastung und keinen Stößen aus. Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Monitor die folgenden Spezifikationen erfüllt:

Größe: Bis zu 340 x 530 mm (L x B)
[22-Zoll- oder kleinerer Monitor]

Gewicht: Bis zu 6,5 kg

*Ausgenommen Abmessungen des Monitorgriffs und anderer Zubehörteile


5-32 Panoramaanzeige

Drehen Sie den ScHolder nach oben, um den Bildschirm einzuschalten, und nach unten, um ihn auszuschalten.

Drehen Sie den Helligkeitsregler nach oben, um die Helligkeit zu erhöhen, und nach unten, um sie zu verringern.

Wenn er nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus.

Die Panoramaanzeige ist zur Ergänzung der Röntgenaufzeichnung konzipiert und ist nicht für die Untersuchung oder Diagnose bestimmt.

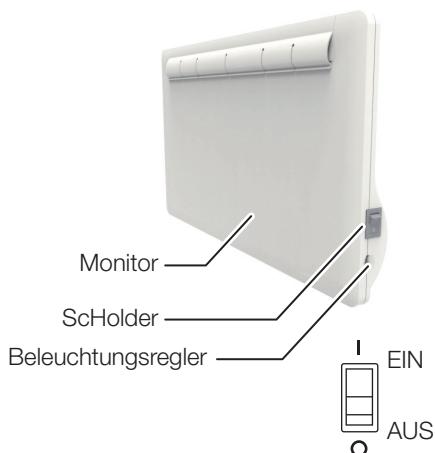


5-33 Dentalanzeige

Drücken Sie den ScHolder, um den Bildschirm einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Bildschirm auszuschalten.

Wenn er nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus.

Die Dentalanzeige ist zur Ergänzung der Röntgenaufzeichnung konzipiert und nicht für die Untersuchung oder Diagnose bestimmt.

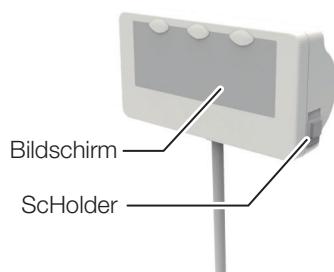

5–34 Umbau rechts-/linkshändige Zahnnarztbehandlung

Bitte lesen, bevor Sie in die rechts- oder linkshändige Ausführung umwandeln. Bringen Sie den Stuhl in die untere Endstellung und stellen Sie die Rückenlehne aufrecht.

Schalten Sie den HauptscHolder aus Sicherheitsgründen aus.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse in der Nähe dieses Produkts befinden.

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Umbaus nicht gegen andere Personen oder Hindernisse stößt. Dies kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.

Umbau rechts-/linkshändige Zahnnarztbehandlung

BodenplatteHolderung

Beispiel: Wechsel von der Rechtshänderposition zur Linkshänderposition für das Standardpaket.

1. Ziehen Sie zum Entriegeln den Sperrhebel C am Schwenkarm nach oben.

Der Sperrhebel C lässt sich möglicherweise nur schwer nach oben ziehen. Ziehen Sie in diesem Fall den Sperrhebel C nach oben und passen Sie dabei die Position des OP-Leuchten-Stanges an.



2. Heben Sie die Fußleiste des Sitzkissens an und schwenken Sie den OP-Leuchten-Stange zur anderen Seite, wie in der linken Abbildung gezeigt. Wenn der OP-Leuchten-Stange die korrekte Position erreicht, wie in der linken Abbildung gezeigt, rastet der Sperrhebel C an der SchwenkHolderung automatisch ein.




3. Stellen Sie nach dem Verstellen des OP-Leuchten-Stanges die Position des Balancearms so ein, wie in der Abbildung links gezeigt.



4. Schwenken Sie den HelferinnenHolder hinter die Rückenlehne, wie in der Abbildung links gezeigt.


VORSICHT

Achten Sie darauf, dass während des Umbaus der Absaug- und der Kleiner Speichelsaugerschlauch nicht zwischen dem Helferinnenarm und dem Schwenkarm des Speischales eingeklemmt werden.

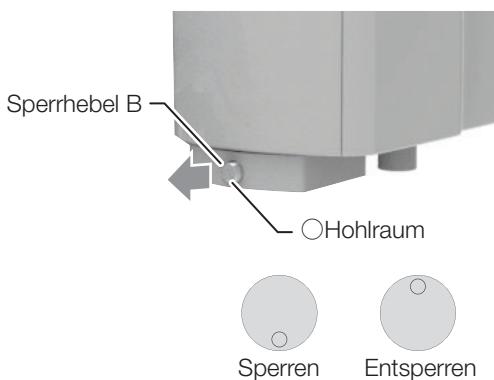

5. Ziehen Sie den Sperrhebel B an der Unterseite der Speischaleinheit nach vorne, bis die rote Markierung zu sehen ist, und drehen Sie dann den Sperrhebel B, so dass der Hohlraum sich oben befindet.


Der Sperrhebel B lässt sich möglicherweise nur schwer herausziehen. Ziehen Sie in diesem Fall den Sperrhebel B nach vorne und passen Sie dabei die Position des Speischalegehäuses an.

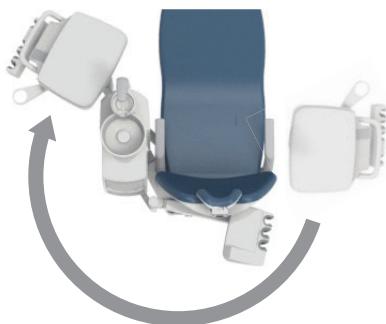

6. Schwenken Sie den Arzttisch zur Speischaleseite, wie in der Abbildung links dargestellt.

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass der Arzttisch während des Umbaus nicht gegen das Speischale stößt.

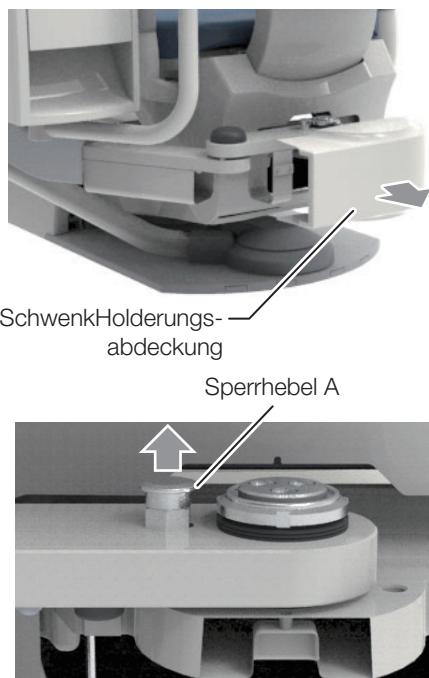

7. Entfernen Sie die Abdeckung der SchwenkHolderung, indem Sie in Pfeilrichtung daran ziehen. Ziehen Sie den Sperrhebel A nach oben und drehen Sie ihn, bis der Hebel einrastet.

Der Sperrhebel A lässt sich möglicherweise nur schwer nach oben ziehen. Ziehen Sie in diesem Fall den Sperrhebel A nach oben und passen Sie dabei die Position der SchwenkHolderung an.

5 Bedienung



8. Schwenken Sie das Speischale hinter den Stuhl, wie in der Abbildung links gezeigt.

VORSICHT


Achten Sie darauf, dass das Speischale während des Umbaus nicht gegen den Arzttisch stößt.



9. Stellen Sie den HelferinnenHolder auf die andere Seite um.
An dieser Stelle werden die Schläuche von Absauger und Kleiner Speichelsauger verdreht.
Nehmen Sie sie aus dem HelferinnenHolder und entwirren Sie die Schläuche.



10. Schwenken Sie das Speischale und den HelferinnenHolder wie in der Abbildung links dargestellt. Wenn das Speischale die korrekte Position erreicht, wie in der linken Abbildung gezeigt, rastet der Sperrhebel A an der SchwenkHolderung automatisch ein.
Die Sperrposition des Speischales ist in Schritt 11 zu sehen.

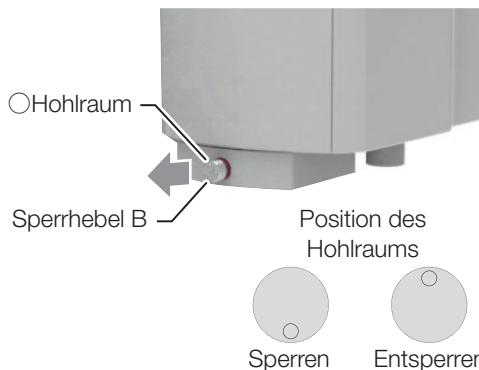

11. Drehen Sie den Sperrhebel B, bis der Hohlraum unten steht.
Der Sperrhebel B kehrt möglicherweise nicht in die Verriegelungsposition zurück. Passen Sie in diesem Fall die Position des Speischalegehäuses an, bis der Sperrhebel B wieder in der Verriegelungsposition ist.



12. Bringen Sie die SchwenkHolderungsabdeckung an der SchwenkHolderung an.


Die Abdeckung der SchwenkHolderung ist für links und rechts gleich. Drehen Sie die Abdeckung um und bringen Sie sie an.

Prüfen Sie nach dem Umbau unbedingt die Sicherheitsfunktionen. Bitte beachten Sie die nächste Seite.

Sicherheitsfunktionen prüfen

Um eine sichere Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte nach jedem Umbau die Sicherheitsfunktionen wie folgt.


Stellen Sie sicher, dass das Touchpanel unter folgenden Umständen einen Sperrbildschirm anzeigt und dass der Stuhl sich nicht verstehen lässt. Informationen zur Stopfunktion der Stuhlverstellung finden Sie auf Seite 112.



- (1) Wenn übermäßiger Druck (nach oben oder unten) auf den Arzttisch ausgeübt wird.



- (2) Wenn der Arzttisch auf die Rückseite der Rückenlehne gedreht ist.

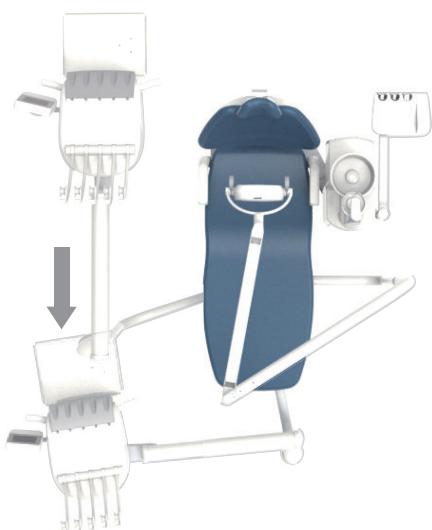

SchwenkHolderung

Beispiel: Wechsel von der Linkshänderposition zur Rechtshänderposition für das Standardpaket.


1. Verstellen Sie den Arzttisch wie in der Abbildung links gezeigt.



2. Ziehen Sie zum Entriegeln den Sperrhebel C am Schwenkarm nach oben.

Der Sperrhebel C lässt sich möglicherweise nur schwer nach oben ziehen.
Ziehen Sie in diesem Fall den Sperrhebel C nach oben und passen Sie dabei die Position des OP-Leuchten-Stanges an.

3. Heben Sie die Fußleiste des Sitzkissens an und schwenken Sie den OP-Leuchten-Stange zur anderen Seite, wie in der linken Abbildung gezeigt.
Wenn der OP-Leuchten-Stange die korrekte Position erreicht, wie in der linken Abbildung gezeigt, rastet der Sperrhebel C an der SchwenkHolderung automatisch ein.

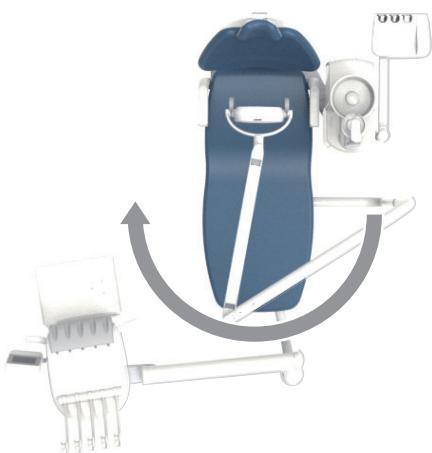

5 Bedienung



4. Stellen Sie nach dem Verstellen des Lichtmasts die Position des Balancearms so ein, wie in der Abbildung links gezeigt.



5. Schwenken Sie den Arzttisch zur Mundspülbeckenseite, wie in der Abbildung links dargestellt.

VORSICHT


Achten Sie darauf, dass der Arzttisch während des Umbaus nicht gegen das Mundspülbecken stößt.



6. Schwenken Sie den Helferinnenhalter hinter die Rückenlehne, wie in der Abbildung links gezeigt.

VORSICHT


Achten Sie darauf, dass während des Umbaus der Absaug- und der Speichelsaugerschlauch nicht zwischen dem Helferinnenarm und dem Schwenkarm des Mundspülbeckens eingeklemmt werden.

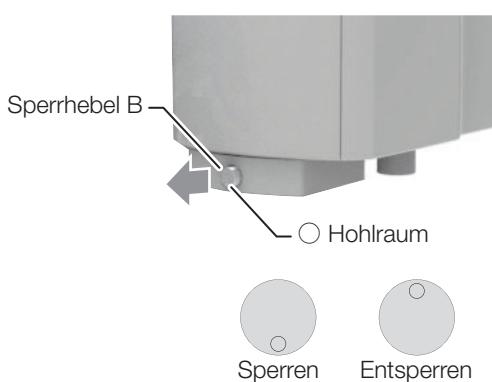

7. Ziehen Sie den Sperrhebel B an der Unterseite der Mundspülbeckeneinheit nach vorne, bis die rote Markierung zu sehen ist, und drehen Sie dann den Sperrhebel B, so dass der Hohlraum sich oben befindet.

Der Sperrhebel B lässt sich möglicherweise nur schwer herausziehen. Ziehen Sie in diesem Fall den Sperrhebel B nach vorne und passen Sie dabei die Position des Mundspülbeckengehäuses an.

5 Bedienung

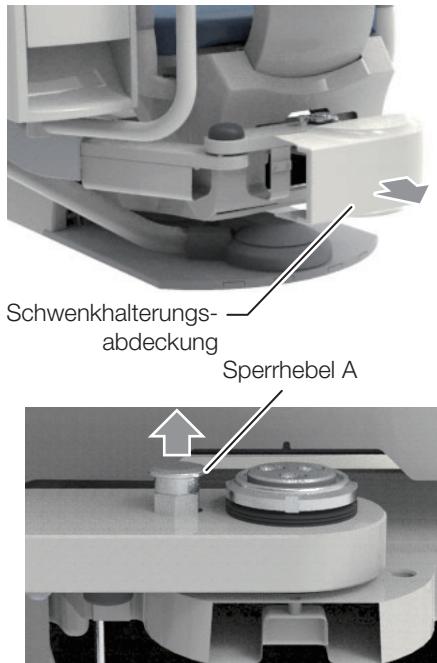

8. Entfernen Sie die Abdeckung der Schwenkhalterung, indem Sie in Pfeilrichtung daran ziehen. Ziehen Sie den Sperrhebel A nach oben und drehen Sie ihn, bis der Hebel einrastet.

Der Sperrhebel A lässt sich möglicherweise nur schwer nach oben ziehen. Ziehen Sie in diesem Fall den Sperrhebel A nach oben und passen Sie dabei die Position der Schwenkhalterung an.



9. Schwenken Sie das Mundspülbecken hinter den Stuhl, wie in der Abbildung links gezeigt.

VORSICHT


Achten Sie darauf, dass das Mundspülbecken während des Umbaus nicht gegen den Arzttisch stößt.




10. Stellen Sie den Helferinnenhalter auf die andere Seite um.
An dieser Stelle werden die Schläuche von Absauger und Speichelsauger verdreht.
Nehmen Sie sie aus dem Helferinnenhalter und entwirren Sie die Schläuche.



11. Schwenken Sie das Mundspülbecken und den Helferinnenhalter wie in der Abbildung links dargestellt. Wenn das Mundspülbecken die korrekte Position erreicht, wie in der linken Abbildung gezeigt, rastet der Sperrhebel A an der Schwenkhalterung automatisch ein.
Die Sperrposition des Mundspülbeckens ist in Schritt 12 zu sehen.

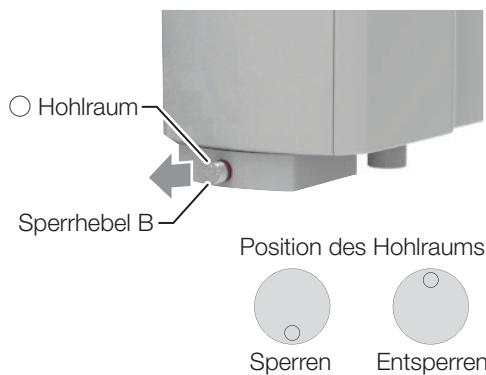


12. Drehen Sie den Sperrhebel B, bis der Hohlraum unten steht.
Der Sperrhebel B kehrt möglicherweise nicht in die Verriegelungsposition zurück. Passen Sie in diesem Fall die Position des Mundspülbeckengehäuses an, bis der Sperrhebel B wieder in der Verriegelungsposition ist.

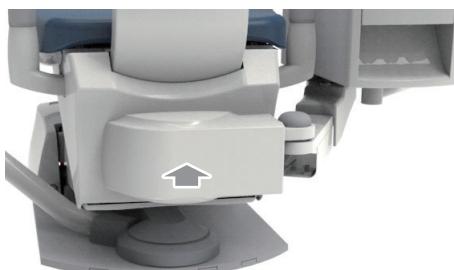

13. Bringen Sie die Schwenkhalterungsabdeckung an der Schwenkhalterung an.
Die Abdeckung der Schwenkhalterung ist für links und rechts gleich.
Drehen Sie die Abdeckung um und bringen Sie sie an.

6-1 Einstellung für automatischen Betrieb

6-1-1 Einstellung der Behandlungs- und Einstiegs-/Ausstiegspositionen



Manuelle SteuerschHolder



VoreinstellungsschHolder




Automatischer RückkehrschHolder

1. Fahren Sie den Stuhl mit der manuellen Steuerung in die Behandlungsposition oder die Einstiegs-/Ausstiegsposition, falls erforderlich.

2. Halten Sie den VoreinstellungsschHolder 1 oder 2 (Behandlungsposition) bzw. den automatischen RückkehrschHolder 0 (Einstiegs-/Ausstiegsposition) ca. 5 Sekunden lang gedrückt.

Ein Piepton ertönt und der Stuhl wird auf die Position eingestellt.

3. Fahren Sie den Stuhl aus der eingestellten Position und drücken Sie den VoreinstellungsschHolder, um zu prüfen, ob der Stuhl in die eingestellte Position fährt.



Manuelle SteuerschHolder



Letzte-Position-SchHolder

6-1-2 Einstellung der Mundspülposition


1. Fahren Sie den Stuhl mit dem manuellen SteuerschHolder in die voreingestellte Mundspülposition.

2. Halten Sie den Letzte-Position-SchHolder LP ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton ertönt und der Stuhl wird auf die Position eingestellt.

3. Fahren Sie den Stuhl aus der eingestellten Position und drücken Sie den Letzte-Position-SchHolder LP, um zu prüfen, ob der Stuhl in die eingestellte Position fährt.

6-2 Funktionstaste

Startbildschirm

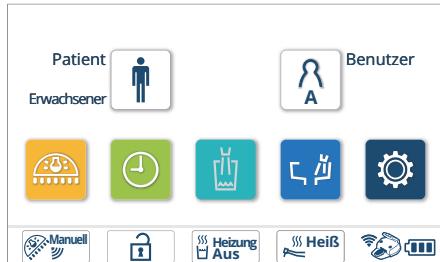

Drücken Sie den Funktionstaste auf dem Startbildschirm, um den Funktionseinstellbildschirm aufzurufen.

Wählen Sie einen Punkt aus, um den entsprechenden Einstellbildschirm anzuzeigen.

Drücken Sie den -SchHolder, um den Vorgang abzubrechen und vom aktuellen Bildschirm zum Startbildschirm zurückzukehren.


Drücken Sie den -SchHolder, um den Vorgang abzubrechen und vom aktuellen Bildschirm zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie den -SchHolder, um zur nächsten Seite zu gelangen.

Drücken Sie den -SchHolder, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

Drücken Sie den -SchHolder, um zur 3. Seite zu gelangen.

Drücken Sie den -SchHolder, um zur 2. Seite zurückzukehren.

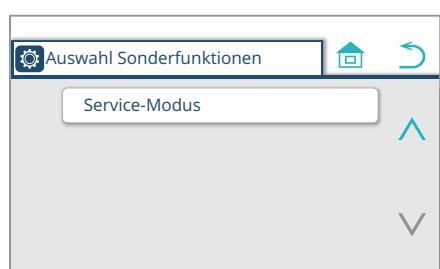

6–2–1 Elemente mit dem Funktionstaste einstellen

Elemente einstellen, die auf dem Touchpanel angezeigt werden	
Spülen, Auswaschen der Absaugleitung	
Spülen	Seite 171
Absaugleitung auswaschen	Seite 191
Handstück	
Antriebsluftdruck	Seite 208
Sprühmodus	Seite 209
HandstückLicht/Leuchte aktivieren	Seite 210
Helligkeit der MikromotorLicht/Leuchte	Seite 211
Becher, Becken	
Wasserstand für den Becherfüller	Seite 213
Synchronisation von Becherfüllung, Beckenspülung	Seite 215
Beckenspülzeit	Seite 216
Sprache	Seite 217
Timer und Bedienfeld	
Timer-Alarmton	Seite 218
Tastenlautstärke	Seite 219
Schlafmodus-Zeit	Seite 220
Notabschaltung Stuhlverriegelung	Seite 221
Programmversion	Seite 222
Service Modus	*

* Der Servicemodus ist ausschließlich für Wartungstechniker bestimmt, die Wartungsarbeiten an diesem Produkt durchführen.


6-2-2 Auswahl des Spülverfahrens und Durchführung der Spülung

Ausführung mit Mundspüleinheit

Wasserkreislauf des Handstücks einzeln spülen

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

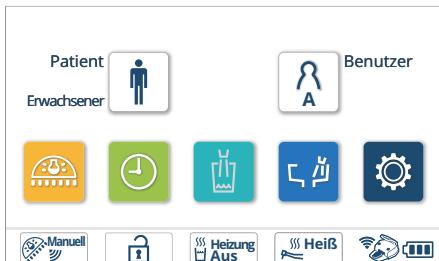


2. Drücken Sie den ScHolder, Flush-out & Saugschlauch-Reinigung*.

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen 'Spülen' auf dem Bildschirm angezeigt.
Die unten aufgeführten Verfahren stehen nicht zur Verfügung.



3. Drücken Sie den 'Spülen'-ScHolder.

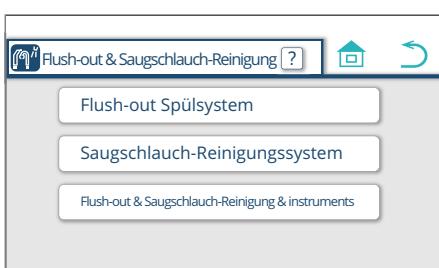

4. Vergewissern Sie sich, dass „Handstücke 00:40“ ausgewählt ist, und drücken Sie den  ScHolder.


[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung (Handstück) [Seiten 181 182]




* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abzubrechen.

Drücken Sie , um die Spülung zu starten.



6 Einstellen/Anpassen

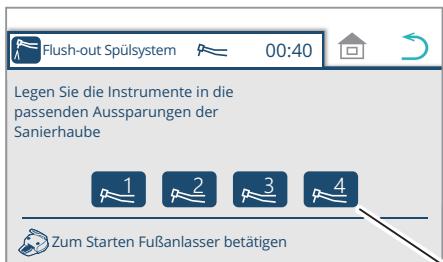


5. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in das Speischale.

[Referenz] Handstücke/Spritze zum Spülen vorbereiten [Seite 190]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -SchHolder gedrückt wird.

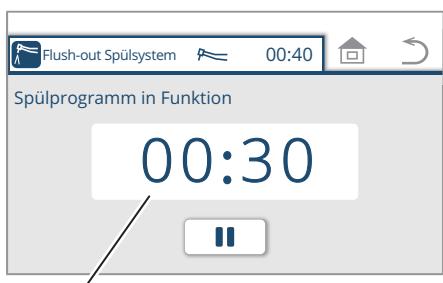

6. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, gibt das Handstück 40 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab.


Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der -SchHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -SchHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen SchHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

* Um den Spülvorgang fortzusetzen, drücken Sie den -SchHolder.

* Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den -/MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldschHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abzubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldschHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

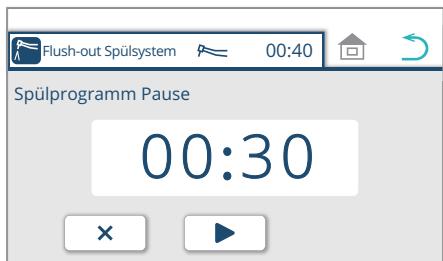

7. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.



* Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.



Spülen der Wasserkreisläufe des Handstücks und des Becherfüllers

Dieser Modus dient dazu, die Einheit bei der Wasserflaschen-Spezifikation mit chemischer Lösung aus der Wasserflasche zu befüllen.

* Stellen Sie einen Becher unter den MundglasHolder

1. Drücken Sie die Funktionstaste .


Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

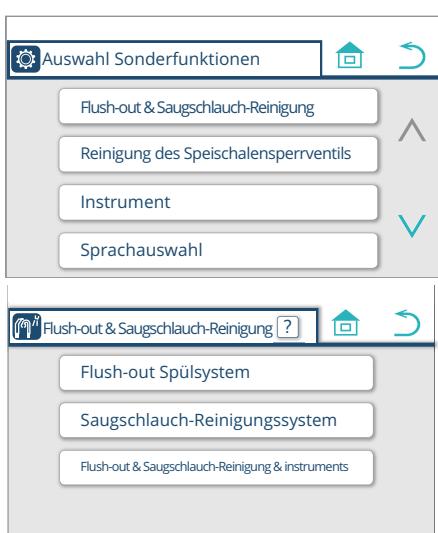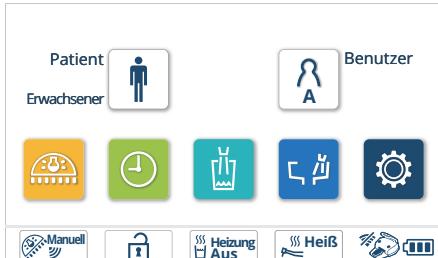

2. Drücken Sie den ScHolder, Spülen, Auswaschen der Absaugleitung'

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen 'Spülung' auf dem Bildschirm angezeigt. Die unten aufgeführten Verfahren sind nicht anwendbar.


3. Drücken Sie den 'Spülung'-ScHolder.

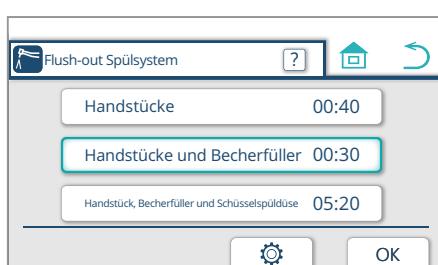


4. Vergewissern Sie sich, dass „Handstücke und Becherfüller 00:30“ ausgewählt ist, und drücken Sie den  ScHolder. .

Zeiteinstellung ändern

[Referenz] Timer-Einstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller) [Seiten 206, 207]

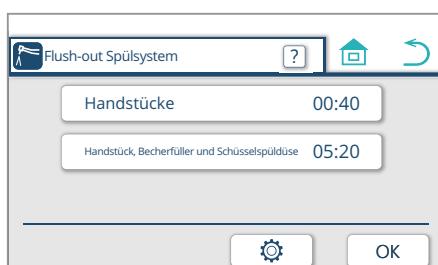

Wenn die Wasserflaschen-Spezifikation nicht installiert ist, wird der Bildschirm links angezeigt. Das folgende Verfahren ist nicht anwendbar.

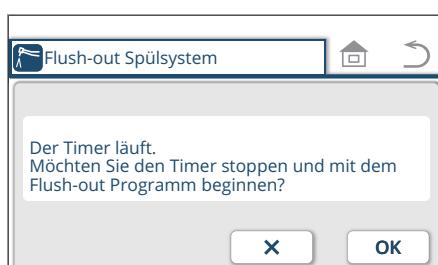


* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abzubrechen.

Drücken Sie , um die Spülung zu starten.

6 Einstellen/Anpassen

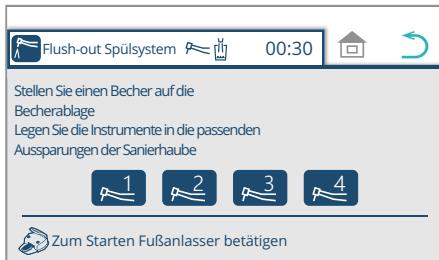

5. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in das Speischale.l.

[Referenz] Vorbereitung der Handstücke/Spritze zum Spülen [Seite 213]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der ScHolder gedrückt wird.

* Informationen zum eingebauten Spülsystem finden Sie auf [Seite 199] unter „Einsetzen der Handstücke in das eingebaute Spülsystem“

Bevor Sie mit dem Spülen beginnen, stellen Sie immer einen Becher auf den MundglasHolder. Ohne Becher spritzt Wasser auf die Wand oder den Stuhl.



6. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, geben die Handstücke 20 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab. Anschließend gibt die Becherfüllerdüse 10 Sekunden lang Wasser ab.


Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der ScHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranscHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal. To suspend

*Drücken Sie , um den Spülvorgang fortzusetzen.

*Um den Spülvorgang nach dem Drücken von , vorzeitig abzubrechen, drücken Sie /den MembranscHolder/Helferinnen-BedienfeldscHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abzubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranscHolder/Helferinnen-BedienfeldscHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

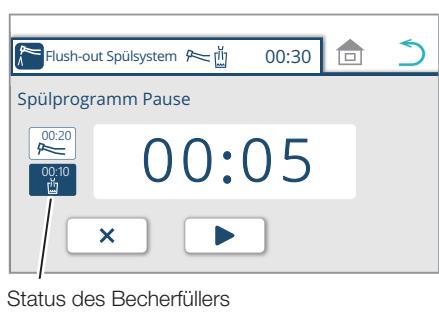


7. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.



Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird..

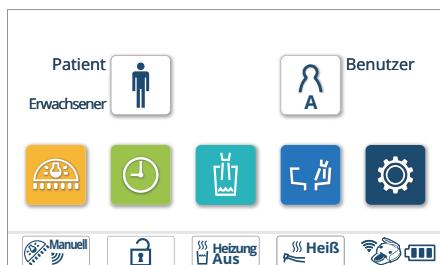


Spülen der Wasserkreisläufe von Handstück und Becherfüller/ Speischale

* Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller


1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

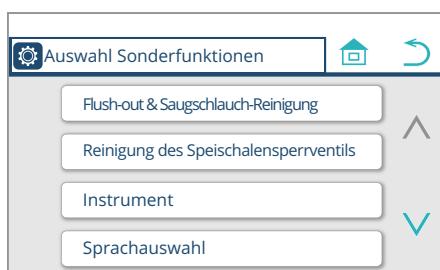


2. Drücken Sie den ScHolder, 'Flush-out & Saugschlauch-Reinigung'.

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen 'Spülen' auf dem Bildschirm angezeigt.
Die unten aufgeführten Verfahren stehen nicht zur Verfügung.

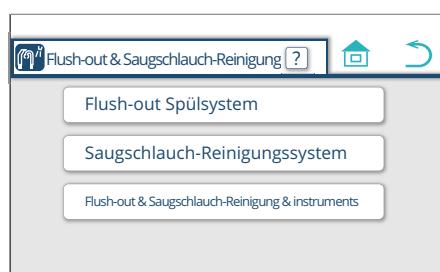


3. Drücken Sie den 'Spülen'-ScHolder.

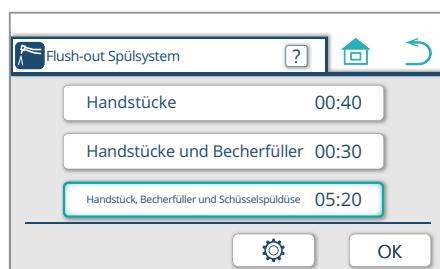

4. Vergewissern Sie sich, dass „Handstück, Becherfüller und Beckenspülüse 05:20“ ausgewählt ist, und drücken Sie den ScHolder..

Timer-Einstellung ändern

[Referenz] Timer-Einstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller + Speischale)
[Seiten 185, 186]"

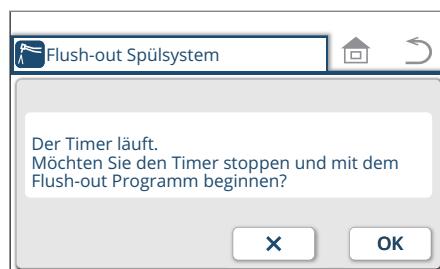


* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abzubrechen.

Drücken Sie , um die Spülung zu starten.

6 Einstellen/Anpassen

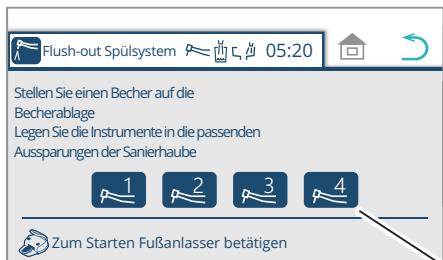

5. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in das Speischale.

[Referenz] Handstücke/Spritze zum Spülen vorbereiten [Seite 190]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

Bevor Sie mit dem Spülen beginnen, stellen Sie immer einen Becher unter den Becherfüller. Ohne Becher spritzt Wasser auf die Wand oder den Stuhl.



Status der Handstückspülung

Verbleibende Zeit (z. B. 4 min)

6. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, geben die Handstücke 2 Minuten und 40 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab. Anschließend geben die Becherfüllerdüse und die Beckenspüldüse 2 Minuten und 40 Sekunden lang Wasser ab.


Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der ScHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranscHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

* Drücken Sie , um den Spülvorgang fortzusetzen.

* Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den -/MembranscHolder/Helferinnen-BedienfeldscHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abzubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranscHolder/Helferinnen-BedienfeldscHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

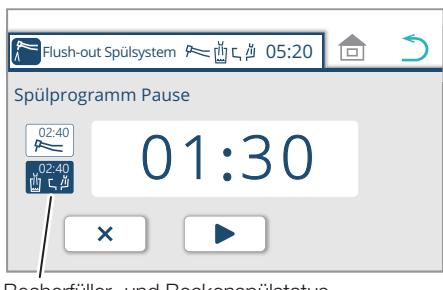

Becherfüller- und Beckenspülstatus

7. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.



* Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.


6 Einstellen/Anpassen

Vac-Pac-Einheitstyp/Typ ohne Speischale


Wasserkreislauf des Handstücks einzeln spülen (Kurzmodus)

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

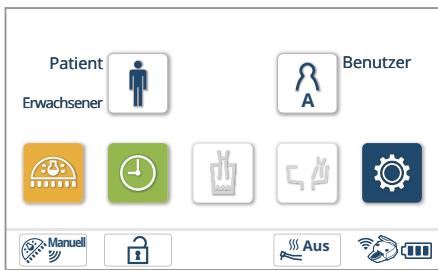


2. Drücken Sie den „Spülen“-ScHolder.

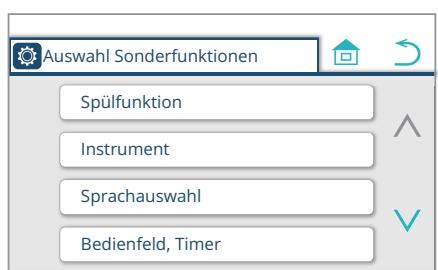

3. Vergewissern Sie sich, dass „Handstücke Kurzmodus 00:40“ ausgewählt ist, und drücken Sie den .

Änderung der Timereinstellung


[Reference] Einstellung des Spültimers (Ausführung mit Vac-Pac-Einheit/ohne Mundspülbecken) [Seiten 187, 188]




* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abzubrechen.

Drücken Sie , um die Spülung zu starten.



6 Einstellen/Anpassen

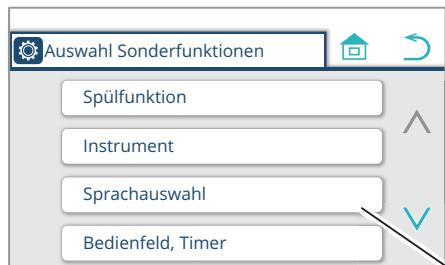


4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in einen Behälter, z. B. einen Eimer.

[Referenz] Handstücke/Spritze zum Spülen vorbereiten [Seite 190]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommenen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -SchHolder gedrückt wird.

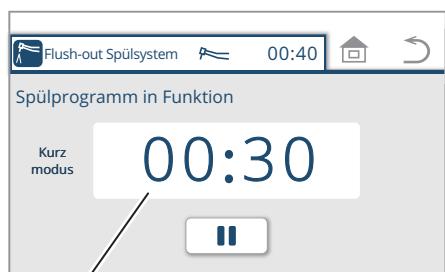

5. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, gibt das Handstück 40 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab.


Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der -SchHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -SchHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen SchHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

* Um den Spülvorgang fortzusetzen, drücken Sie den -SchHolder.

* Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den -/MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldschHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abzubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldschHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

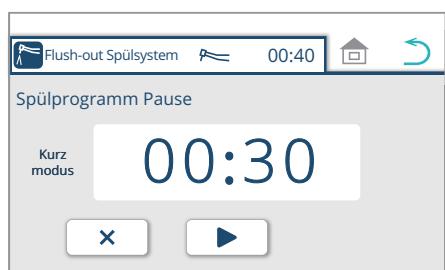


6. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.



* Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.


6 Einstellen/Anpassen

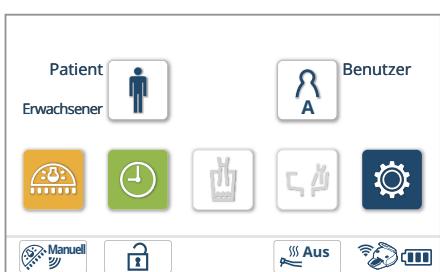


Wasserkreislauf des Handstücks einzeln spülen (Langmodus)

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

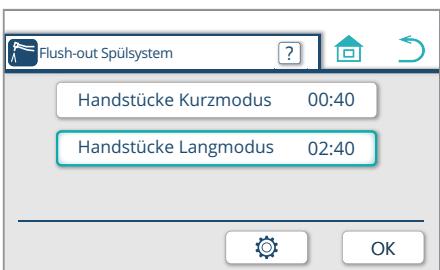


2. Drücken Sie den ‚Spülen‘-ScHolder.

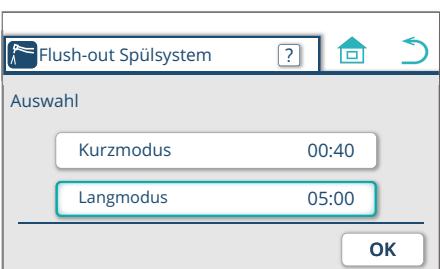

3. Vergewissern Sie sich, dass „Handstücke Langmodus 02:40“ ausgewählt ist, und drücken Sie den ScHolder.

Timer-Einstellung ändern

[Referenz] Timer-Einstellung der Spülung (Vac-Pac-Einheitstyp/Typ ohne Speischale) [Seiten 187, 188]

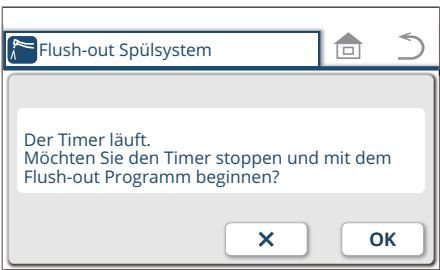


* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abzubrechen.

Drücken Sie , um die Spülung zu starten.

6 Einstellen/Anpassen

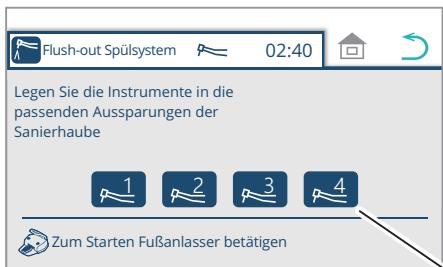


4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in einen Behälter, z. B. einen Eimer.

[Referenz] Handstücke/Spritze zum Spülen vorbereiten [Seite 190]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommenen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -SchHolder gedrückt wird.

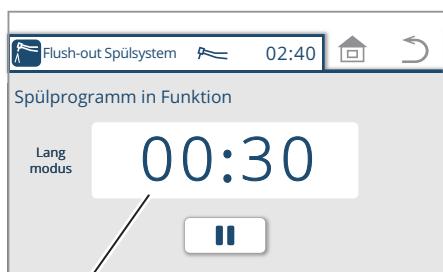

5. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, gibt das Handstück 2 Minuten und 40 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab.


Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der -SchHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -SchHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen SchHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

* Um den Spülvorgang fortzusetzen, drücken Sie den -SchHolder.

* Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den -/MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldschHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abzubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldschHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

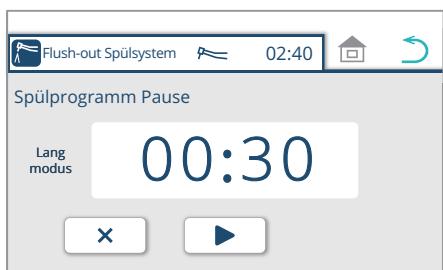


6. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.



* Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.


6 Einstellen/Anpassen

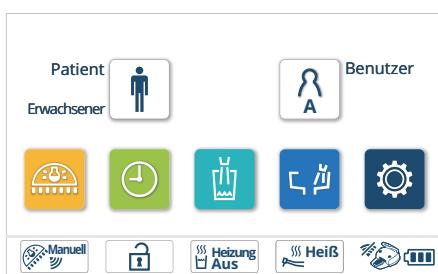

Timer-Einstellung der Spülung (Handstück)


1. Drücken Sie die Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

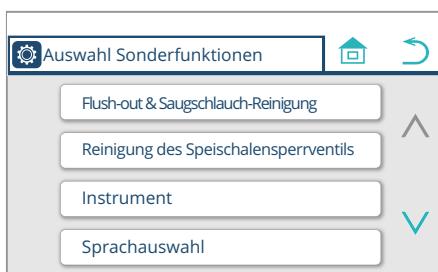


2. Drücken Sie den ScHolder, Spülen, Auswaschen der Absaugleitung!

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen 'Spülung' auf dem Bildschirm angezeigt.
Die unten aufgeführten Verfahren sind nicht anwendbar.



3. Drücken Sie den 'Spülung'-ScHolder.

* Drücken Sie den ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 192).

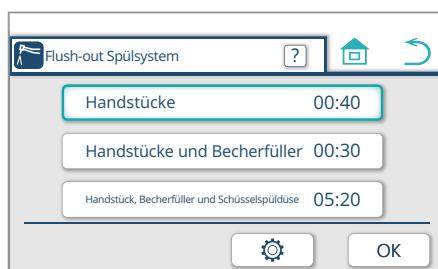


4. Drücken Sie den Spülmodus-Auswahlpunkt, um die Einstellungen zu ändern.

Drücken Sie Handstücke..

Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.

5. Drücken Sie den Timer-EinstellschHolder für die Spülung.
Der Bildschirm zum Ändern der Spülzeit wird angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen

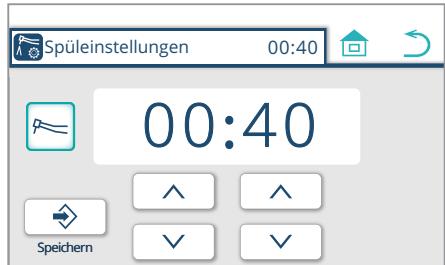

6. Timer-Einstellung des Handstückmodus ändern

(Beispiel) Änderung auf 2 min 30 s

Drücken Sie die ScHolder / um die Zeit in Schritten von 1 Minute


für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

: Eingestellte Zeit erhöhen

: Eingestellte Zeit verringern


Zeiteinstellbereich 00:40 bis 02:40

Die Werkseinstellung beträgt 40 Sekunden.

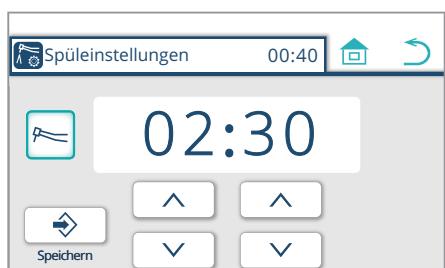


7. Drücken Sie die Speichertaste um die Einstellung zu speichern

Der Spülbildschirm in 4. erscheint.

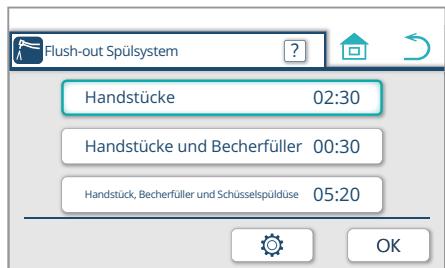


6 Einstellen/Anpassen

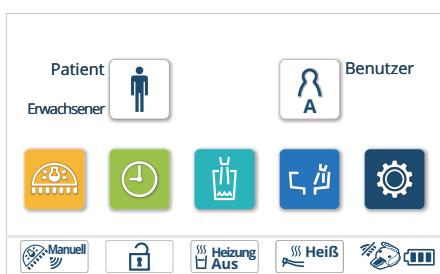

Timer-Einstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller)


1. Drücken Sie die Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

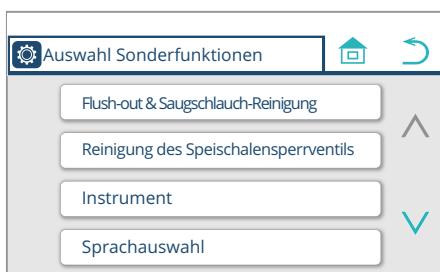


2. Drücken Sie den ScHolder, Spülen, Auswaschen der Absaugleitung!

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen 'Spülung' auf dem Bildschirm angezeigt.
Die unten aufgeführten Verfahren sind nicht anwendbar.

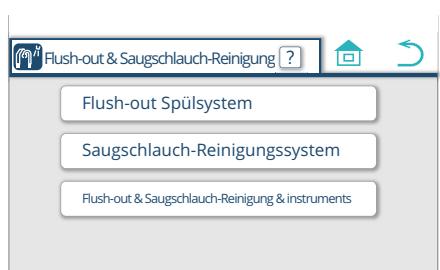

3. Drücken Sie den 'Spülung'-ScHolder.

* Drücken Sie den ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 192).

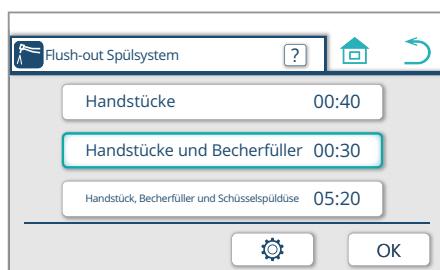

4. Drücken Sie den Spülmodus-Auswahlpunkt, um die Einstellungen zu ändern.

Drücken Sie Handstücke und Becherfüller.

Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.

5. Drücken Sie den Timer-EinstellschHolder für die Spülung.
Der Bildschirm zum Ändern der Spülzeit wird angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen



6. Timer-Einstellung des Handstückmodus ändern

(Beispiel) Änderung auf 30 s

Drücken Sie die ScHolder / um die Zeit in Schritten von 1 Minute

für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

: Eingestellte Zeit erhöhen

: Eingestellte Zeit verringern


Zeiteinstellbereich 00:20 bis 05:00

Die Werkseinstellung beträgt 20 Sekunden.



7. Drücken Sie die Taste für die Mundglasfüllung .

Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.

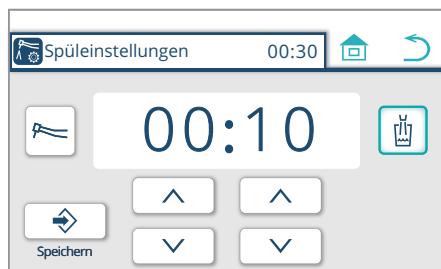

8. Timer-Einstellung des Becherfüllermodus ändern.

(Beispiel) Änderung auf 20 s

Drücken Sie die ScHolder / um die Zeit in Schritten von 1 Minute


für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

: Eingestellte Zeit erhöhen

: Eingestellte Zeit verringern


Zeiteinstellbereich 00:10 bis 05:00

Die Werkseinstellung beträgt 20 Sekunden.

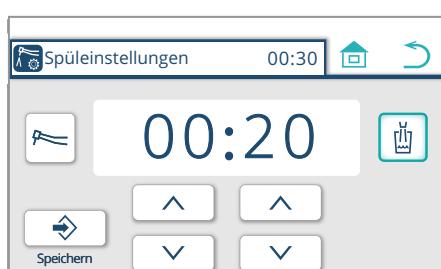


9. Drücken Sie die Speichertaste um die Einstellung zu speichern

Der Spülbildschirm in 4. erscheint.

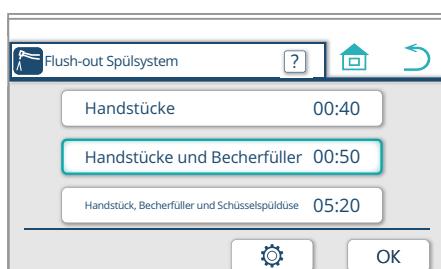


6 Einstellen/Anpassen

Timer-Einstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller + Speischale)




1. Drücken Sie die Funktionstaste . Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie den ScHolder, Spülen, Auswaschen der Absaugleitung!

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen 'Spülung' auf dem Bildschirm angezeigt.
Die unten aufgeführten Verfahren sind nicht anwendbar.



3. Drücken Sie den 'Spülung'-ScHolder.

* Drücken Sie den ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 192).

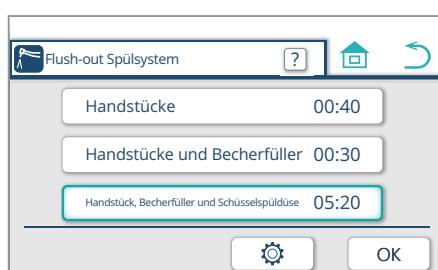


4. Drücken Sie den Spülmodus-AuswahlscHolder, um die Einstellungen zu ändern.

Drücken Sie Handstück, Becherfüller und Beckenspüldüse.
Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.

5. Drücken Sie den Timer-EinstellschHolder für die Spülung.
Der Bildschirm zum Ändern der Spülzeit wird angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen



6. Timer-Einstellung des Handstückmodus ändern

(Beispiel) Änderung auf 3 min

Drücken Sie die Schalter / um die Zeit in Schritten von 1 Minute


für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

: Eingestellte Zeit erhöhen

: Eingestellte Zeit verringern


Zeiteinstellbereich 02:40 bis 05:00

Die Werkseinstellung beträgt 2 Minuten 40 Sekunden.



7. Drücken Sie den Auswaschschalter für den Becherfüller, das Speischale..

Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.



8. Timer-Einstellung des Auswaschmodus für den Becherfüller, das Speischale.

(Beispiel) Änderung auf 3 min


Drücken Sie die Schalter / um die Zeit in Schritten von 1 Minute für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern.

: Eingestellte Zeit erhöhen


: Eingestellte Zeit verringern

Zeiteinstellbereich 02:40 bis 05:00


Die Werkseinstellung beträgt 2 Minuten 40 Sekunden.



9. Press Store Switch to save the setting The flushing screen in 4. appears.




6 Einstellen/Anpassen

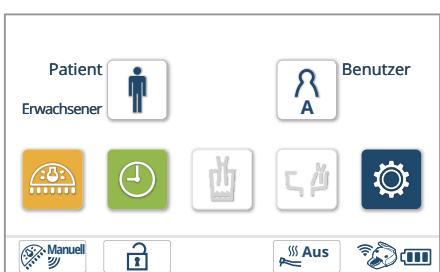


Timer-Einstellung der Spülung (Vac-Pac-Einheitstyp/Typ ohne Speischale)

1. Drücken Sie die Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

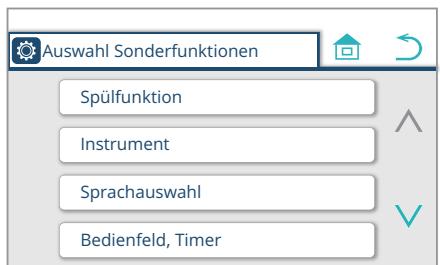

2. Drücken Sie den 'Spülung'-ScHolder.

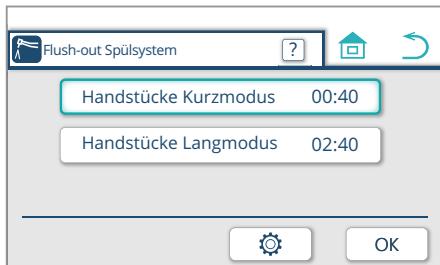


3. Drücken Sie den blinkenden Auswahlpunkt, um die Einstellungen zu ändern.
(Beispiel) Handstücke Kurzmodus drücken

Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige..

* Um die Erläuterung der Spülung (Ausführung ohne Speischale) anzuzeigen, drücken Sie den -ScHolder (siehe Seite 189).

4. Drücken Sie den Timer-Einstellschalter für die Spülung.
Der Bildschirm zum Ändern der Spülzeit wird angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen

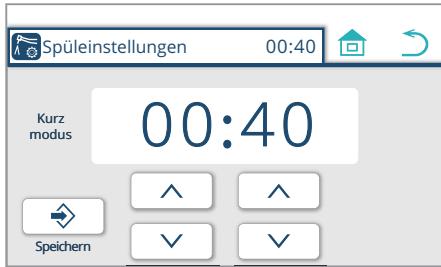

5. Timer-Einstellung ändern

(Beispiel) Änderung auf 50 s

Drücken Sie die Schalter / um die Zeit in Schritten von 1 Minute

für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

: Eingestellte Zeit erhöhen


: Eingestellte Zeit verringern

Zeiteinstellbereich

Kurzmodus 00:40 bis 02:40


Langmodus 02:40 bis 05:00

Die Werkseinstellung beträgt 40 Sekunden.

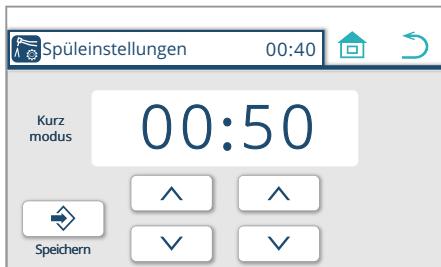


6. Drücken Sie die Speichertaste um die Einstellung zu speichern.


Der Spülbildschirm in 3. erscheint.

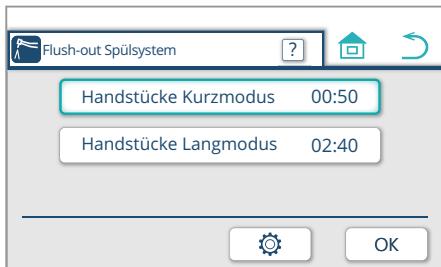


Erläuterung der Spülung (Ausführung mit Vac-Pac-Einheit/ohne Speischale)

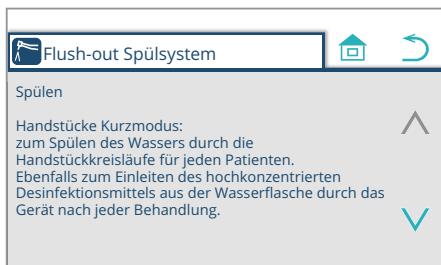

1. Drücken Sie den ScHolder
Gehen Sie zum Bildschirm in 2.
Die Erklärung von „Handstücke Langmodus“ der Spülung erscheint.




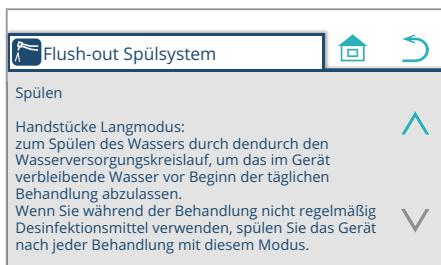


2. Drücken Sie den ScHolder
Kehren Sie zum Bildschirm in 1. zurück..
Die Erklärung von „Handstücke Kurzmodus“ der Spülung erscheint.

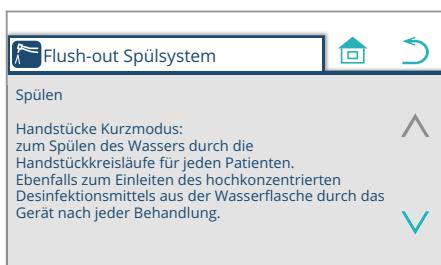

3. Drücken Sie den ScHolder
Kehren Sie zum Bildschirm in 3. auf Seite 187 zurück..

Handstücke/Spritze für das Spülen vorbereiten
Legen Sie die rechte Seite der Abnahmeposition in das Speischale.

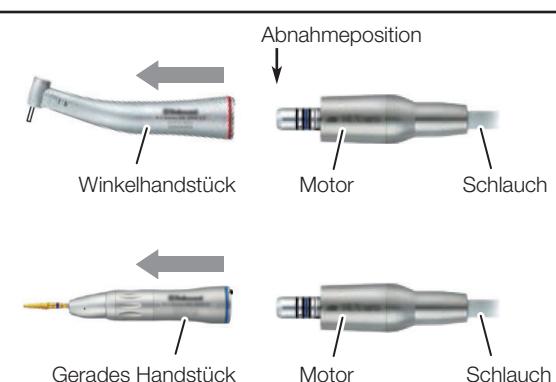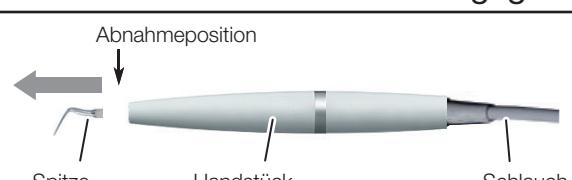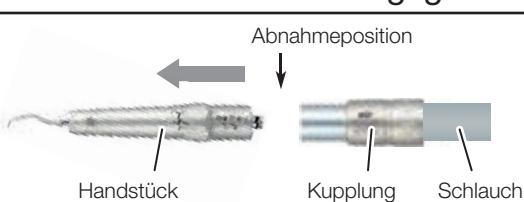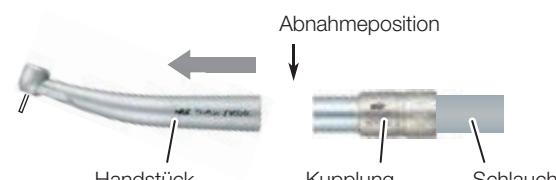Motor	Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät
	
	Luft-Zahnsteinentfernungsgerät
	
Luftturbine	Spritze
	

Wischen Sie das Handstück nach dem Spülen mit einem weichen Tuch ab, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Beim Aufnehmen des Handstücks nach dem Spülen kann verbleibende Luft ausgestoßen werden. Das ist normal.

6–2–3 Auswahl des Waschverfahrens für die Absaugleitung und Durchführung des Waschens

Absaugleitung einzeln auswaschen

Die folgenden drei Optionen stehen zur Verfügung: Spülen der Absaugleitung + Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel (siehe Seite 193), Spülen der Absaugleitung (siehe Seite 196) und Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel (siehe Seite 198).

Verwenden Sie eine der folgenden empfohlenen chemischen Reinigungslösungen.

Chemische Lösung: Orotol plus von Dürr

GREEN&CLEAN M2 von METASYS

GREEN&CLEAN CL N von METASYS

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

2. Drücken Sie den ScHolder ,Flush-out & Saugschlauch-Reinigung’.

3. Drücken Sie den ScHolder ,Saugschlauch-Reinigungssystem’.

* Drücken Sie den -ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 192).

* Wenn Sie ,Saugschlauch-Reinigungssystem’ auswählen, wird die verbleibende Menge des Reinigungsmittels geprüft. Wenn die Menge des Reinigungsmittels ausreichend ist, erscheint der in der Abbildung links dargestellte Bildschirm. Der Name der eingestellten chemischen Lösung wird angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie eine andere chemische Lösung verwenden wollen.

Orotol plus: Sowohl für Einzel- als auch Doppel-Absaugung

GREEN&CLEAN M2 1: Für Einzel-Absaugleitungen

GREEN&CLEAN M2 2: Für Doppel-Absaugleitungen





GREEN&CLEAN CL N 1: Für Einzel-Absaugleitungen

GREEN&CLEAN CL N 2: Für Doppel-Absaugleitungen


Wenn nicht genügend Reinigungsmittel vorhanden ist, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm. Füllen Sie Reinigungsmittel nach.

[Referenz] Reinigungsmittel nachfüllen [Seite 207]

Drücken Sie nach dem Nachfüllen des Reinigungsmittels den -ScHolder, um den Bildschirm ,Saugschlauch-Reinigungssystem’ anzuzeigen.

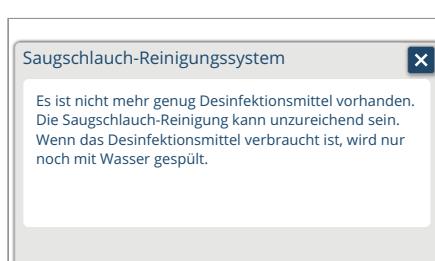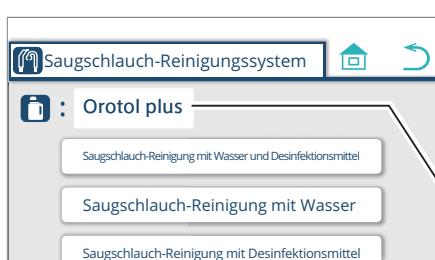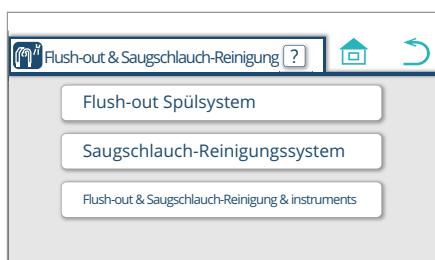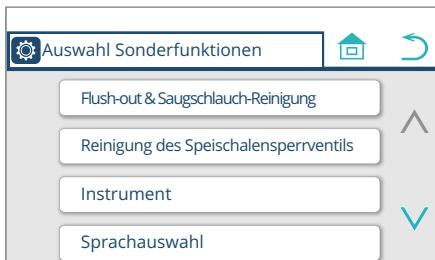

6 Einstellen/Anpassen

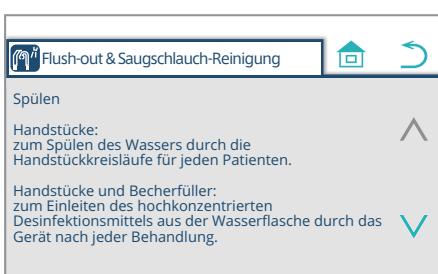


Erläuterung zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung

1. Drücken Sie den -ScHolder.

Die Anzeige wechselt zu Bildschirm 2.

Die Erklärung von „Handstücke, Becherfüller und Beckenspüldüse“ der Spülung erscheint.

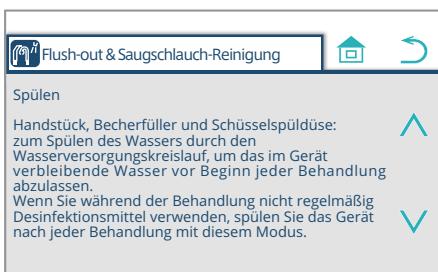


2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die Anzeige wechselt zu Bildschirm 3.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 3 zurück.


Der Bildschirm zeigt eine Erläuterung zum Auswaschen der Absaugleitung an; „Saugschlauch spülen und mit Reinigungsmittel auswaschen“ und „Spülen“.



3. Drücken Sie den -ScHolder.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 4 zurück.


Der Bildschirm zeigt eine Erläuterung zum Auswaschen der Absaugleitung an; „Auswaschen mit Reinigungsmittel“ und „Saugschlauch spülen und auswaschen“.

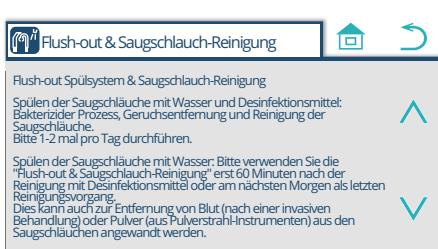

4. Drücken Sie den -ScHolder.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 3 zurück.


Der Bildschirm zeigt eine Erläuterung zum Auswaschen der Absaugleitung an; „Saugschlauch spülen und mit Reinigungsmittel auswaschen“ und „Spülen“.

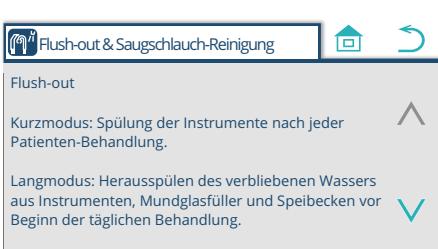

5. Drücken Sie den -ScHolder.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 2 zurück.

Die Erläuterung für „Handstück, Becherfüller und Beckenspüldüse“ der Spülung wird angezeigt.

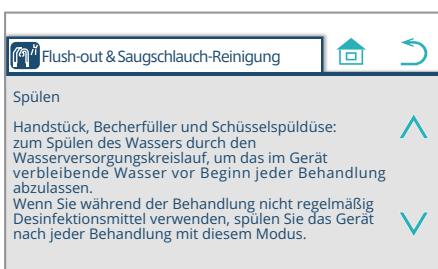

6. Drücken Sie den -ScHolder.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 3 zurück, der auf Seite 191 abgebildet ist.

Absaugleitung spülen + Absaugleitung mit Reinigungsmittel auswaschen



1. Drücken Sie den ScHolder ,Saugschlauch-Reinigung mit Wasser und Desinfektionsmittel'.

Der Name der eingestellten chemischen Lösung wird angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie eine andere chemische Lösung verwenden wollen.

- | | |
|---------------------------------|---|
| Orotol plus | Orotol plus: Sowohl für Einzel- als auch Doppel-Absaugung |
| GREEN & CLEAN M 2 1 | GREEN&CLEAN M2: Für Einzel-Absaugleitungen |
| GREEN & CLEAN M 2 2 | GREEN&CLEAN M2: Für Doppel-Absaugleitungen |
| GREEN & CLEAN CL N 1 | GREEN&CLEAN CL N: Für Einzel-Absaugleitungen |
| GREEN & CLEAN CL N 2 | GREEN&CLEAN CL N: Für Doppel-Absaugleitungen |



* Wenn nicht genügend Reinigungsmittel vorhanden ist, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm. Füllen Sie Reinigungsmittel nach.
[Referenz] Reinigungsmittel nachfüllen [Seite 207]

2. Spülen der Absaugleitung + Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel starten.

- ① Öffnen Sie die Abdeckung des Wartungs-Bedienfelds (oben) der Speischale-Einheit. Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder und setzen Sie sie in den Anschluss ein.

[Referenz] Verfahren für das Auswaschen mit Reinigungsmittel [Seite 208]
(Zu diesem Zeitpunkt ist das Absaugen nicht aktiviert.)

- ② Drücken Sie den -ScHolder.


* Bevor Sie den -ScHolder drücken, überzeugen Sie sich davon, dass das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Anschluss eingesetzt worden sind.




Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

* Um den laufenden Waschvorgang der Absaugleitung zu stoppen, drücken Sie den -ScHolder.

Welche Zeit angezeigt wird, hängt von der chemischen Reinigungslösung ab.

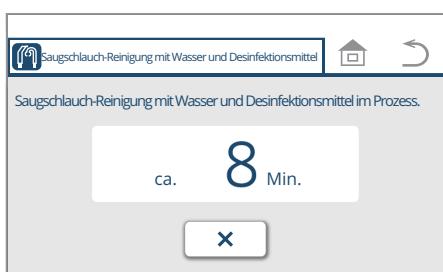

6 Einstellen/Anpassen

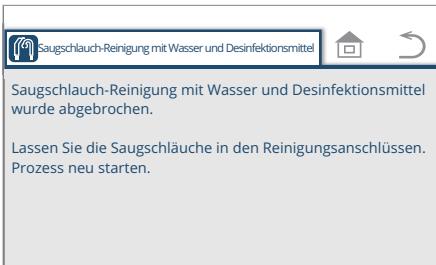

* Wenn der -ScHolder während des Waschvorgangs gedrückt wird, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm.

Wenn das Handschluss aus dem Anschluss genommen wird, während der links dargestellte Bildschirm angezeigt wird, bleibt Reinigungsmittel im Handstück und im Handstückschlauch zurück. Wenn das Reinigungsmittel stehen gelassen wird, kann es zu einem Bakterienwachstum kommen.



Drücken Sie den -ScHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.




3. Wenn Sie das Spülen der Absaugleitung + Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel beendet haben, drücken Sie den -ScHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

Nehmen Sie nach dem Start des Absaugvorgangs das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Anschluss heraus. Herabtropfen von Reinigungsmittel kann verhindert werden. Wenn Reinigungsmittel aus dem Anschluss tropft, wischen Sie es sofort auf. Stellen, an denen Reinigungsmittel haften bleibt, können sich verfärben.

6 Einstellen/Anpassen



z. B.


E44: Es ist nicht erkannt, dass sich
Wasser im Tank befindet

4. Ergreifen Sie beim Auftreten eines Fehlers geeignete Maßnahmen.

Wenn ein Fehler vor/beim/während des Auswaschens mit Reinigungsmittel/Spülen auftritt, wird das System zurückgesetzt und ein Fehlerbildschirm angezeigt.

„Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen“

Sehen Sie auf den Seiten 260 bis 262 nach und ergreifen Sie Maßnahmen gemäß den genannten Abhilfemaßnahmen.

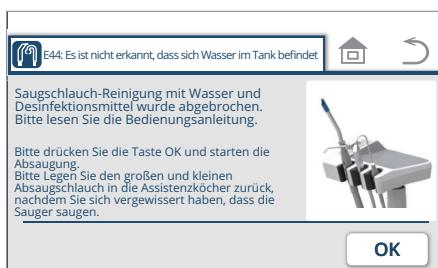

5. Drücken Sie den **OK** -ScHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein.

Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

Absaugleitung spülen



1. Drücken Sie den ScHolder ,Saugschlauch-Reinigungssystem'.

Der Name der eingestellten chemischen Lösung wird angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie eine andere chemische Lösung verwenden wollen.

- | | |
|----------------------|---|
| Orotol plus | Orotol plus: Sowohl für Einzel- als auch Doppel-Absaugung |
| GREEN & CLEAN M2 1 | GREEN & CLEAN M2: Für Einzel-Absaugleitungen |
| GREEN & CLEAN M2 2 | GREEN & CLEAN M2: Für Doppel-Absaugleitungen |
| GREEN & CLEAN CL N 1 | GREEN & CLEAN CL N: Für Einzel-Absaugleitungen |
| GREEN & CLEAN CL N 2 | GREEN & CLEAN CL N: Für Doppel-Absaugleitungen |

2. Starten Sie das Spülen der Absaugleitung.


① Öffnen Sie die Abdeckung des Wartungs-Bedienfelds (oben) der Speischale-Einheit. Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder und setzen Sie sie in den Anschluss ein.

[Referenz] Verfahren zum Auswaschen mit Reinigungsmittel [Seite 206]


② Drücken Sie den -ScHolder.

* Bevor Sie den -ScHolder drücken, überzeugen Sie sich davon, dass das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Anschluss eingesetzt worden sind.


Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

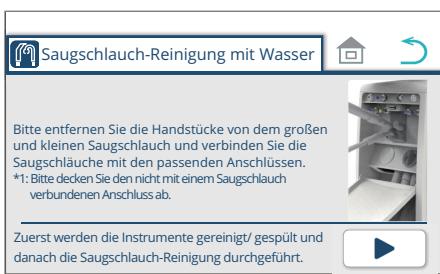

* Um den laufenden Waschvorgang der Absaugleitung zu stoppen, drücken Sie den -ScHolder.

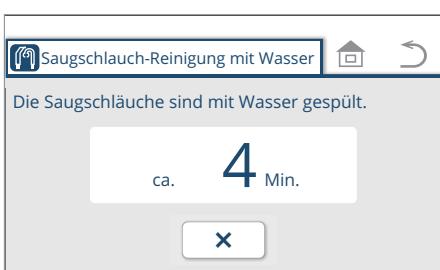


* Wenn der -ScHolder während des Waschvorgangs gedrückt wird, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm.

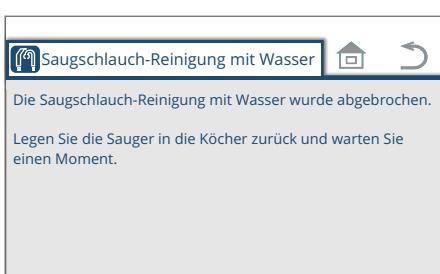

Drücken Sie den -ScHolder.

* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

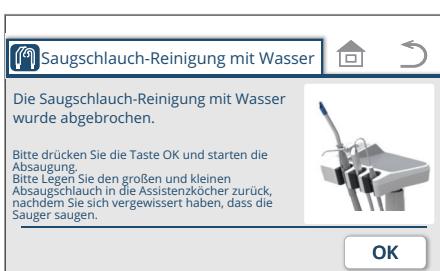

6 Einstellen/Anpassen




3. Wenn das Spülen der Absaugleitung abgeschlossen ist, drücken Sie den **OK**-ScHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

Nehmen Sie nach dem Start des Absaugvorgangs das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Anschluss heraus. Herabtropfen von Reinigungsmittel kann verhindert werden. Wenn Reinigungsmittel aus dem Anschluss tropft, wischen Sie es sofort auf. Stellen, an denen Reinigungsmittel haften bleibt, können sich verfärben.



z. B.

E44: Es ist nicht erkannt, dass sich Wasser im Tank befindet


4. Ergreifen Sie beim Auftreten eines Fehlers geeignete Maßnahmen.

Wenn ein Fehler vor/beim/während des Auswaschens mit Reinigungsmittel Spülen auftritt, wird das System zurückgesetzt und ein Fehlerbildschirm angezeigt.

„Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen“ Sehen Sie auf den Seiten 260 bis 262 nach und ergreifen Sie Maßnahmen gemäß den genannten Abhilfemaßnahmen.




5. Drücken Sie den **OK**-ScHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel

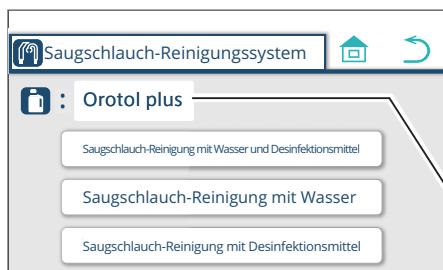

1. Drücken Sie den ScHolder ,Saugschlauch-Reinigung mit Wasser und Desinfektionsmittel'.

Der Name der eingestellten chemischen Lösung wird angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie eine andere chemische Lösung verwenden wollen.

- | | |
|--|---|
| Orotol plus
GREEN & CLEAN M2 1
GREEN & CLEAN M2 2
GREEN & CLEAN CL N 1
GREEN & CLEAN CL N 2 | Orotol plus: Sowohl für Einzel- als auch Doppel-Absaugung
GREEN&CLEAN M2: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN&CLEAN M2: Für Doppel-Absaugleitungen
GREEN&CLEAN CL N: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN&CLEAN CL N: Für Doppel-Absaugleitungen |
|--|---|



* Wenn nicht genügend Reinigungsmittel vorhanden ist, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm. Füllen Sie Reinigungsmittel nach.
 [Referenz] Reinigungsmittel nachfüllen [Seite 207]

2. Starten Sie das Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel.

- ① Öffnen Sie die Abdeckung des Wartungs-Bedienfelds (oben) der Speischale-Einheit. Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder und setzen Sie sie in den Anschluss ein.
 [Referenz] Verfahren für das Auswaschen mit Reinigungsmittel [Seite 206]
 (Zu diesem Zeitpunkt ist das Absaugen nicht aktiviert.)

- ② Drücken Sie den -ScHolder.


* Bevor Sie den -ScHolder drücken, überzeugen Sie sich davon, dass das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Anschluss eingesetzt worden sind.




Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

* Um den laufenden Waschvorgang der Absaugleitung zu stoppen, drücken Sie den -ScHolder.

Welche Zeit angezeigt wird, hängt von der chemischen Reinigungslösung ab.

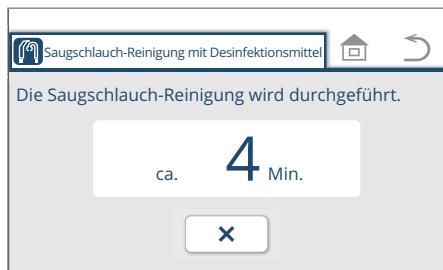

6 Einstellen/Anpassen

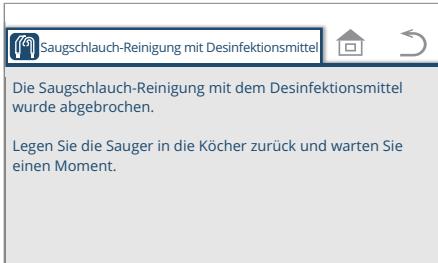

* Wenn der **X**-SchHolder während des Waschvorgangs gedrückt wird, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm.

Wenn das Handschlüssel aus dem Anschluss genommen wird, während der links dargestellte Bildschirm angezeigt wird, bleibt Reinigungsmittel im Handstück und im Handstückschlauch zurück. Wenn das Reinigungsmittel stehen gelassen wird, kann es zu einem Bakterienwachstum kommen.



Drücken Sie den **OK**-SchHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.




3. Wenn Sie das Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel beendet haben, drücken Sie den **OK**-SchHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

Nehmen Sie nach dem Start des Absaugvorgangs das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Anschluss heraus. Herabtropfen von Reinigungsmittel kann verhindert werden. Wenn Reinigungsmittel aus dem Anschluss tropft, wischen Sie es sofort auf. Stellen, an denen Reinigungsmittel haften bleibt, können sich verfärbten.

6 Einstellen/Anpassen

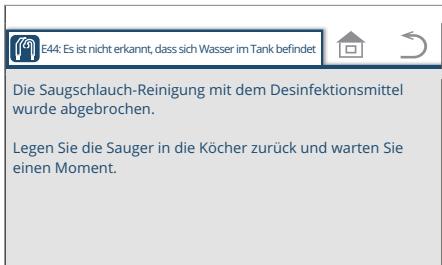


4. Ergreifen Sie beim Auftreten eines Fehlers geeignete Maßnahmen.

Wenn ein Fehler vor/beim/während des Auswaschens mit Reinigungsmittel/Spülen auftritt, wird das System zurückgesetzt und ein Fehlerbildschirm angezeigt.

„Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen“
Sehen Sie auf den Seiten 260 bis 262 nach und ergreifen Sie Maßnahmen gemäß den genannten Abhilfemaßnahmen.

z. B.

E44: Es ist nicht erkannt, dass sich
Wasser im Tank befindet

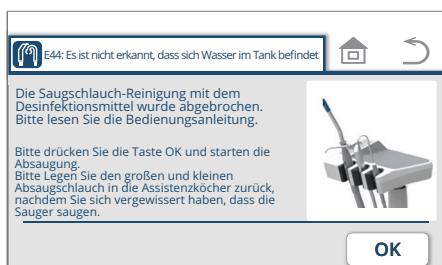


5. Drücken Sie den **OK** -ScHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein.
Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.


6 Einstellen/Anpassen

Absaugleitung entleeren und spülen




1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie den ScHolder 'Flush-out & Saugschlauch-Reinigung'.



3. Drücken Sie den ScHolder 'Flush-out & Saugschlauch-Reinigung'.

* Drücken Sie den -ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 192).



4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in das Speischale.

Die Nummer des aufgenommenen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

5. Drücken Sie den -ScHolder.

6 Einstellen/Anpassen



6. Öffnen Sie die Frontplatte der Speischale-Einheit. Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder und setzen Sie sie in den Anschluss ein.

Drücken Sie den -ScHolder.

Das Entleeren und Spülen der Absauleitung beginnt.

* Bevor Sie den -ScHolder drücken, überzeugen Sie sich davon, dass das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Anschluss eingesetzt worden sind.

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.



Es fließt 2 Minuten und 40 Sekunden lang Wasser aus dem Handstück.. Danach fließt 2 Minuten lang und 40 Sekunden Wasser aus der Becherfüllerdüse und der Beckenspüldüse.

Wenn kein Speischale vorhanden ist, startet das Spülen der Absauleitung 5 Minuten nach dem Entleeren der Wasserkreisläufe der Handstücke.

Wenn Sie das Spülen der Absauleitung unmittelbar nach der Entleerung der Wasserkreisläufe der Handstücke starten müssen, drücken Sie und anschließend .

Das Spülen der Absauleitung startet.

[Siehe Seite 196]


Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranscHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

* Um den Spülvorgang fortzusetzen, drücken Sie den -ScHolder.

* Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abzubrechen, drücken Sie /den MembranscHolder/Helferinnen-BedienfeldscHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abzubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranscHolder/Helferinnen-BedienfeldscHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

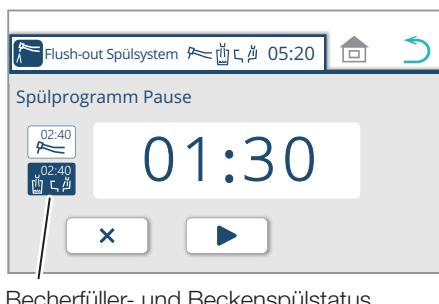


6 Einstellen/Anpassen




Drücken Sie den -ScHolder, um den Bildschirm in Schritt 6 anzuzeigen.

Um den in der linken Abbildung gezeigten Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie den -ScHolder.



Wenn das Entleeren abgeschlossen ist, startet das Spülen der Absaugleitung.

* Um den laufenden Spülvorgang der Absaugleitung zu stoppen, drücken Sie den -ScHolder.

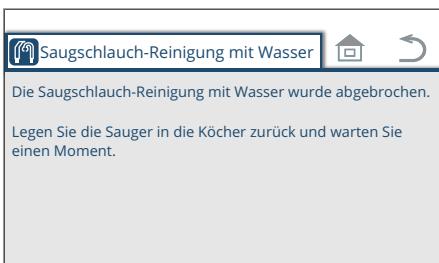


* Wenn der -ScHolder während des Spülvorgangs gedrückt wird, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm.



Drücken Sie den -ScHolder.

* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

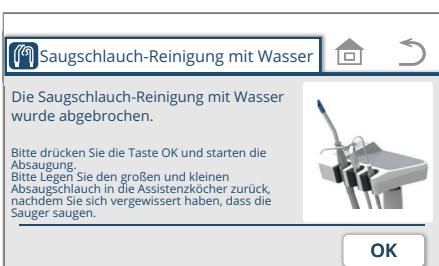

6 Einstellen/Anpassen




7. Wenn das Spülen der Absaugleitung abgeschlossen ist, setzen Sie die Handstücke für die Arzteinheit wieder in den InstrumentenHolder ein.

Wenn nach dem Entleeren die Handstücke in den InstrumentenHolder zurückgesetzt werden, während die Absaugleitung gespült wird, erscheint der links abgebildete Bildschirm nicht.

* Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste der Spritze 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.

Um den in der linken Abbildung gezeigten Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie den -SchHolder.

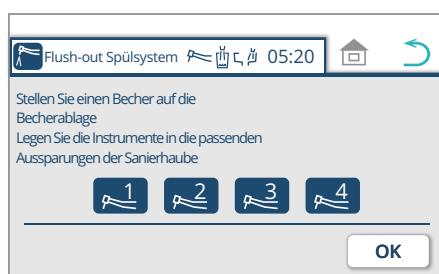

Drücken Sie den -SchHolder.

Der Bildschirm in Schritt 6 wird angezeigt.

Drücken Sie den -SchHolder, um den Bildschirm in Schritt 3 anzuzeigen.



8. Drücken Sie den -SchHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.


* Wenn die Handstücke für die Arzteinheit nach dem Absauger- und Kleiner Speichersauger-Handstück zurückgesetzt werden, erscheint anstelle des Bildschirms in Schritt 8 der Startbildschirm.

Nehmen Sie nach dem Start des Absaugvorgangs das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Anschluss heraus.

Herabtropfen von Reinigungsmittel kann verhindert werden.

Wenn Reinigungsmittel aus dem Anschluss tropft, wischen Sie es sofort auf. Stellen, an denen Reinigungsmittel haften bleibt, können sich verfärben.

6 Einstellen/Anpassen

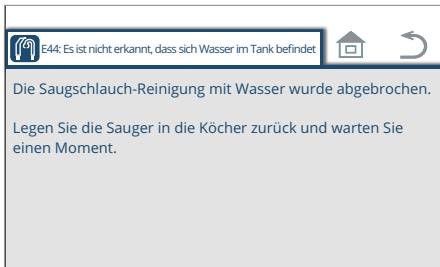

z. B.


E44: Es ist nicht erkannt, dass sich
Wasser im Tank befindet

9. Ergreifen Sie beim Auftreten eines Fehlers geeignete Maßnahmen.


Wenn ein Fehler vor/beim/während des Auswaschens mit Reinigungsmittel/Spülen auftritt, wird das System zurückgesetzt und ein Fehlerbildschirm angezeigt.

„Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen“

Sehen Sie auf den Seiten 260 bis 262 nach und ergreifen Sie Maßnahmen gemäß den genannten Abhilfemaßnahmen.

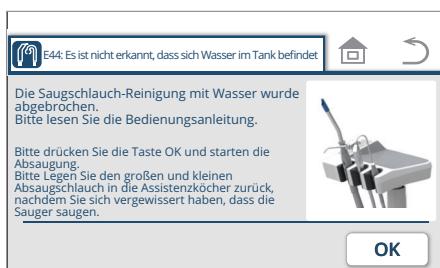

10. Drücken Sie den **OK** -ScHolder.

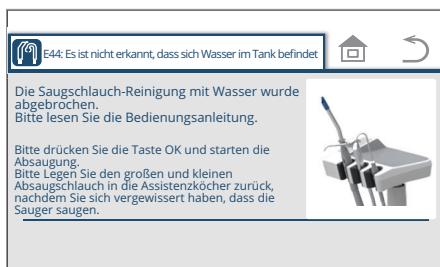


* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein.

Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

6 Einstellen/Anpassen

(1)

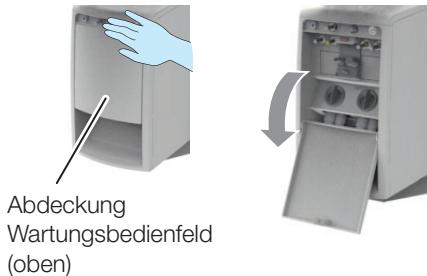

(3)



Feststoffsammler



Verfahren zum Auswaschen mit Reinigungsmittel

(1) Öffnen Sie die Abdeckung des Wartungs-Bedienfelds (oben) der Speischale-Einheit.

(2) Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder. Entfernen Sie die Spitzen vom Absaughandstück und Kleiner Speichersaugerhandstück.

(3) Setzen Sie (2) in den Anschluss ein.

Auf einen nicht genutzten Anschluss sollte eine Absaug-Anschlusskappe (im Folgenden „Anschlusskappe“) aufgesetzt werden.

Nehmen Sie die Anschlusskappe nicht von einem Anschluss ohne Funktion oder einem Anschluss ab, der nicht genutzt wird. Dadurch wird die Saugleistung vermindert und die Saugfähigkeit möglicherweise eingeschränkt. Die Anschlusskappe kann verloren gehen, wenn sie abgenommen wird.





* Entfernen Sie nicht den Feststoffsammler während des Waschvorgangs. Ohne den Feststoffsammler funktioniert die Absaugung nicht.

Wenn der Feststoffsammler während des Waschens entfernt wird, wird der Waschvorgang nicht durchgeführt und Wasser kann herausspritzen.

* Nehmen Sie während des Waschens das Handstück nicht aus dem Anschluss. Ein Fehler kann auftreten.

Das Auswaschen kann je nach Absaugkapazität des Maschinenraums mehr Zeit in Anspruch nehmen als angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen

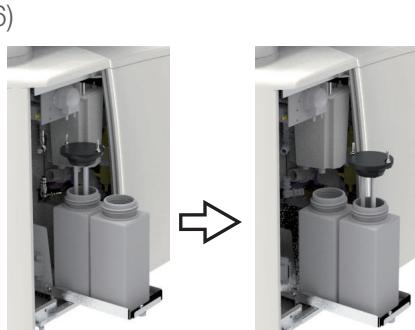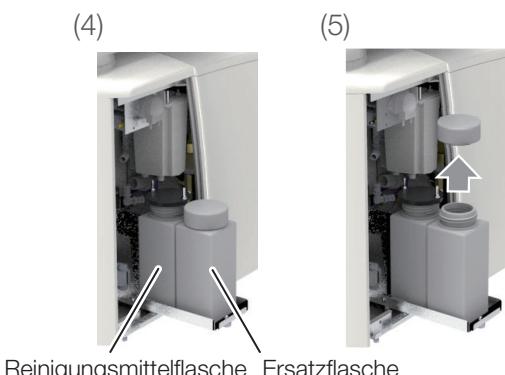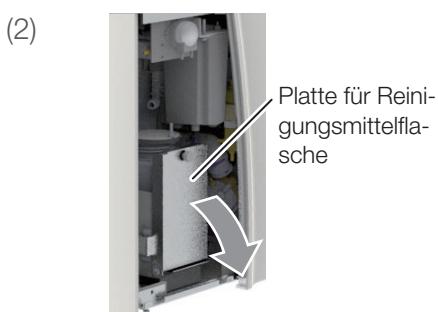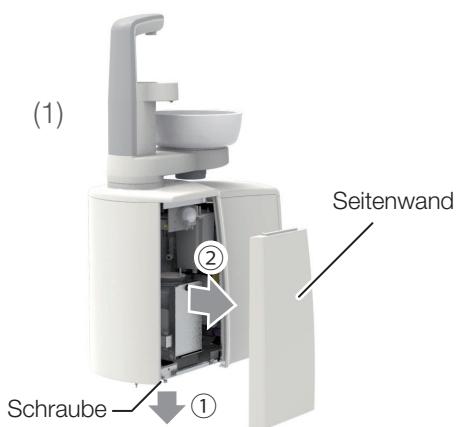

Reinigungsmittel nachfüllen

- (1) Öffnen Sie die Seitenwand der Speischale-Einheit.
 - ① Lösen Sie die Schraube.
 - ② Ziehen Sie die Seitenwand zu sich heran, um sie zu öffnen.
- (2) Ziehen Sie die Platte mit der Reinigungsmittelflasche nach unten zu sich heran.
- (3) Gießen Sie bis zu 500 ml Reinigungsmittel in die Ersatzflasche. Setzen Sie den Deckel auf die Flasche und bringen Sie die Flasche in die Nähe der Speischale-Einheit.
- (4) Schieben Sie die Reinigungsmittelflasche in Ihre Richtung. Setzen Sie die Reinigungsmittel- und Ersatzflasche nebeneinander ein.
- (5) Entfernen Sie den Deckel von der Ersatzflasche.
- (6) Entfernen Sie die Abdeckung von der Reinigungsmittelflasche, indem Sie sie langsam nach oben ziehen. Bringen Sie die Abdeckung an (5) an.
- (7) Bringen Sie (6) an die Stelle, an der sich die Flasche mit gebrauchtem Reinigungsmittel ursprünglich befunden hat.

Neben der Flasche in der Speischale-Einheit ist auch eine Ersatzflasche mit einem Deckel eingesetzt. Bewahren Sie sie in einem Lagerraum auf, wenn Sie die Reinigungsmittelflasche in der Speischale-Einheit gegen eine neue austauschen.

Verwenden Sie keine andere chemische Reinigungslösung als die, die bereits auf dem Display eingestellt ist. Die eingestellte chemische Reinigungslösung ist die aus unserer vorgegebenen Liste ausgewählte.


[Referenz] Von uns vorgegebene chemische Reinigungslösung [Seite 191]

Die Flasche hat ein Fassungsvermögen von 500 ml chemischer Reinigungslösung. Die Anzahl der Waschvorgänge hängt von der chemischen Reinigungslösung ab.

Setzen Sie den Deckel auf die verbleibende Flasche auf. Verwenden Sie die Flasche für den Austausch. Verwenden Sie das in der ausgetauschten Flasche verbleibende Reinigungsmittel beim nächsten Nachfüllen des Reinigungsmittels.


6–2–4 Antriebsluftdruck anzeigen

Den Antriebsluftdruck anzeigen.




1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie auf ‚Instrument‘.

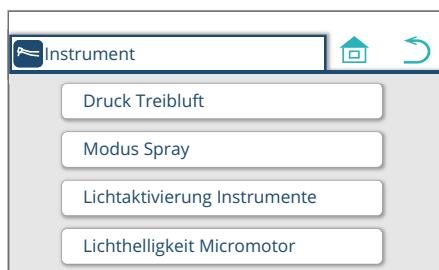

3. Drücken Sie auf ‚Druck Treibluft‘.

Der Antriebsluftdruck-Bildschirm wird angezeigt.



4. Nehmen Sie das Handstück aus dem InstrumentenHolder, dessen Druck Sie messen wollen.

5. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Der Luftdruck wird angezeigt.

Solange Sie mit dem Fuß auf dem Pedal des Fußanlassers stehen, wird durch Drücken von nicht der Startbildschirm aufgerufen; das Drücken von führt nicht zum vorigen Bildschirm zurück.

6. Legen Sie nach dem Prüfen des Drucks das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.


7. Drücken Sie den -ScHolder, um den Startbildschirm anzuzeigen.

6-2-5 Sprühmodus einstellen

Zweifach-Modus: Sprühen EIN/AUS

Vierfach-Modus: Luft und Wasser EIN/AUS

* Der Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät gibt immer Wasser ab, unabhängig vom Zweifach-Modus oder Vierfach-Modus.

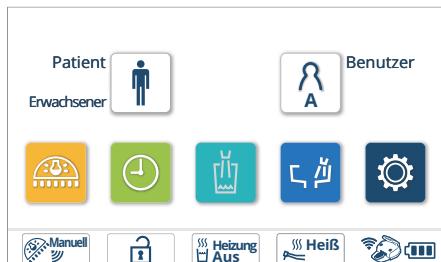


1. Drücken Sie den Funktionstaste ☰.

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie auf ‚Instrument‘.

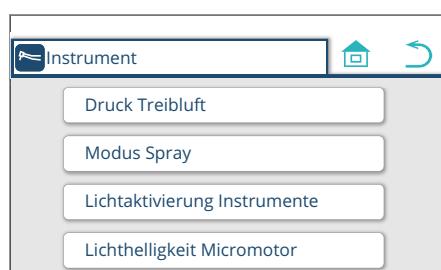

3. Drücken Sie auf ‚Modus Spray‘.

Der Einstellbildschirm für den Sprühmodus wird angezeigt.



4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie einstellen möchten.

5. Wählen Sie ‚Zweifach-Modus‘ oder ‚Vierfach-Modus‘ aus.

6. Drücken Sie ☰ OK, um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie ☰, ohne ☰ OK zu drücken.

7. Legen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

8. Drücken Sie den ☰-SchHolder, um den Startbildschirm anzuzeigen.

6-2-6 Aktivierungszeit der Licht/Leuchte einstellen

Es können zwei Arten der Licht/Leuchtenaktivierungszeit ausgewählt werden.
'Aktivierung beim Ziehen aus dem Köcher'

Schaltet die Licht/Leuchte beim Aufnehmen des Handstücks aus dem InstrumentenHolder ein und wieder aus, wenn es in den Holder zurückgesetzt wird.

* Wenn NO PAIN genutzt wird, schaltet sich die Licht/Leuchte aus, nachdem die Nachleuchtzeit abgelaufen ist.


'Aktivierung bei Betätigung des Fußanlassers'

Das Licht schaltet sich ein, wenn das Handstück aktiviert ist und aus, wenn die Nachleuchtzeit (ca. 5 Sekunden) nach der Deaktivierung des Handstücks abgelaufen ist.

* Wenn NO PAIN genutzt wird, schaltet sich die Licht/Leuchte aus, nachdem die Nachleuchtzeit abgelaufen ist.

* Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn die Einstellung der Nachleuchtzeit für das NEWTRON/VARIO170 geändert werden soll.

Die Einstellung der Nachleuchtzeit für NO PAIN kann nicht geändert werden.

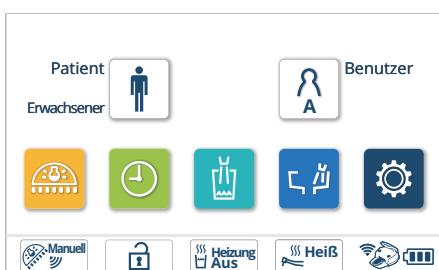


1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie auf 'Instrument'.

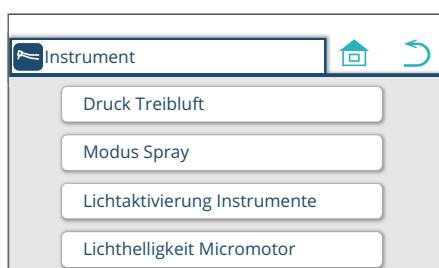

3. Drücken Sie auf 'Lichtaktivierung Instrumente'.

Der Einstellbildschirm für die Aktivierung der HandstückLicht/Leuchte erscheint.



4. Wählen Sie 'Aktivierung beim Ziehen aus dem Köcher' oder 'Aktivierung bei Betätigung des Fußanlassers'.

5. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne zu drücken.

6. Drücken Sie den -ScHolder, um den Startbildschirm anzuzeigen.


6-2-7 Mikromotor-Helligkeit einstellen

Die Helligkeit der HandstückLicht/Leuchte (Beleuchtungsstärke) kann geändert werden.


NLX plus

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie auf ‚Instrument‘.

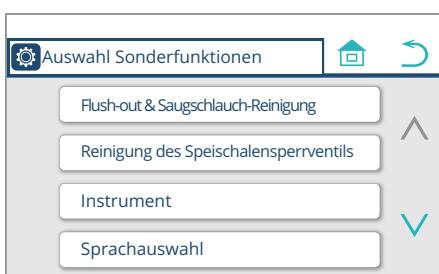

3. Drücken Sie ‚Lichthelligkeit Micromotor‘.

Der Einstellungsbildschirm für die Helligkeit der MikromotorLicht/Leuchte erscheint.



4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie einstellen wollen.

5. Drücken Sie die  

Achten Sie beim Einstellen der Helligkeit auf die tatsächliche Helligkeit.

* Es ist nicht erforderlich,  zu drücken, um diese Einstellung zu speichern. Sie wird gespeichert, wenn die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) eingestellt ist.

6. Drücken Sie den 

6 Einstellen/Anpassen




MX2/MCX

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie auf ‚Instrument‘.

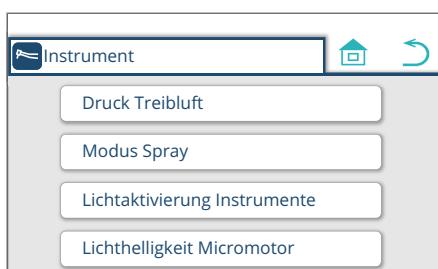

3. Drücken Sie ‚Lichthelligkeit Micromotor‘.

Der Einstellungsbildschirm für die Helligkeit der MikromotorLicht/Leuchte erscheint.

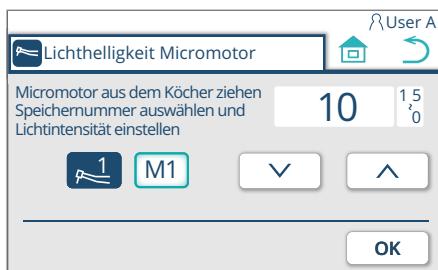

4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie einstellen möchten.

5. Drücken Sie den SpeicherschHolder , um [M1], [M2], [M3] oder [M4] auszuwählen. Diese vier SchHolder werden jedes Mal nacheinander angezeigt, wenn der SchHolder [M1] gedrückt wird.

6. Drücken Sie den -SchHolder, um die Helligkeit auf einen Wert zwischen [0] und [15] einzustellen. Die Helligkeit kann in Schritten von [1] eingestellt werden.

7. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern. Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne zu drücken.

8. Drücken Sie den -SchHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-8 Wasserstand des Becherfüllers einstellen


Bei der Auslieferung ab Werk wird der Wasserstand für den Becherfüller eingestellt, kann aber bei Bedarf angepasst werden.

Der Wasserstand des Becherfüllers und die Befülldauer bei Nutzung des Taste für Mundglasfüllungen (zwangswise Becherfüllen) können eingestellt werden.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

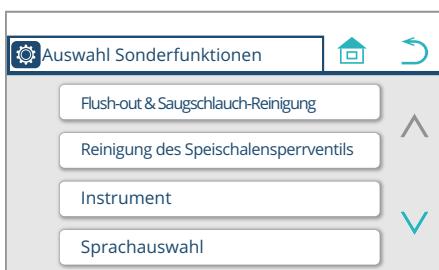

2. Drücken Sie den -SchHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.



3. Drücken Sie 'Becherfüller, Speischalenspülung'.




4. Drücken Sie 'Wassermenge Becherfüller'.

Der Einstellbildschirm für die Becherfüller-Wassermenge wird angezeigt.



5. Stellen Sie einen leeren Becher unter den Becherfüller und halten Sie den -SchHolder gedrückt, bis der Becher bis zum gewünschten Füllstand gefüllt ist.

* Es fließt Wasser, solange der -SchHolder gedrückt wird und es stoppt, wenn der losgelassen wird.

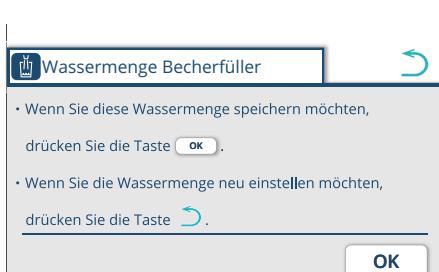

* Um den Wasserstand des Becherfüllers zu speichern, drücken Sie . Nach dem Drücken von wird der vorige Bildschirm wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie ohne zu drücken. Nach dem Drücken von wird der vorige Bildschirm wieder angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen

6. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Wenn der Wasserstand höher ist als gewünscht, führen Sie den Einstellvorgang erneut durch.


Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie  oder .

6–2–9 Synchronisation von Becherfüllung/ Beckenspülung einstellen

Die folgenden beiden Modi können ausgewählt werden:
,Synchron'


Die Spülung des Speischales startet gleichzeitig mit der Becherfüllung.
,Individuell'

Das Speischale wird nicht gespült, wenn die Becherfüllung gestartet wird.

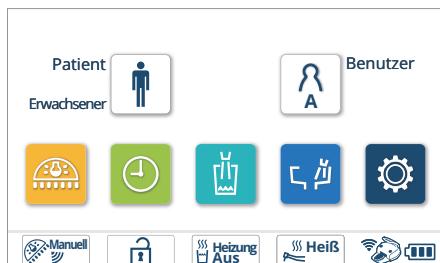

1. Drücken Sie den Funktionstaste ☰.

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

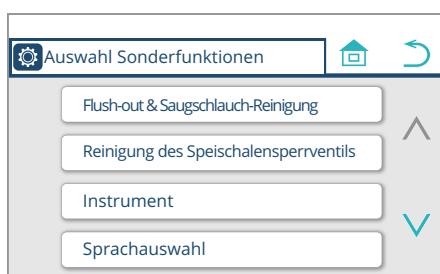

2. Drücken Sie den V-ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.




3. Drücken Sie ,Becherfüller, Speischalenspülung'.



4. Drücken Sie ,Synchronisation Becherfüller/Speischale'.

Der Bildschirm für die Kopplung von Becherfüllung und Beckenspülung erscheint.

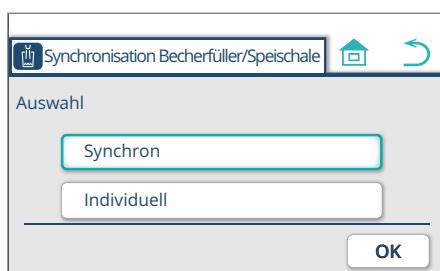

5. Wählen Sie ,Synchron' oder ,Individuell'.

6. Drücken Sie OK, um die Einstellung zu speichern.


Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie ↺, ohne OK zu drücken.

7. Drücken Sie den H-ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-10 Beckenspülzeit einstellen

Die Dauer der Beckenspülung kann eingestellt werden.

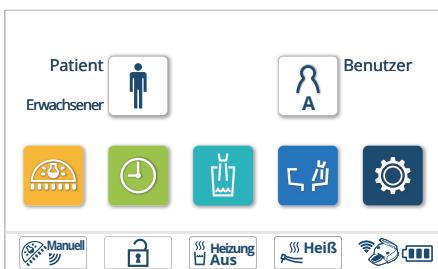

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.




3. Drücken Sie ‚Becherfüller, Speischalenspülung‘.



4. Drücken Sie ‚Dauer Speischalenspülung‘.

Der Einstellbildschirm für die Beckenspülzeit wird angezeigt.

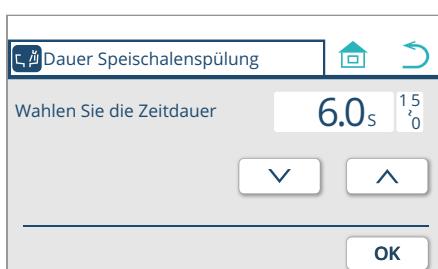

5. Drücken Sie die -Tasten, um eine Zeit zwischen [0] und [15] Sekunden einzustellen.

6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.


Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne zu drücken.

7. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-11 Sprache einstellen

Die auf dem Touchpanel angezeigte Sprache kann geändert werden.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie 'Sprachauswahl'.

Der Spracheinstellungsbildschirm wird angezeigt.



3. Drücken Sie den - - ScHolder, um Ihre Sprache auszuwählen.

4. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.


* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne zu drücken.

5. Drücken Sie den - ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6–2–12 Timer-Alarmton einstellen

Der Alarmton kann eingestellt werden, der ausgegeben wird, wenn der Timer Null erreicht.

Es stehen fünf Töne zur Verfügung und können eingestellt werden, um mehrere Stühle im selben Raum unterscheiden zu können.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie den -Schölder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.




3. Drücken Sie „Bedienfeld, Timer“.



4. Drücken Sie „Einstellung Timer-Alarm“.

Der Einstellungsbildschirm für die Auswahl des Timer-Alarms wird angezeigt.



5. Drücken Sie die -Schölder, um einen von fünf verschiedenen Tönen auszuwählen (, \downarrow 1' bis , \downarrow 5').

6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.


Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne zu drücken.

7. Drücken Sie den -Schölder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-13 Tastenlautstärke einstellen

Der Ton beim Drücken einer Taste kann eingestellt werden.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie den -Schalter.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.




3. Drücken Sie 'Bedienfeld, Timer'.



4. Drücken Sie die 'Tastenlautstärke'.

Der Einstellbildschirm für die Tastenlautstärke wird angezeigt.



5. Drücken Sie die Berührungs-Balkenleiste , um die Lautstärke in fünf Stufen einzustellen (,1' bis ,5').

Der -Schalter gibt den Klang des Tons wieder.

Der -Schalter schaltet den Ton stumm.

Um den Ton stummzuschalten, drücken Sie , und die Anzeige wechselt zu .

6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.


Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne zu drücken.

7. Drücken Sie den -Schalter, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6–2–14 Schlafmodus-Zeit einstellen

Wenn eine Zeit lang auf dem Bedienfeld keine ScHolder betätigt werden, wird der Touchpanel-Bildschirm dunkel und wechselt in den Schlafmodus. Die Zeit bis zum Wechseln in den Schlafmodus kann eingestellt werden.

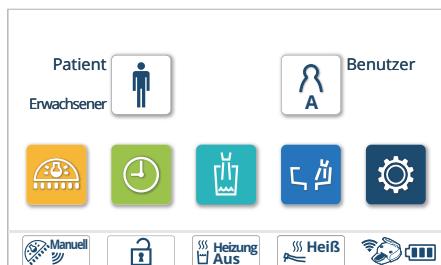

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.




3. Drücken Sie ‚Bedienfeld, Timer‘.

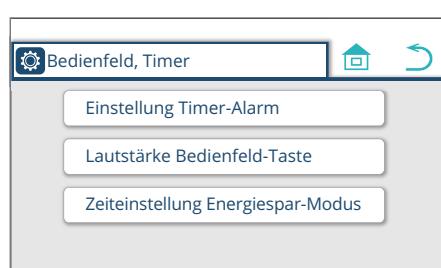

4. Drücken Sie ‚Zeiteinstellung Energiespar-Modus‘.

Der Einstellungsbildschirm für die Energiespar-Zeit (Schlafmodus) wird angezeigt.

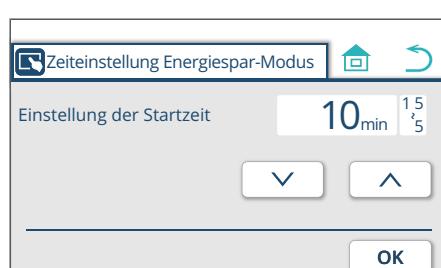

5. Drücken Sie die  -ScHolder, um eine von drei Zeiteinstellungen auszuwählen (,5 min‘, ,10 min‘ oder ,15 min‘).

6. Drücken Sie  , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie 


7. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

* Um den Schlafmodus aufzuheben berühren Sie den Bildschirm.

6-2-15 Notabschaltung der Stuhlverriegelung einstellen


Die Stuhlverriegelungsfunktion kann vorübergehend aufgehoben werden, wenn sie aktiviert ist.

Verwenden Sie diese vorübergehende Aufhebung, wenn die Stuhlverriegelungsfunktion deaktiviert werden muss, um einen Defekt zu beheben.

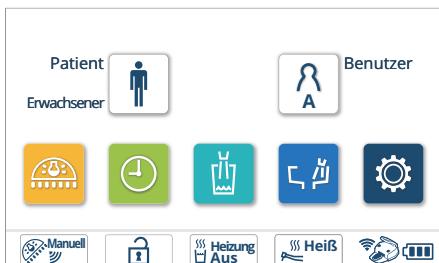

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.

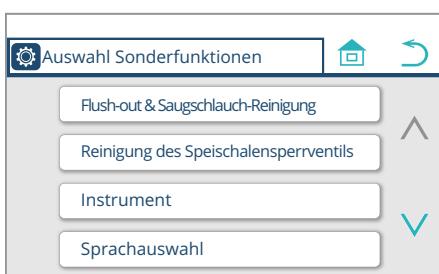

2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.



3. Drücken Sie 'Entriegelung Stuhlsperre'.

Der Einstellungsbildschirm für Notentsperrung der Stuhlverriegelung wird angezeigt.



4. Drücken Sie den -ScHolder, um die Stuhlverriegelung aufzuheben.

[Referenz] Stuhlverriegelungsfunktion [Seiten 112 bis 114]

5. Drücken Sie den -ScHolder, um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.


* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne zu drücken.

6. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

* Wenn der HauptscHolder ausgeschaltet wird, wird die Notentsperrung der Stuhlverriegelung deaktiviert und die Stuhlverriegelungsfunktion wieder aktiviert.

6–2–16 Anzeige der Programmversion

Die Programmversion jeder in der Einheit installierten Platine kann überprüft werden




1. Drücken Sie die Funktionstaste . Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie den ScHolder. Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.



3. Drücken Sie 'Programmversion'. Der Bildschirm zur Überprüfung der Programmversion erscheint.



4. Überprüfen Sie die Programmversion
(Beispiel) LCD-Hauptversion ist TB220514

AUSWEIS : TB2205

Wesentlich: 1

Voll: 1.4


Drücken Sie den ScHolder, um zur 2. Seite zu gelangen.



Drücken Sie den ScHolder, um zur 1. Seite zurückzukehren

5. Drücken Sie den ScHolder, um den Startbildschirm anzuzeigen

6-3 Von der Arzteinheit zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen

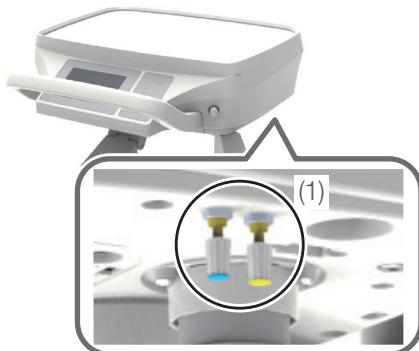

Zur Spritze zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen


Die Menge an Wasser und Luft, die von der Arzteinheit zugeführt wird, kann mit den Knöpfen (1) eingestellt werden.

Blaue Kappe (W-Seite): Zugeführte Wassermenge
Gelbe Kappe (A-Seite): Zugeführte Luftmenge



Dem Handstück zugeführte Wassermenge einstellen

Die Wassermenge, die dem Handstück zum Sprühen von der Arzteinheit zugeführt wird, kann mit den Knöpfen (2) eingestellt werden (mit blauer Kappe).

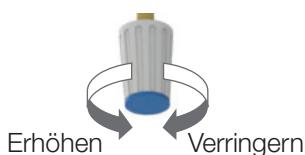

Alle Knöpfe verringern die Durchflussmenge, wenn sie im Uhrzeigersinn gedreht werden, und erhöhen sie, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Drehen Sie den Einstellknopf nicht zu fest zu. Er dient zur Erhöhung oder Verminderung des Durchflusses und ist kein Absperrventil. Bedenken Sie, dass er leer dreht, wenn Sie ihn zu fest zudrehen.

* Die Beziehung zwischen einem Holder und seinem Einstellknopf (2) hängt von der Position der Spritze ab.

(Siehe die Abbildung links) Bedienen Sie das System und beachten Sie den Zusammenhang zwischen den Einstellknopfnummern und dem Handstück.

Holder




PlaceHolder



Spritze	1	2	3	4
1	2	3	4	Spritze

6-4 Zur Mundspüleinheit zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen

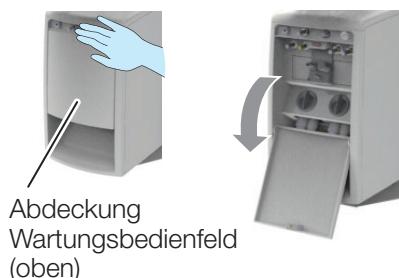

Abdeckung Wartungsbedienfeld

Drücken Sie auf die Abdeckung des Wartungsbedienfelds (oben), um es zu öffnen.



(1) Wasserzufuhrregler für die Spritze

Stellen Sie die Wassermenge ein, die der Spritze zugeführt wird.

(2) Luftzufuhrregler für die Spritze

Stellen Sie die Luftmenge ein, die der Spritze zugeführt wird.

(3) Wasserzufuhrregler für den Wasserversorgungsanschluss

Stellen Sie die Wassermenge ein, die vom Wasserwirtschaftsanschluss zugeführt wird.

(4) Einstellknopf für die Beckenspülung


(5) Einstellknopf für den Becherfüller *

* Die Knöpfe (5) sind für die Wartung vorgesehen.

Sie sind bereits so eingestellt, dass bei der Installation die optimale Wasserversorgung gewährleistet ist.

Bei Bedarf kann der Wasserstand angepasst werden.

[Referenz] Wasserstand des Becherfüllers festlegen [Seite 213]

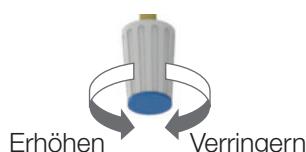

Alle Knöpfe verringern die Durchflussmenge, wenn sie im Uhrzeigersinn gedreht werden, und erhöhen sie, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Drehen Sie den Einstellknopf nicht zu fest zu. Er dient zur Erhöhung oder Verminderung des Durchflusses und ist kein Absperrventil. Bedenken Sie, dass er leer dreht, wenn Sie ihn zu fest zudrehen.

7-1 Äußeres

7-1-1 Reinigung und Desinfektion der Oberflächen

Wischen Sie die Oberflächen (außer dem Touchpanel) mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit FD366 von Dürr befeuchtet haben, um das Äußere des Produktes zu reinigen und zu desinfizieren, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn das Äußere stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % eines neutralen Reinigungsmittels enthält, und wischen Sie es mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.

VORSICHT

Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion des Touchpanels Ethanol. Die Verwendung anderer Desinfektionsmittel kann zu fehlerhafter Funktion und zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie niemals eines der nachfolgend benannten Produkte: Flüchtige Chemikalien wie zum Beispiel Verdünnung, Butanol, Isopropylalkohol, Nagellackentferner, Kraftstoff oder Kerosin; saure, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel mit hoher Korrosivität (Povidon-Iod wie zum Beispiel Isodine, Natriumhypochlorit usw.); scheuernde Wachse oder Schwämme

Verwenden Sie keine Bürsten oder Schrubber zur Wartung. All dies kann Kratzer und/oder eingeriebenen Schmutz hinterlassen.

Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche verblieben ist, wischen Sie es sofort ab. Die Feuchtigkeit oder das Reinigungsmittel kann zur Verrostung oder einer Fehlfunktion der elektrischen Teile führen.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem Tuch trocken.


Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig abgetrocknet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

7-2 Stuhl

7-2-1 Leder

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD360 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

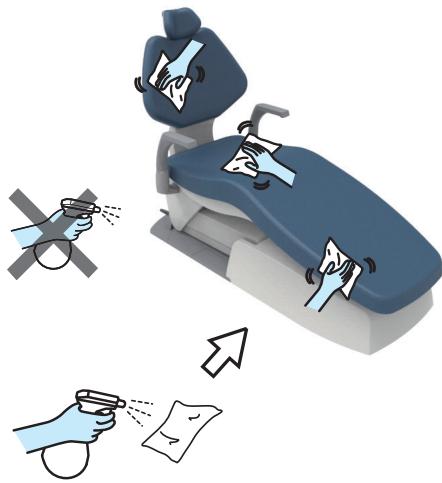

Wenn das Leder stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % eines neutralen Reinigungsmittels enthält, und wischen Sie es mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.



[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Kunstleder [Seite 41]

Verwenden Sie zur Reinigung des Leders keine organischen Lösungsmittel, Reinigungsmittel, die Scheuermittel enthalten, oder Bleichmittel. Alles das kann die Oberfläche verschlechtern und die Beschaffenheit oder den Glanz verändern.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Leder oder Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Die Flüssigkeit kann durch die Spalte in das Produkt eindringen und zu einer Fehlfunktion oder einem Versagen führen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig abgetrocknet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

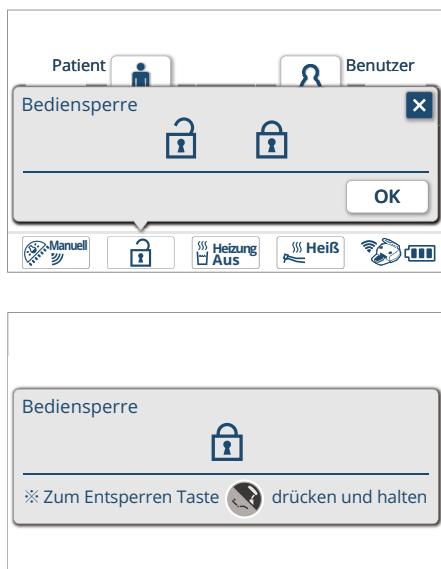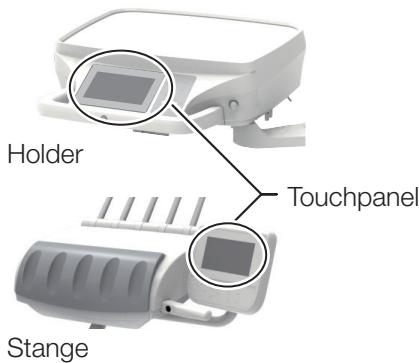

7-3 Arzteinheit

7-3-1 Touchpanel

Schalten Sie den HauptscHolder aus, um die versehentliche Betätigung eines ScHolders während der Reinigung oder Desinfektion zu verhindern.

Wenn Sie bei eingeschaltetem HauptscHolder Reinigungs- oder Desinfektionsarbeiten durchführen, sperren Sie das Touchpanel der Arzteinheit. (Beispiel) Reinigen der Oberfläche des Touchpanels während des Vorgangs.

1. Öffnen Sie den Bildschirm [Bediensperre] und drücken Sie **OK**. Das Touchpanel ist gesperrt.

Solange es gesperrt ist, wird ein Nebenfenster auf dem Touchpanel angezeigt, das auf den gesperrten Zustand hinweist.

2. Wischen Sie das Touchpanel mit einem weichen Tuch ab, das mit Reinigungsmittel befeuchtet ist.

3. Halten Sie den Stuhl-/ArmlehnenmembranscHolder  eine Sekunde oder länger gedrückt.

Dadurch wird das Touchpanel entsperrt.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere.

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen.

VORSICHT

Wischen Sie Wasser und Reinigungsmittel immer ab. Sonst kann es zu Funktionsstörungen, Defekten, und im Ergebnis zu Verletzungen kommen.

7-3-2 Silikonmatte/Handstückauflage

Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten. Oder wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab, das mit dem von Dürre hergestellten Desinfektionsmittel FD366 befeuchtet wurde.


Entfernen Sie vor der Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, ihn während des Vorgangs des Autoklavierens in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch und trocknen Sie natürlich.

Die wiederholte Sterilisierung im Autoklaven kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.


Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

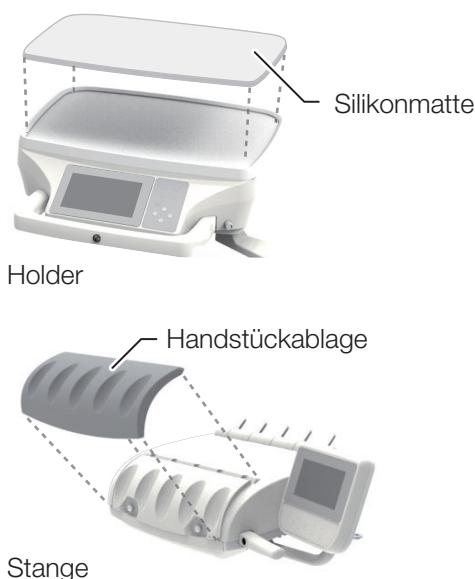


Holdertyp



Griffabdeckung

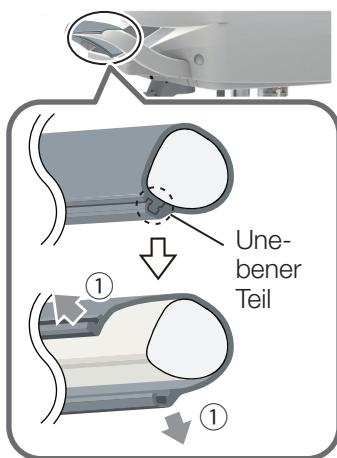

Stangentyp

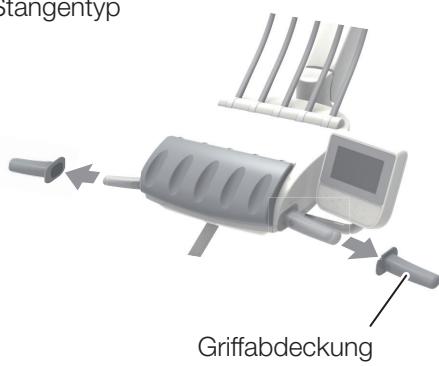

7-3-3 Griffabdeckung

Die Griffabdeckung ist für die Reinigung abnehmbar.

Wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist.

Die Griffabdeckung kann bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Entfernen Sie vor Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, sie während des Vorgangs der Sterilisierung in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

[Methode zum Abnehmen] Holderausführung

① Entfernen Sie zuerst den unebenen Teil am Rand der Griffabdeckung.

② Entfernen Sie die Griffabdeckung.

* Sie müssen Sie immer von Hand abnehmen.

[Wiederanbringen]

In der umgekehrten Reihenfolge des Abnehmens wieder anbringen.

* Richten Sie den unebenen Teil der Griffabdeckung aus und bringen Sie sie dann wieder an.



[Methode zum Abnehmen] Stangenausführung

Nehmen Sie die Griffabdeckung ab.

* Sie müssen Sie immer von Hand abnehmen.

[Wiederanbringen]

In der umgekehrten Reihenfolge des Abnehmens wieder anbringen.

* Richten Sie den unebenen Teil der Griffabdeckung aus und bringen Sie sie dann wieder an.


Die wiederholte Sterilisierung im Autoklaven kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

Sonst kann es zu einer Verformung oder Verfärbung kommen.

Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten

7-3-4 AbfallbehälterHolder

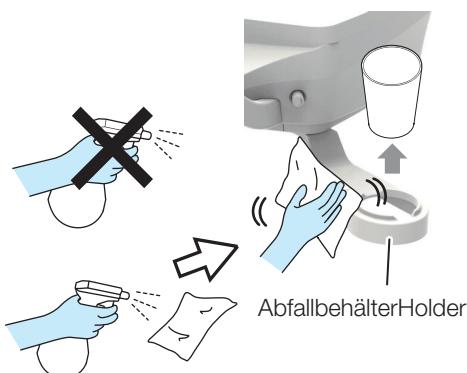

Wenn der Abfallbehälter voll ist, tauschen Sie den Papierbehälter für den AbfallbehälterHolder aus.

Wenn der Holder verschmutzt ist, wischen Sie ihn gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet wurde.

Holder



7-3-5 InstrumentenHolder


Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD366 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn die Außenseite stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % neutrales Reinigungsmittel enthält, und wischen Sie sie mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.

PlaceHolder



Stange

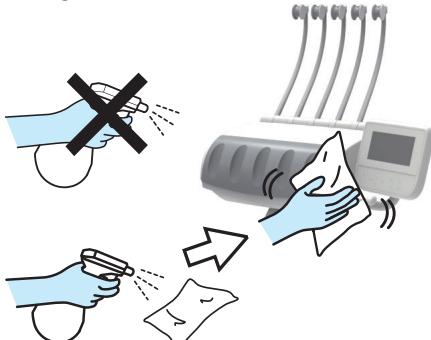

Verwenden Sie niemals eines der nachfolgend benannten Produkte: Flüchtige Chemikalien wie zum Beispiel Farbverdünner, Butanol, Isopropylalkohol, Nagellackentferner, Kraftstoff oder Kerosin; saure, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel mit hoher Korrosivität (Povidon-Iod wie zum Beispiel Isodine, Natriumhypochlorit usw.); scheuernde Wachse oder Schwämme


Verwenden Sie keine Bürsten oder Schrubber bei der Wartung. All dies kann Kratzer und/oder eingeriebenen Schmutz hinterlassen.

Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche verblieben ist, wischen Sie es sofort ab. Die Feuchtigkeit oder das Reinigungsmittel kann zur Verrostung oder einer Fehlfunktion der elektrischen Teile führen.


Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Leder oder Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Flüssigkeit durch Spalten in das Produkt eindringen kann, kann es zu einer Fehlfunktion oder einem Versagen kommen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig verdunstet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

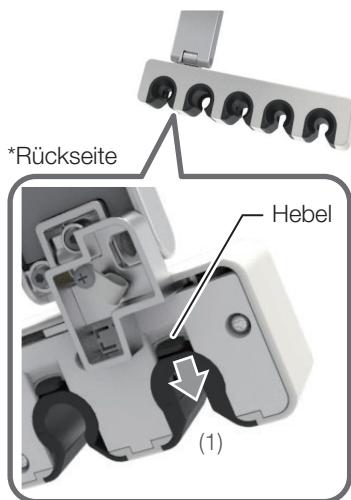

InstrumentenHolder

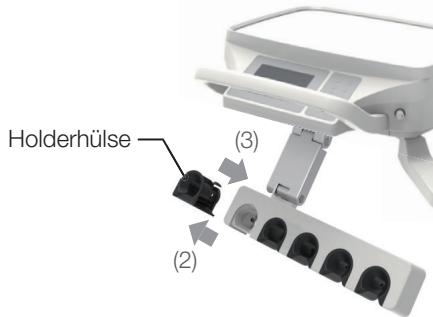

Holderhülse

Die Holderhülsen für den InstrumentenHolder können zur Reinigung abgenommen werden.

Wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürre befeuchtet ist.

Die Hülsen A1 bis A3 können bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Die Hülsen 1 bis 4 können nicht autoklaviert werden.

Entfernen Sie vor Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, sie während des Vorgangs der Sterilisierung in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

Informationen zur Hülsenummer der Handstück/Spritzen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

[Methode zum Abnehmen/Wiederanbringen]

1. Ziehen Sie den Hebel am Unterseite Teil der Holderhülse zu sich heran (1).

2. Drücken Sie die Holderhülse nach oben, während Sie am Hebel ziehen, um sie abzunehmen (2).

3. Um sie wieder anzubringen, schieben Sie sie von oben ein, bis sie hörbar einrastet (3).

Bei jeder Holderhülse steht die Nummer an der Unterseite und ein Aufkleber mit derselben Nummer befindet sich am InstrumentenHolder. Achten Sie darauf, die Holderhülse am Holder mit derselben Nummer anzubringen.

Achten Sie darauf, die Holderhülsen an den Holdern mit der entsprechenden Nummer anzubringen (an ihrer ursprünglichen Position), bis sie „einrasten“.

Wenn die Kombination nicht stimmt, funktioniert das Produkt nicht mehr richtig.

Die Hülsen 1 bis 4 dürfen nicht autoklaviert werden.

Eine Sterilisierung im Autoklav kann sie verformen oder zersetzen.

Die Hülsen A1 bis A3 können bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Die wiederholte Sterilisierung im Autoklav kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

Sonst kann es zu einer Verformung oder Verfärbung kommen.

Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

7 Wartung und Reinigung

Nichtsterile Ausführung

Hülsen-Nr.	Geeignetes Handstück/Spritze		
1	Spritze	BT14 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight)	
2	Spritze Luftturbine Luftmotor Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät Zahnsteinentfernungsgerät	SYR-20 3-WEGE Typ 77 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minimate) Luftturbine Luftmotor Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät	NSK VARIOS VS170
3	Mikromotor	NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano BIEN AIR MX2 (DMX3) BIEN AIR MCX Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät EMS NO PAIN Polymerisationslampe	SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON SATELEC MINI LED STD OEM
4	Spritze Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät LUX Zahnsteinentfernungsgerät Zahnsteinentfernungsgerät (TYP G139)	DCI 3439 3-WEGE NSK VARIOS VS170 DENTSPLY CAVITRON SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM	


Sterilisierbare Ausführung

Hülsen-Nr.	Geeignetes Handstück/Spritze		
A1	Spritze Luftturbine Luftmotor	SYR-20 3-WEGE Typ 77 3-WEGE Luftturbine Luftmotor	
A2	Spritze Mikromotor	BT14 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight) BIEN AIR MCX BIEN AIR MX2 (DMX3) NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät Zahnsteinentfernungsgerät	NSK VARIOS VS170 NSK VARIOS VS170 LUX SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN Polymerisationslampe
A3	Spritze	DCI 3439 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minimate) Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät CAVITRON Zahnsteinentfernungsgerät (TYP G139)	DENTSPLY SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM

PlaceHolder

Der obere Teil des PlaceHolders kann zur Reinigung abgenommen werden.

[Methode zum Abnehmen/Wiederanbringen]

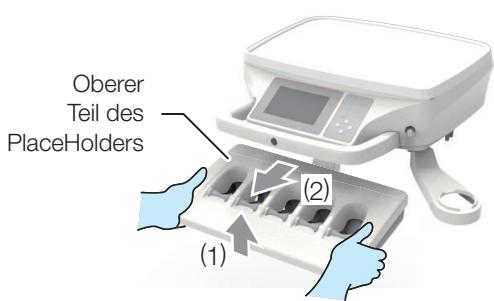

1. Halten Sie den oberen Teil des PlaceHolders mit beiden Händen fest und ziehen Sie ihn leicht nach oben. (1)

2. Ziehen Sie ihn zu sich heran und nehmen Sie ihn ab. (2)

3. Um ihn wieder anzubringen, führen Sie ihn von oben in seine Ausgangsposition ein. (3)



7-3-6 BT14 3-WEGE-Spritze

Waschen und Sterilisieren der Düse


Die Düse der BT14 ist abnehmbar und zur Reinigung und Sterilisierung im Autoklav geeignet.

[Innenreinigung der Düse]

Führen Sie das beiliegende Düsenreinigungswerkzeug von der Spitze her in die Düse ein. Reinigen Sie das Innere der Düse und entfernen Sie die Rückstände mit Wasser und Druckluft.

Wenn die Düse mit anhaftenden Rückständen in den Autoklaven kommt, verstopfen die Rückstände die Düse von innen und möglicherweise kann kein Wasser mehr austreten.

Vorgehensweise zum Abnehmen

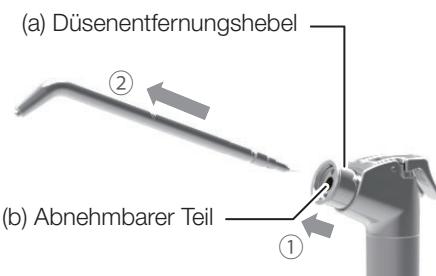

Anbringungsverfahren



Beispiel für Anbringung der Düse

Gutes Beispiel

Der Düsenentfernungshebel ist zurückgestellt.

*(a) und (b) sind in derselben Ebene



Schlechtes Beispiel



[Waschverfahren]

Waschen Sie die Düse mit den folgenden Verfahren.

1. Waschen Sie die Düse vorsichtig unter fließendem Wasser ab.
Leiten Sie das Wasser durch das Düseninnere.
2. Tauchen Sie die Düse in das etwa 25-fach mit Wasser verdünnte Desinfektionsmittel ID212 von Dürr ein und führen Sie mindestens 10 Minuten lang eine Ultraschallreinigung durch.
Die Innenseite der Düse muss von der Lösung bedeckt sein.
3. Waschen Sie die Düse nach der Ultraschallreinigung noch einmal sorgfältig unter fließendem Wasser ab.
Leiten Sie das Wasser durch das Düseninnere.

[Sterilisierungsverfahren]

Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten.

Achten Sie darauf, ihn während des Vorgangs des Autoklavierens in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

[Anbringungsverfahren]

1. Ziehen Sie am Hebel zum Abnehmen der Düse und setzen Sie die Düse ein, bis die Linie nicht mehr sichtbar ist (siehe Abbildung links).
2. Lassen Sie den Düsenabnahmehhebel los und ziehen Sie die Düse etwas heraus.
Sie rastet ein und ist verriegelt.
3. Nachdem die Düse angebracht ist, vergewissern Sie sich, dass sich nicht lösen kann, wenn Sie daran ziehen.
Befolgen Sie beim Einsetzen der Düse das Beispiel aus der Abbildung links und überprüfen Sie, ob die Düse sicher eingesetzt ist.

WARNUNG

Wird die BT14 mit nicht sicher angebrachter Düse verwendet, kann diese beim Spritzen von Wasser oder Luft abplatzen und die Benutzer oder andere Personen verletzen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Düse sicher angebracht ist.

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen, wenn Sie das Düsenreinigungswerkzeug benutzen, da die Spitze scharf ist.

Nur die Düse kann autoklaviert werden.

Zur Infektionsschutz wird eine Sterilisierung im Autoklaven zwischen den Behandlungen empfohlen.


Sterilisieren Sie die Düse ausschließlich im Autoklaven.
Autoklaviersterilisator gemäß Klasse B wird empfohlen.

Die Temperatur bei der Autoklav-Sterilisierung darf nicht höher sein als 135 °C.
Führen Sie keinen Trocknungsprozess durch
und trocknen Sie natürlich, wenn die Temperatur dabei 135 °C überschreiten kann.

Wenn Chemikalien oder Fremdkörper an der Düse haften, kann es zu einem Defekt oder Verfärbung kommen. Daher müssen die Reinigung und das Waschen vor der Autoklavierung durchgeführt werden.

Die Handstücke können bis zu 250 Mal autoklaviert werden.

Führen Sie zur Reinigung nicht die Interdentalzahnbürste oder ähnliche Gegenstände in den Düseneinsatz ein, wenn Sie die Düse abgenommen haben. Ein O-Ring (Dichtungsmaterial) ist an der Innenseite des Düseneinsatzes angebracht. Wenn er beschädigt wird, kann Wasser austreten

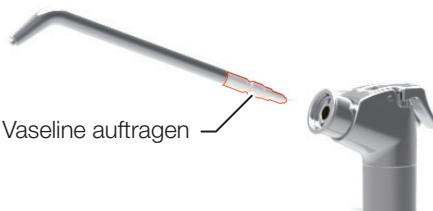


Auftragen von Vaseline auf die Düse

Häufiges Abnehmen der Düse verringert die Menge an Schmierfett für den O-Ring, was dazu führen kann, dass das Abnehmen schwierig wird. Wenn die Düse sich nur schwer abnehmen lässt, tragen Sie etwas Vaseline auf den Teil der Düse auf, der eingesetzt wird, wie in der Abbildung links gezeigt.

Spülen

Beim Ablassen des zurückbleibenden Wassers wird der beiliegende Ablass-Clip (im Folgenden 'Clip') dazu benutzt, dass das Wasser abfließen kann.

Wenn Sie die Spritze BT14 in die eingebaute Spülhülse einsetzen, wird der Clip nicht benötigt.

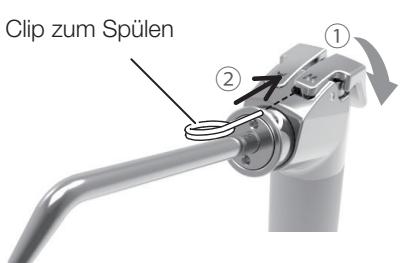

Nach dem Anbringen des Clips



[Vorgehensweise]

1. Richten Sie die Düse zum Speischale, drücken Sie den W-Hebel und lassen Sie das Wasser fließen. (①)
2. Führen Sie den Clip bei fließendem Wasser zwischen Gehäuse und Hebel ein, wie in der Abbildung links gezeigt (②), damit der W-Hebel weiter gedrückt wird.
3. Spülen Sie auch die anderen Handstücke, die zum Lieferumfang des Geräts gehören.
4. Entfernen Sie nach dem Spülen den Clip, indem Sie den W-Hebel drücken, und setzen Sie die Spritze zurück in den InstrumentenHolder.
Bewahren Sie den Clip sicher auf, um ihn nicht zu verlieren.

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen, wenn Sie den Clip zum Spülen benutzen, da die Spitze scharf ist.

7-3-7 SYR-20 3-WEGE-Spritze



Reinigung der Innenseite des Hebels

Wenn sich Staub oder Schmutz im Inneren des Hebels ansammelt, entfernen Sie diese mit einem Wattestäbchen.

Waschen und Sterilisieren der Düse


Waschen und sterilisieren Sie die Handstücke zwischen den verschiedenen Patienten.

Um die 3-Wege-Spritze ordnungsgemäß zu sterilisieren, muss sie zur Entfernung des Schmutzes gewaschen und in Reinigungsmittel eingetaucht werden.

Spülen Sie sie anschließend ab, um das restliche Reinigungsmittel zu entfernen.

Befolgen Sie das unten stehende Verfahren, um die Düse zu waschen und zu sterilisieren.

Zerlegen

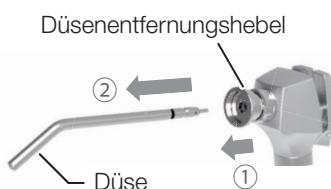

Zerlegen

Nehmen Sie die Düse auseinander, wie in der Abbildung gezeigt, um sie zum Waschen vorzubereiten. Ziehen Sie den Hebel zum Lösen der Düse ①, um die Düse zu entriegeln, die ② Düse kann dann abgenommen werden.

Waschen der Oberfläche

[Handwäsche]

Wischen Sie die oberflächlichen Kontaminierungen mit einem Tuch ab, und spülen Sie die Oberfläche mit sauberem, warmem Wasser bei 40 ± 5 Grad ab. Bürsten Sie die Spitze und den Anschlussteil der Düse mit einer Reinigungsbürste oder einer Zahnbürste unter laufendem sauberem, warmem Wasser bei 40 ± 5 Grad ab.

Überprüfen Sie, ob die Verschmutzung nach der Reinigung entfernt ist oder nicht. Fahren Sie mit der Reinigung fort, wenn noch Verschmutzungen vorhanden sind.

Eintauchen in eine alkalische Desinfektionslösung oder ein Reinigungsmittel für 5 Minuten.

(Wir empfehlen die Verwendung von ID212 von Dürr)

Gründlich mit destilliertem Wasser bei normaler Temperatur oder länger als 1 Minute mit sauberem Wasser nachspülen.

[Handwäsche/Ultraschallbad]

Reinigen Sie die Düse 30 Sekunden lang unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste und legen Sie sie in ein Ultraschallbad mit einem enzymatischen Reinigungsmittel, um oberflächliche Rückstände vor der Sterilisierung zu entfernen.

Wenn Schmutz verbleibt, wird die Düse nicht richtig sterilisiert.


VORSICHT

Waschen Sie die Düsen sofort nach Gebrauch.

Wenn Chemikalien oder Fremdkörper an der Düse haften, kann dies zu einer Fehlfunktion oder Verfärbung führen.

Daher müssen die Reinigung und das Waschen vor der Autoklavierung durchgeführt werden.

Wenn der Schmutz nicht entfernt werden kann, tauschen Sie die Düsen aus. Die Düse kann bis zu 250 Mal autoklaviert werden.

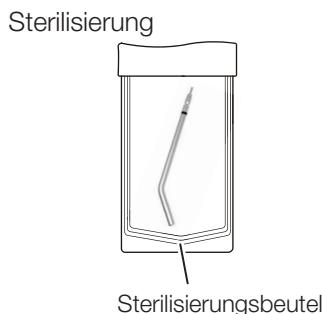


Düse anbringen



Beispiel für Anbringung der Düse Gutes Beispiel



Schlechtes Beispiel

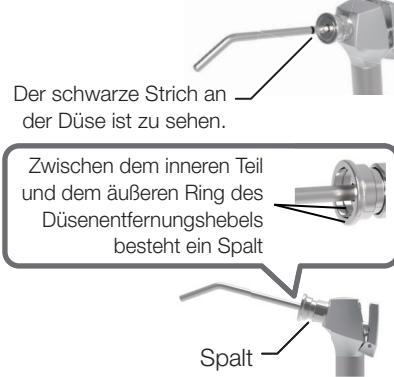

Sterilisierung

Wählen Sie die geeignete Methode aus den folgenden Sterilisierungszyklen, je nach Art des Autoklaviersterilisators in Ihrer Klinik:

[Dynamische Entlüftung]

1. Legen Sie die Düse in einen Sterilisationsbeutel und verschließen Sie die Öffnung.
2. Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten mit einer Trockenzeit von 15 Minuten.

[Schwerkraftverdrängung]

1. Legen Sie die Düse in einen Sterilisationsbeutel und verschließen Sie die Öffnung.
2. Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 132 °C für 15 Minuten mit einer Trockenzeit von 30 Minuten.

VORSICHT

Eine Sterilisierung muss nach jedem Einsatz an Patienten durchgeführt werden. Sterilisieren Sie die Düse ausschließlich im Autoklaven.

Autoklaviersterilisator gemäß Klasse B wird empfohlen.

Die Sterilisierungstemperatur beträgt 135 °C oder weniger.

Führen Sie keinen Trocknungsprozess aus und lassen Sie ihn natürlich trocknen, wenn der Trocknungsprozess bei mehr als 135 °C stattfinden würde.

Wenn der Sterilisationsbeutel beschädigt ist, entsorgen Sie ihn und führen Sie die Sterilisierung mit einem neuen Beutel erneut durch.

Lagerungsmethode

Bewahren Sie die Düse nach der Sterilisierung im Sterilisationsbeutel an einem dunklen, kühlen Ort auf.

Düse anbringen

Ziehen Sie am Hebel zum Entfernen der Düse ① setzen Sie die Düse ein, bis die schwarze Linie ② nicht mehr sichtbar ist (siehe Abbildung links).

Lassen Sie den Düsenabnahmehubel los und ③ ziehen Sie die Düse etwas heraus.

Sie rastet ein und ist verriegelt.

Nachdem die Düse angebracht ist, vergewissern Sie sich, dass sich nicht lösen kann, wenn Sie daran ziehen.

Befolgen Sie beim Einsetzen der Düse das Beispiel aus der Abbildung und überprüfen Sie, ob die Düse sicher eingesetzt ist.


WARNUNG

Wird die SYR-20 3-Wege-Spritze mit nicht sicher angebrachter Düse verwendet, kann diese beim Spritzen von Wasser oder Luft herausschießen und die Benutzer oder andere Personen verletzen.


Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Düse sicher angebracht ist.

7-3-8 Typ 77 3-WEGE-Spritze

Zerlegen

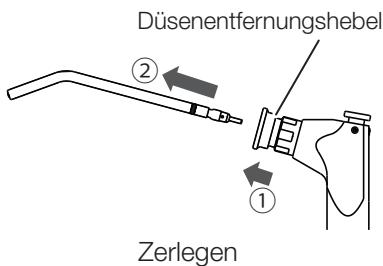

Zerlegen

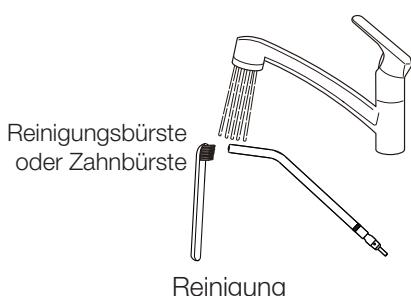

Reinigung

Waschen

Handwäsche

Wischen Sie die oberflächlichen Kontaminierungen mit einem Tuch ab, und spülen Sie die Oberfläche mit sauberem, warmem Wasser bei 40 ± 5 Grad ab. Bürsten Sie die Spitze und den Anschlusssteil der Düse mit einer Reinigungsbürste oder einer Zahnbürste unter laufendem sauberem, warmem Wasser bei 40 ± 5 Grad ab. Überprüfen Sie, ob die Verschmutzung nach der Reinigung entfernt ist oder nicht. Fahren Sie mit der Reinigung fort, wenn noch Verschmutzungen vorhanden sind. Eintauchen in eine alkalische Desinfektionslösung oder ein Reinigungsmittel für 5 Minuten.

(Wir empfehlen die Verwendung von ID212 von Dürr)

Gründlich mit destilliertem Wasser bei normaler Temperatur oder länger als 1 Minute mit sauberem Wasser nachspülen.

Handwäsche/Ultraschallbad

Reinigen Sie die Düse 30 Sekunden lang unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste und legen Sie sie in ein Ultraschallbad mit einem enzymatischen Reinigungsmittel, um oberflächliche Rückstände vor der Sterilisierung zu entfernen. Wenn Schmutz verbleibt, wird die Düse nicht richtig sterilisiert.


⚠️ VORSICHT

Eine Reinigung muss nach jedem Einsatz an Patienten durchgeführt werden.

Waschen Sie die Düsen sofort nach Gebrauch.

Wenn Chemikalien oder Fremdkörper an der Düse haften, kann dies zu einer Fehlfunktion oder Verfärbung führen. Daher müssen die Reinigung und das Waschen vor der Autoklavierung durchgeführt werden.

Wenn der Schmutz nicht entfernt werden kann, tauschen Sie die Düsen aus. Die Handstücke können bis zu 250 Mal autoklaviert werden.



Sterilisierungsbeutel

Sterilisierung

Sterilisierung

Wählen Sie die geeignete Methode aus den folgenden Sterilisierungszyklen, je nach Art des Autoklaviersterilisators in Ihrer Klinik:

[Dynamische Entlüftung]

1. Legen Sie die Düse in einen Sterilisierungsbeutel und verschließen Sie ihn.
2. Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten mit einer Trockenzeit von 15 Minuten.

[Schwerkraftverdrängung]

1. Legen Sie die Düse in einen Sterilisierungsbeutel und verschließen Sie ihn.
2. Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 132 °C für 15 Minuten mit einer Trockenzeit von 30 Minuten.

⚠️ VORSICHT


Eine Sterilisierung muss nach jedem Einsatz an Patienten durchgeführt werden.

Sterilisierung durch Klasse-B-Zyklen.

Die Sterilisierungstemperatur beträgt 135 °C oder weniger.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch und trocknen Sie natürlich, wenn die Temperatur 135 °C übersteigt.

Wenn der Sterilisierungsbeutel beschädigt wird, entsorgen Sie ihn und führen Sie die Sterilisierung mit einem neuen Beutel erneut durch.

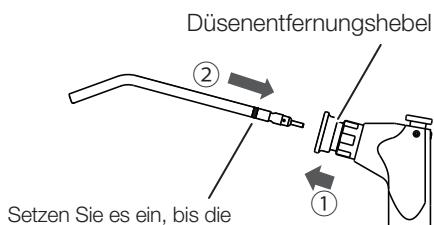

Setzen Sie es ein, bis die schwarze Linie unsichtbar ist.


Düse anbringen

Beispiel für Anbringung der Düse

Gutes Beispiel



Der schwarze Strich an der Düse ist nicht zu sehen.

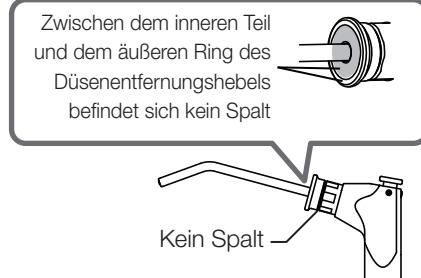


Kein Spalt

Schlechtes Beispiel



Der schwarze Strich an der Düse ist zu sehen.

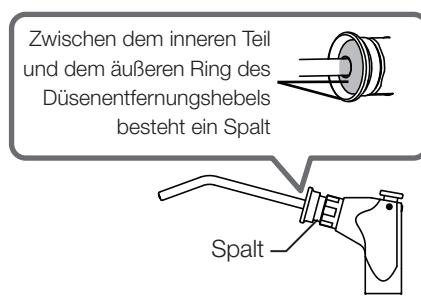

Spalt

Lagerung

Bewahren Sie die Düse nach der Sterilisierung im Sterilisierungsbeutel und an einem dunklen und kühlen Ort auf.

Düse anbringen

Ziehen Sie am Hebel zum Entfernen der Düse ① setzen Sie die Düse ein, bis die schwarze Linie ② nicht mehr sichtbar ist (siehe Abbildung links).

Lassen Sie den Düsenabnahmehobel los und ziehen Sie die Düse etwas heraus. Sie rastet ein und ist verriegelt.

Nachdem die Düse angebracht ist, vergewissern Sie sich, dass sich nicht lösen kann, wenn Sie daran ziehen.


Befolgen Sie beim Einsetzen der Düse das Beispiel aus der Abbildung und überprüfen Sie, ob die Düse sicher eingesetzt ist.

! **WARNUNG**

Wird eine 3-Wege-Spritze des Typs 77 mit nicht sicher angebrachter Düse verwendet, kann diese beim Spritzen von Wasser oder Luft herausschießen und die Benutzer oder andere Personen verletzen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Düse sicher angebracht ist.

7-3-9 Handstückschlauch

Wenn das Handstück verschmutzt wird, wischen Sie es gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist.

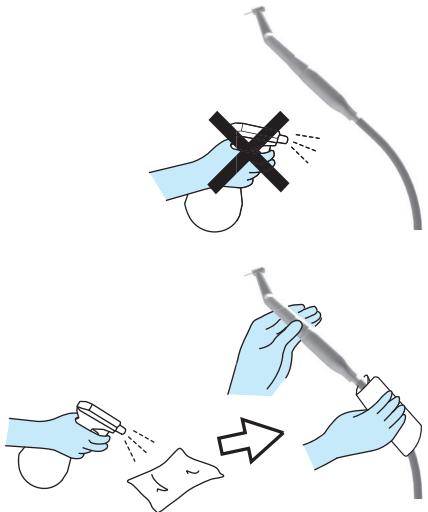

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere.

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig verdunstet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

7-3-10 Ölnebelabscheider


Dieses Bauteil sammelt das Öl aus der Abluft vom Handstück.

Wenn der Ölstand die Linie am Ölbehälter (1) erreicht, müssen Sie das Öl entsorgen.

Drehen Sie den Ölbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

Wenn der hygroskopische Schwamm (2) (Verbrauchsmaterial) stark verschmutzt ist oder zu viel Öl hat, ersetzen Sie ihn.

Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, um einen Ersatz für den hygroskopischen Schwamm zu erhalten. (Der Austausch erfolgt gegen Gebühr.)

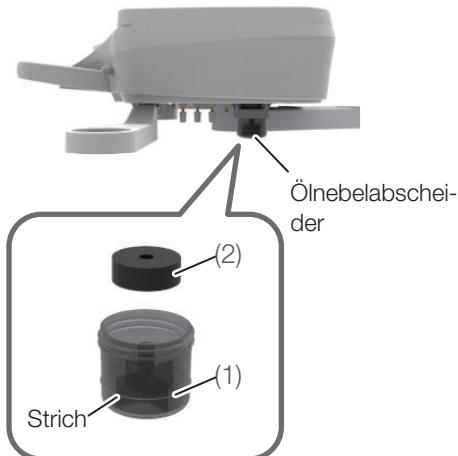

7-4 Mundspüleinheit

7-4-1 HelferinnenHolder

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD366 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn die Außenseite stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % neutrales Reinigungsmittel enthält, und wischen Sie sie mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.

Verwenden Sie niemals eines der nachfolgend benannten Produkte: Flüchtige Chemikalien wie zum Beispiel Farbverdünner, Butanol, Isopropylalkohol, Nagellackentferner, Kraftstoff oder Kerosin; saure, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel mit hoher Korrosivität (Povidon-Iod wie zum Beispiel Isodine, Natriumhypochlorit usw.); scheuernde Wachse oder Schwämme.

Verwenden Sie keine Bürste oder keinen Schrubber während der Wartung. All dies kann Kratzer und/oder eingeriebenen Schmutz hinterlassen.

Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche verblieben ist, wischen Sie es sofort ab. Verbleibende Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel können zu Rost oder dem Ausfall elektrischer Teile führen.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig verdunstet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Holderhülse

Die Holderhülsen für den InstrumentenHolder können zur Reinigung abgenommen werden.

Wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist.

Die Hülsen A1 bis A4 können bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.


Die Hülsen 1 bis 6 können nicht autoklaviert werden.

Entfernen Sie vor Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.


Achten Sie darauf, sie während des Vorgangs der Sterilisierung in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

Informationen zur Hülsennummer der Handstück/Spritzen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

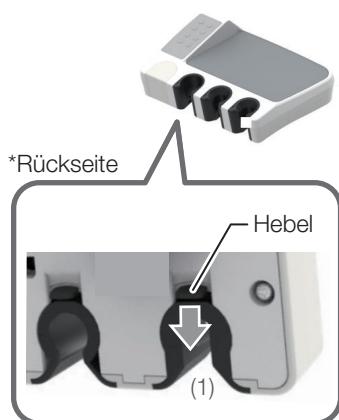

HelferinnenHolder

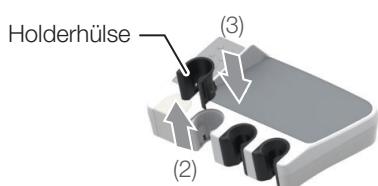

[Methode zum Abnehmen/Wiederanbringen]

1. Ziehen Sie den Hebel am Unterseite Teil der Holderhülse zu sich heran (1).
2. Drücken Sie die Holderhülse nach oben, während Sie am Hebel ziehen, um sie abzunehmen (2).
3. Um sie wieder anzubringen, schieben Sie sie von oben ein, bis sie hörbar einrastet (3).



Bei jeder Holderhülse steht die Nummer an der Unterseite und ein Aufkleber mit derselben Nummer befindet sich am Helferinnen-Holder.
Achten Sie darauf, die Holderhülse am Holder mit derselben Nummer anzubringen.

Achten Sie darauf, die Holderhülsen an den Holdern mit der entsprechenden Nummer anzubringen (an ihrer ursprünglichen Position), bis sie „einrasten“. Wenn die Kombination nicht stimmt, funktioniert das Produkt nicht mehr richtig.

Die Hülsen 1 bis 6 dürfen nicht autoklaviert werden.
Eine Sterilisierung im Autoklav kann sie verformen oder verfärben.

Die Hülsen A1 bis A4 können bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Die wiederholte Sterilisierung im Autoklaven kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

Sonst kann es zu einer Verformung oder Verfärbung kommen.

Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

Nichtsterile Ausführung

Hülsen-Nr.	Geeignetes Handstück/Spritze
1	Spritze BT14 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight)
2	Spritze SYR-20 3-WEGE Typ 77 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minimate)
3	Polymerisationslampe SATELEC MINI LED STD OEM
4	Spritze DCI 3439 3-WEGE Kleiner Speichersauger-Handstück Dürr
5	Saughandstück VH-18 Dürr
6	Kleiner Speichersauger-Handstück BT06

Sterilisierbare Ausführung

Hülsen-Nr.	Geeignetes Handstück/Spritze
A1	Spritze SYR-20 3-WEGE Typ 77 3-WEGE
A2	Spritze BT14 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight) Polymerisationslampe SATELEC MINI LED STD OEM
A3	Spritze DCI 3439 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minimate) Kleiner Speichersauger-Handstück Dürr
A4	Saughandstück VH-18 Dürr

7-4-2 Helferinnen-Schlauchklemme

Die Helferinnen-Schlauchklemme an der Helferinnen-Einheit kann vom Rahmen abgenommen werden, was die Reinigung erleichtert.

Wenn sie verschmutzt wird, wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet wurde.

[Methode zum Abnehmen]

(1) Entfernen Sie die Helferinnen-Schlauchklemme vom Rahmen.

* Sie müssen Sie immer von Hand abnehmen.


(2) Ziehen Sie den Schlauch von der Helferinnen-Schlauchklemme ab.

[Wiederanbringen]

In der umgekehrten Reihenfolge des Abnehmens wieder anbringen.

Autoklavieren Sie sie nicht.

Eine Sterilisierung im Autoklav kann sie verformen oder verfärben.

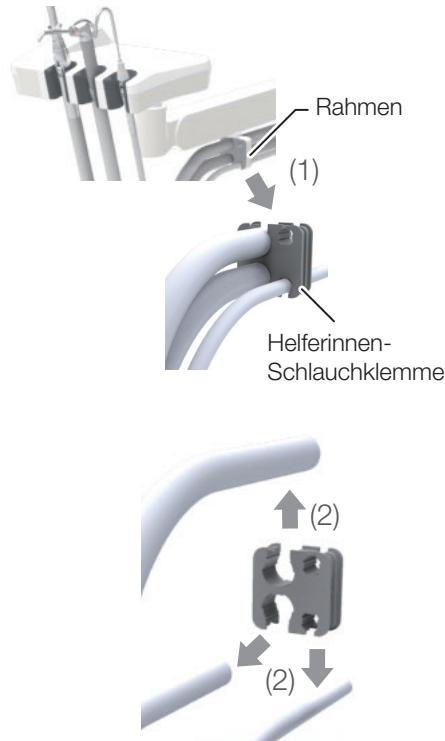

7-4-3 Helferinnen-Silikonmatte

Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten. Oder wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab, das mit dem von Dürr hergestellten Desinfektionsmittel FD366 befeuchtet wurde.


Entfernen Sie vor der Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, ihn während des Vorgangs des Autoklavierens in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch und trocknen Sie natürlich.


Die wiederholte Sterilisierung im Autoklav kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

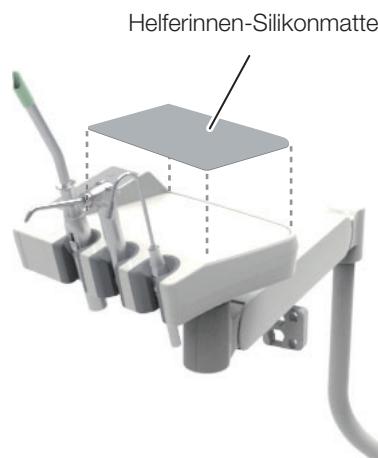


7-4-4 Saughandstück und Kleiner Speichersauger-Handstück waschen und sterilisieren

(1) Zerlegen

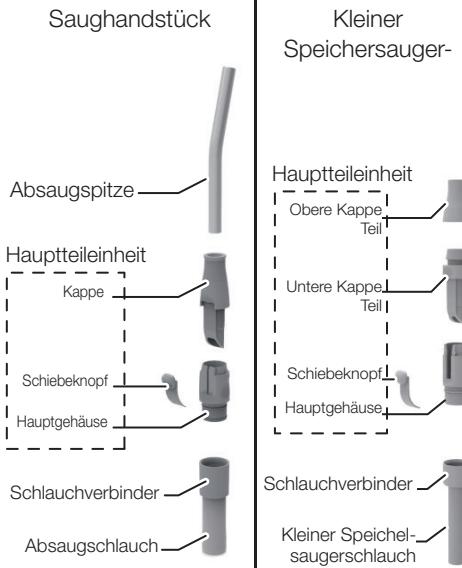


(2) Waschen der Oberfläche



(3) Waschen des Inneren und des Gleitteils



(4) Waschen von Teilen, die nicht mit einer Bürste zugänglich sind



Waschen und sterilisieren Sie die Handstücke zwischen den verschiedenen Patienten.

Um das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück ordnungsgemäß zu sterilisieren, müssen sie zur Entfernung des Schmutzes und in Reinigungsmittel eingetaucht werden.

Spülen Sie sie anschließend ab, um das restliche Reinigungsmittel zu entfernen. Befolgen Sie das unten stehende Verfahren, um die Handstücke zu waschen und zu sterilisieren.

(1) Zerlegen

Nehmen Sie die Handstücke wie in der Abbildung gezeigt auseinander, um sie zum Waschen vorzubereiten.

Halten Sie den Schlauchanschluss fest und ziehen Sie am Absaugschlauch und am Kleiner Speichelsaugerschlauch, um sie vom Hauptgehäuse zu lösen.

(2) Waschen der Oberfläche

Spülen Sie die Oberfläche mit sauberem Wasser (Leitungswasser) ab, das auf eine Temperatur von $40 \pm 5^\circ\text{C}$ erwärmt ist, und reiben Sie sie mit einem Tuch ab, um Schmutz zu entfernen. Wenn der Schmutz vollständig entfernt ist, wischen Sie sie trocken.

(3) Waschen des Inneren und der Gleitnut

Spülen Sie die Innenseite und die Gleitnut des Hauptteils mit sauberem Wasser (Leitungswasser), das auf eine Temperatur von $40 \pm 5^\circ\text{C}$ erwärmt ist, und reiben Sie sie mit einer Bürste oder Zahnbürste ab. Wenn der Schmutz vollständig entfernt ist, wischen Sie sie trocken.

(4) Waschen von Teilen, die nicht mit einer Bürste zugänglich sind

Wenn einige Teile mit einer Bürste nicht zugänglich sind, reiben Sie sie mit einem Tuch ab.

Spülen Sie sie gut mit sauberem Wasser (Leitungswasser) ab, das auf eine Temperatur von $40 \pm 5^\circ\text{C}$ erwärmt ist (mindestens 1 Minute lang).

Tauchen Sie die Teile für 5 Minuten in ID212 von Dürr oder Alkalireiniger. Spülen Sie sie dann gut mit sauberem Wasser (Leitungswasser) ab, das auf eine Temperatur von $40 \pm 5^\circ\text{C}$ erwärmt ist (mindestens 1 Minute lang).

Inspizieren Sie die Teile auf sichtbaren Schmutz. Wenn sichtbare Verschmutzungen vorhanden sind, wiederholen Sie den obigen Waschvorgang.




Waschen Sie sie sofort nach Gebrauch.

Wenn sich die Teile nach dem Waschen in dem nachfolgend beschriebenen Zustand befinden, autoklavieren Sie sie nicht. Tauschen Sie sie aus.

Löcher sind verstopft und Schmutz kann nicht entfernt werden.

Schmutz an einigen Teilen oder hartnäckiger Schmutz kann nicht entfernt werden.

Vorsicht beim Zusammenbau des Saughandstücks vor der Sterilisierung
VH-18

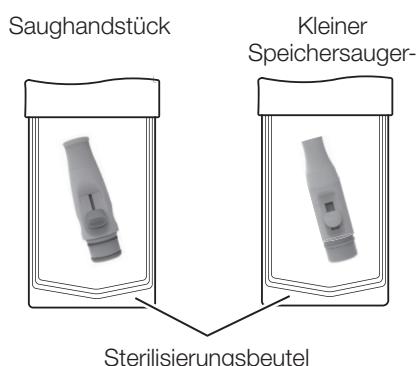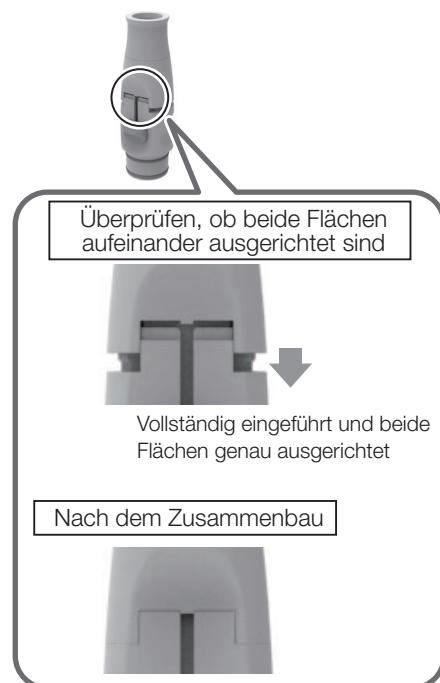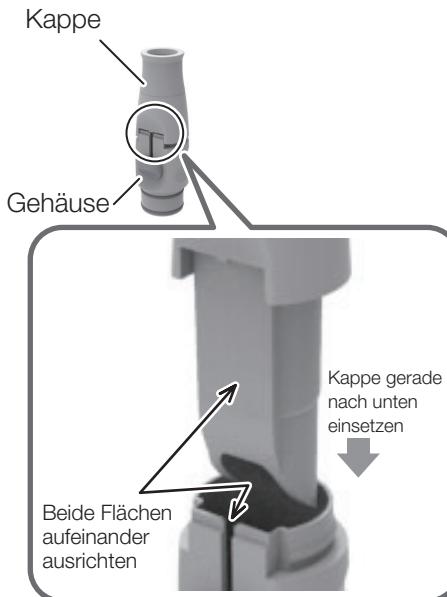

(5) Sterilisierung

Das Saughandstück und das Kleiner Speichersauger-Handstück sind autoklavierbar.

Bauen Sie das Hauptteil wieder zusammen und autoklavieren Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück.

Beim Zusammenbau des Saughandstücks richten Sie die beiden Oberflächen aneinander aus;
die flache Oberfläche der Kappe und die Oberfläche der Gleitnut des Gehäuses.
Schieben Sie anschließend die Kappe gerade in das Gehäuse.
* Führen Sie sie nicht verdreht ein.

1. Legen Sie das Handstück in einen Sterilisationsbeutel und dichten Sie die Öffnung ab.

2. Autoklav-Sterilisierung

Im Folgenden finden Sie die Sterilisierungstemperatur und Sterilisierungszeit für die einzelnen Saughandstücke.


Dürr: 134 °C für 5 Minuten.

VH-18/BT06: 134 °C für 3 Minuten.

Wenn die Temperatur während des Trocknungsprozesses höher als 135 °C ist, führen Sie den Trocknungsprozess nicht durch und trocknen Sie natürlich. Die Handstücke können bis zu 250 Mal autoklaviert werden.


Lagerungsmethode: Bewahren Sie das Handstück nach der Sterilisierung im Sterilisationsbeutel an einem dunklen, kühlen Ort auf.

7 Wartung und Reinigung

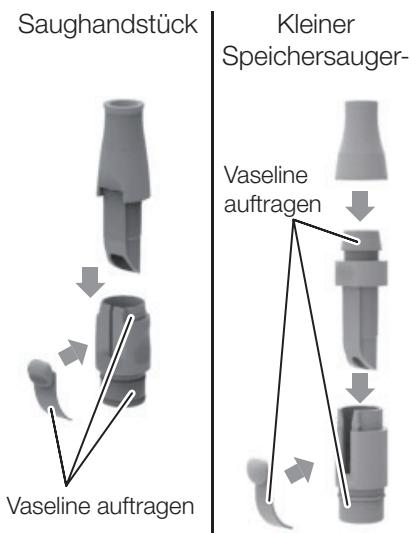

Nehmen Sie die Handstücke nach der Sterilisierung im Autoklaven auseinander, tragen Sie Vaseline auf und setzen Sie sie vor dem Einsatz wieder zusammen.

Wenn die Handstücke ohne Vaseline verwendet werden, kann eine Dichtung beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten führen kann.

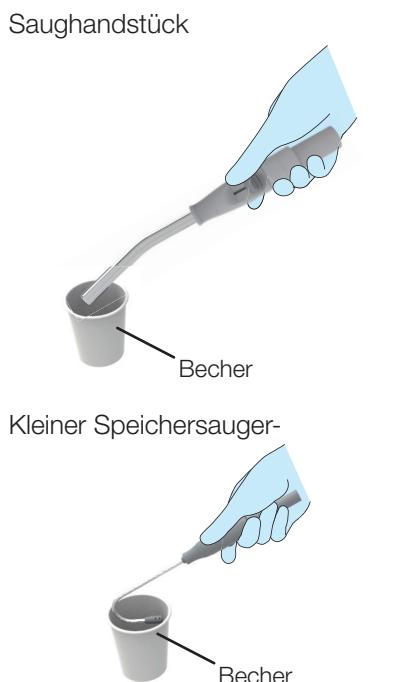


Absaughandstück/Kleiner Speichersaugerhandstück

Saugen Sie nach der Verwendung durch einen Patienten einen Becher Wasser (ca. 100 ml) oder mehr in das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück. Damit wird das verwendete Medikament entfernt und verdünnt und verhindert, dass die Handstücke sich verschlechtern.

Einige Medikamente, die für das Verfahren verwendet werden, können zu einer Verschlechterung des Handstücks führen. Sie können Teile des Handstücks lösen, verformen oder beschädigen, was möglicherweise zu Undichtigkeiten aus dem Handstück oder Saugfehler führen kann. Dies macht letztendlich das Handstück unbrauchbar.

Waschen Sie sie bitte gründlich ab, um einen langfristigen Gebrauch zu gewährleisten.

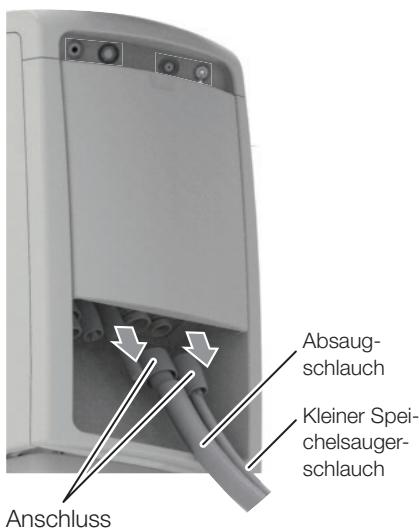

Aussaugschlauch/Kleiner Speichersaugerschlauch

Der Absaug- und Kleiner Speichersaugerschlauch können abgenommen werden, wenn Sie den Anschluss festhalten und am Schlauch ziehen.

Der Schlauch kann von außen mit Leitungswasser abgewaschen werden.

* Hinweise zum Auswaschen des Schlauchs von innen (der Absaug- und Kleiner Speichersaugerleitung) finden Sie auf [Seite 246].

Um den Schlauch wieder anzubringen, führen Sie die Verbindung in die Aufnahme ein.

Schalten Sie stets den HauptscHolder aus, bevor Sie den Schlauch abziehen, um ihn zu waschen.

[Chemische Lösung: Orotol plus]



7-4-5 Absaugleitung/Kleiner Speichelsaugerleitung

Handstücke zum Absaugen und für Speichel saugen Sekrete, Speichel oder Blut ab, die Bakterien enthalten. Waschen und sterilisieren Sie sie daher nach dem Verfahren immer mit der von uns angegebenen chemischen Reinigungslösung.

[Referenz] Von uns angegebene chemische Reinigungslösung [Seite 176]
Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel außer dem von uns angegebenen. Andernfalls können stark säurehaltige Reinigungsmittel oder alkalische Abflusseinrichtungen zu Verstopfung, Beschädigung oder Metallkorrosion führen.

7-4-6 BT14 3-WEGE-Spritze

[Referenz] BT14 3-WEGE-Spritze [Seite 233]

7-4-7 SYR-20 3-WEGE-Spritze

[Referenz] SYR-20 3-WEGE-Spritze [Seite 235]

7-4-8 Typ 77 3-WEGE-Spritze

[Referenz] Typ 77 3-WEGE-Spritze [Seite 237]

7-4-9 Sensorfenster für Becherfüller

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD366 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn die Außenseite stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % neutrales Reinigungsmittel enthält, und wischen Sie sie mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.



7-4-10 Speischale

Speischale/Becherfüller

Verwenden Sie MD550 von Dürr als Reinigungsmittel für das Speischale.

(1) Speischale

Das Speischale ist abnehmbar und kann unter Leitungswasser gewaschen werden.

Heben Sie es in Pfeilrichtung an, um es abzunehmen.

Vergewissern Sie sich nach dem Wiederanbringen, dass es sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.

VORSICHT

Ziehen Sie die Reinigungshandschuhe an, wenn Sie das Speischale abnehmen. Das Speischale besteht aus Keramik und kann bei Zerbrechen Verletzungen verursachen.

Schalten Sie immer den HauptscHolder aus, bevor Sie das Speischale abnehmen.

(2) Sieb (3) Ablaufabdeckung

Da das Sieb schnell verstopt, nehmen Sie die Ablaufabdeckung (3) ab und reinigen Sie den Filter täglich nach der Sprechzeit.

(4) BecherfüllerBodenplatte (5) Sensorfenster für Becherfüller

Schalten Sie vor der Reinigung den HauptscHolder aus oder deaktivieren Sie den Sensor. [Seite 153]

(6) LED-Anzeige

Wischen Sie die LED-Anzeige mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist, um Schmutz und Wassertropfen zu entfernen.



(7) Unterseite des Siphons

Wenn der Siphon nicht vollständig entwässert wird, kann sich Schmutz an der Innenseite ansammeln. Drehen Sie das Speischale um 90 Grad, wie in der Abbildung gezeigt, drehen Sie die Unterseite (7) des Siphons gegen den Uhrzeigersinn, um es abzunehmen, und reinigen Sie es. Beim Abnehmen des SiphonUnterseitens (7) kann verschmutztes Wasser aus dem Inneren austreten. Nehmen Sie immer das Sieb (2) und die Ablaufabdeckung (3) ab und spülen Sie das Speischale mit einem Becher Wasser aus, bevor Sie die Unterseite (7) des Siphons abnehmen. (Dadurch wird die Menge an Schmutzwasser im Siphon verringert.)

Drehen Sie zum Wiederanbringen das Unterseite des Siphons im Uhrzeigersinn, bis die senkrechte Linie auf die Dreiecksmarkierung trifft.

Wenn das Unterseite des Siphons abgenommen wird, dürfen Sie kein Wasser in das Speischale laufen lassen.

Um Gerüche aus dem Ablauf zu vermeiden, spülen Sie das Becken nach der Reinigung.

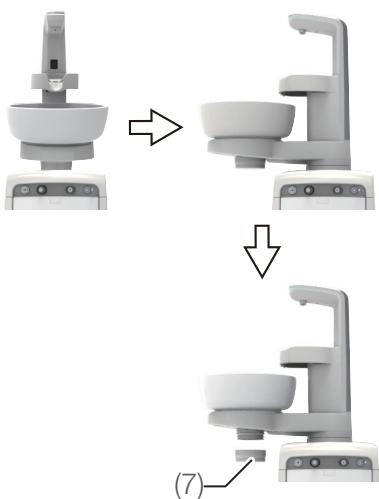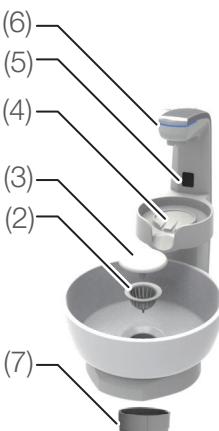

Verwenden Sie kein Schmirgelpapier, keine Drahtwolle, keine scheuernden Schwämme oder Scheuermittel.

Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel als die von uns empfohlenen. Andernfalls können stark säurehaltige Reinigungsmittel oder alkalische Abflusseinrichtungen zu Verstopfung, Beschädigung oder Metallkorrosion führen.

Lassen Sie nicht zu, dass Metallgegenstände das Speischale beim Abnehmen oder Wiederanbringen berühren, da sie eine metallische Spur hinterlassen können. Wenn der Metallgegenstand eine metallische Spur in der Schüssel hinterlassen hat, nutzen Sie ein Mittel zur Entfernung solcher Spuren (im Handel erhältlich).

* Eine metallische Spur ist eine schwarze oder silberne Linie, die durch starken Kontakt und Reibung zwischen der Keramikoberfläche und dem Metallgegenstand entsteht.

Bevor Sie das Speischale abnehmen oder wieder anbringen, schalten Sie immer den HauptscHolder aus. Schalten Sie beim Reinigen des Becherfüllers den HauptscHolder aus oder deaktivieren Sie den Sensor.

Beim Abnehmen oder Wiederanbringen des Beckens könnte der Becherfüller-Sensor Ihre Hand oder einen anderen Gegenstand erkennen und dazu führen, dass das Becken mit Wasser gespült wird oder der BecherfüllerBodenplatte nass wird, wodurch Metallteile rosten können.

Das Speischale besteht aus Keramik. Es kann zerbrechen, wenn es einen harten Schlag erfährt. Waschen Sie es nicht mit kochendem Wasser aus, da es dadurch zerbrechen kann.

Da sich das Speischale leicht abnehmen und wieder anbringen lässt, üben Sie beim Waschen keine übermäßige Kraft aus. (Klopfen oder schlagen Sie nicht darauf und lassen Sie es nicht fallen.)

Gießen Sie zum Reinigen des BecherfüllerBodenplattes kein Wasser darüber. Er ist nicht wasserdicht, und zu viel Wasser kann zu einer Fehlfunktion führen. Zum Reinigen des BecherfüllerBodenplattes siehe [Seite 247].

Lassen Sie kein Wasser auf den BecherfüllerBodenplatte fließen. Die Ablauffunktion des BecherfüllerBodenplattes dient zum Abfließen von überlaufendem Wasser beim Befüllen eines Bechers.


7-4-11 Feststoffsammler

Nehmen Sie nach der Sprechzeit den Filter aus dem Feststoffsammler im Speischale und waschen Sie ihn aus.


Angesammelter Schmutz kann die Saugkraft des Saughandstücks oder Kleiner Speichersauger-Handstücks beeinträchtigen.

[Methode zum Abnehmen/Wiederanbringen des Filters]

1. Drücken Sie auf die Abdeckung des Wartungsbedienfelds (oben) für das Speischale, um es zu öffnen.

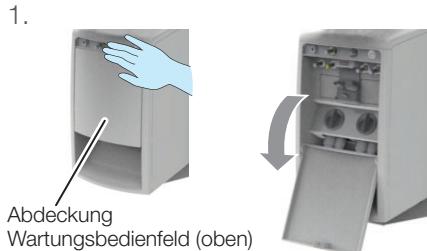



2. Ziehen Sie den Feststoffsammler ab.

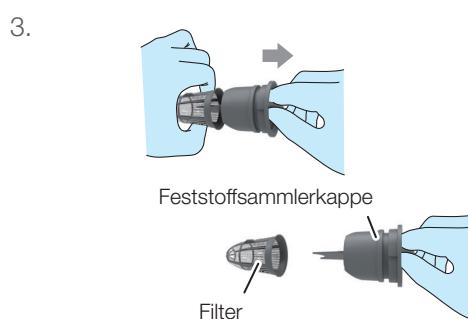

3. Lösen Sie die Feststoffsammlerkappe vom Filter.

Ziehen Sie am Filter, um die Feststoffsammlerkappe zu lösen, wie in der Abbildung links gezeigt.

4. Waschen Sie die Feststoffsammlerkappe und den Filter unter fließendem Wasser ab.

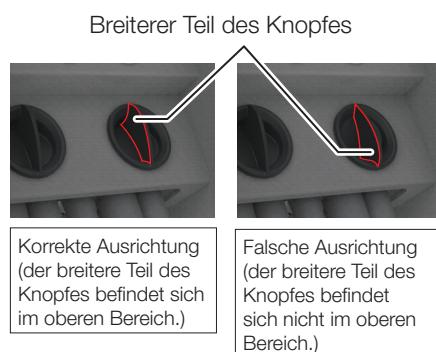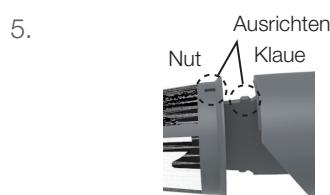


5. Richten Sie die Klappe an der Feststoffsammlerklappe auf die Nut am Filter aus, um sie anzubringen.

6. Setzen Sie den Feststoffsammler in seiner ursprünglichen Position ein und richten Sie die Kappe so aus, wie in der Abbildung links gezeigt.

Drücken Sie den Feststoffsammler mit der richtigen Ausrichtung in das Ende des Behälters. Bei unsachgemäßer Montage funktionieren das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

7-4-12 Speischale-Ventil

Reinigen Sie das Speischale-Ventil zweimal täglich zum Ende der Vormittags- und Nachmittagssprechstunde. (Zum Ende der Nachmittagssprechstunde, wenn nur einmal am Tag gereinigt wird.)

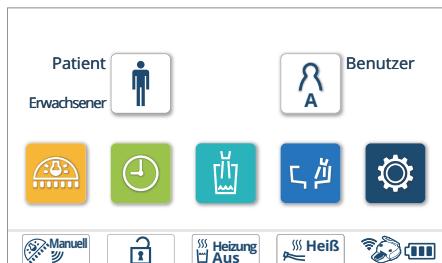


1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie 'Reinigung des Speischalensperrventils'.

Der Reinigungsbildschirm für das Speischale-Ventil wird angezeigt.

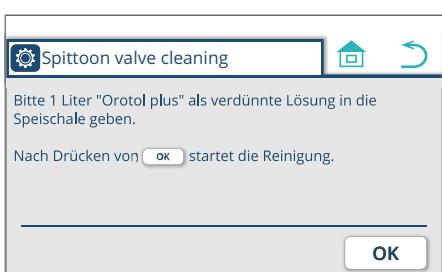


3. Füllen Sie die Speischale mit Chemikalienlösung und drücken Sie .

1 Liter verdünntes „Orotol Plus“ wird als Chemikalienlösung empfohlen.
Wenn Sie andere Lösungen verwenden möchten, klären Sie dies bitte vorab mit dem Händler oder Vertriebspartner.

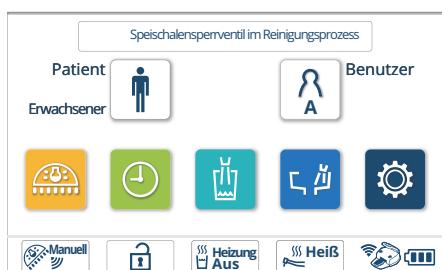

4. Die Reinigung des Speischale-Ventils startet


Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung 'Speischalensperrventil im Reinigungsprozess'.

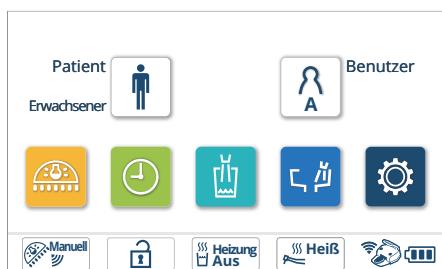

5. Die Reinigung des Speischale-Ventils endet

Die Meldung 'Speischalensperrventil im Reinigungsprozess' verschwindet vom Bildschirm.

7-4-13 Luftfilter

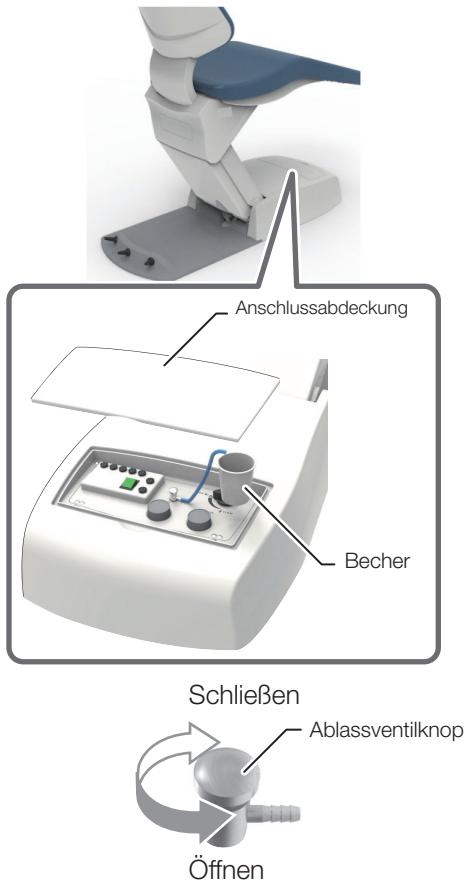

Leeren Sie das im Luftfilter angesammelte Wasser mindestens einmal wöchentlich aus.

1. Öffnen Sie die Anschlussabdeckung.
2. Halten Sie einen Becher zur Aufnahme des Wassers bereit.
3. Drehen Sie den Ablassventilknopf gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie das Wasser in den Becher ablaufen.
4. Wenn kein Wasser mehr austritt, drehen Sie den Ablassventilknopf im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen.

Nach dem Schließen des Ablassventilknopfs kann Wasser aus dem Schlauch austreten.

Wischen Sie das Wasser mit einem Tuch ab, um zu verhindern, dass Wasser austritt.

Wenn Wasser in die Luftleitung gelangt, kann dies zu einem Ausfall des Produkts führen.

7-4-14 Luftkompressor

Befolgen Sie bei der Wartung des Luftkompressors die Gebrauchsanweisung für den Luftkompressor.


7-4-15 Absaugpumpe

Befolgen Sie bei der Wartung der Absaugpumpe die Gebrauchsanweisung für die Absaugpumpe.


7-5 Batterie aus der Arzteinheit nehmen

Instrumentenausleger: Holder/PlaceHolder


1. Entfernen Sie die vier Schrauben unter dem Arzttisch und nehmen Sie den Arzttisch ab.



2. Entfernen Sie die sieben Schrauben und nehmen Sie die Tischfläche ab.

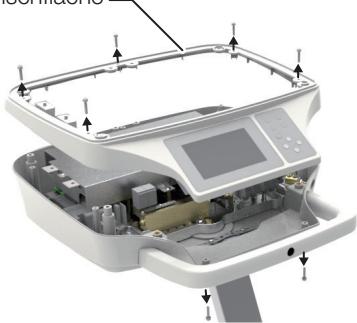


3. Nehmen Sie die Knopfzelle (CR1632) aus der Platine.

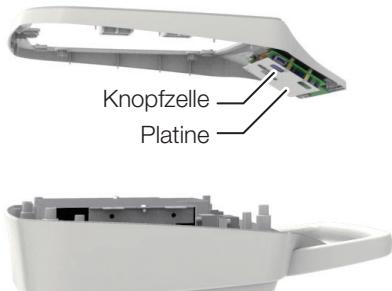

7 Wartung und Reinigung

Instrumentenausleger: Stange


1. Entfernen Sie die vier Schrauben und nehmen Sie die Rückwand ab.

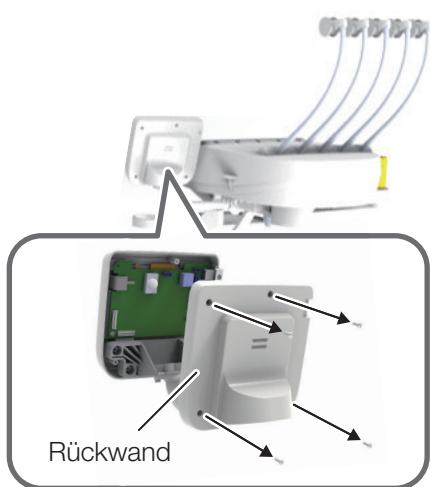

Knopfzelle

Platine

2. Nehmen Sie die Knopfzelle (CR1632) aus der Platine.



7–6 Wartung und Überprüfung

Hinweise zur täglichen Wartung und Überprüfung (durch den Benutzer)

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers (der medizinischen Einrichtung), dafür zu sorgen, dass das medizinische Gerät ordnungsgemäß gewartet und überprüft wird. Um die sichere Verwendung dieses Produktes zu gewährleisten, muss die Einheit in den in der nachfolgenden Tabelle genannten Intervallen überprüft werden:

Nr.	Überprüfungs- punkt	Überprü- fungsintervall	Überprüfungsverfahren und -kriterien	Ergebnis, wenn keine Überprüfung durchgeführt wird	Erforderliche Wartungsmaßnahme, wenn das Überprüfungskriterium nicht erfüllt ist
1	Überprüfen Sie die Abbruchfunktion	Vor den Sprechstunden	Wenn sich der Stuhl im automatischen Betrieb befindet, muss er anhalten, wenn einer der auf [Seite 110] gezeigten Bedienelemente gedrückt bzw. getreten wird.	Der Stuhl bewegt sich unerwartet während der Behandlung und verursacht eine Verletzung. Die Patienten können zwischen der Behandlungseinheit und dem Stuhl eingeklemmt werden und eine Verletzung erleiden.	Wenn der Stuhl nicht anhält, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
2	Auf Wasser-, Luft- und Ölecks prüfen	Vor den Sprechstunden	Kontrollieren Sie, dass kein Wasser, Luft oder Öl aus dem Produkt austritt.	Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß und verhindert eine ordnungsgemäße Behandlung oder einen ordnungsgemäßen Ablauf.	Wenn Wasser, Luft oder Öl austritt, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Öl austritt.
3	Becherfüllung	Vor den Sprechstunden	Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller und prüfen Sie, ob der Becher erkannt und korrekt gefüllt wird. * Nehmen Sie einen Becher mit einem Gewicht von mindestens 3 Gramm.	Der Becher wird in einigen Fällen nicht mit Wasser gefüllt.	Folgen Sie der Beschreibung unter „Becherfüller“ und überprüfen Sie erneut. [Seite 153] Wenn das Problem nach einer erneuten Prüfung nicht behoben ist, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
4	Überprüfen Sie die Funktion jedes Handstücks	Vor den Sprechstunden	(1) Überprüfen Sie, ob die Turbine sich ordnungsgemäß dreht und ob die richtigen Wasser- und Luftpumpen zugeführt werden. (2) Überprüfen Sie, ob sich der Mikromotor ordnungsgemäß dreht und dass die richtige Wassermenge zugeführt wird. (3) Überprüfen Sie, ob der Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät ordnungsgemäß vibriert und die richtige Wassermenge zugeführt wird. (4) Überprüfen Sie, dass die richtigen Wasser- und Luftpumpen von der Spritze zugeführt werden.	Der Patient kann eine Mundverletzung erleiden oder das Handstück funktioniert nicht richtig.	Stellen Sie die Wasser- oder Luftpumpe ein. [Seite 223] Für andere Ausfälle beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung für die jeweiligen Handstücke. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
5	Prüfen Sie die Funktion des Hebels (Spritze)	Vor der Sprech-Stunde	Wasser, Luft und Spritzwasser treten durch Drücken des Hebels A und des Hebels W aus. Beim Drücken des Hebels wird keine Lockerheit beobachtet.	Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß und verhindert eine ordnungsgemäße Behandlung oder einen ordnungsgemäßen Ablauf.	Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
6	Prüfen Sie, ob der richtige Bohrer für die Turbine, den Luftpumpen und den Mikromotor montiert ist.	Vor jedem Patienten	Prüfen Sie, ob der richtige Bohrer sicher montiert ist. Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung für Turbine, Luftpumpen und Mikromotor. Überprüfen Sie, dass der Bohrer frei von Defekten (Beschädigung oder Verformung) ist.	Der Bohrer dreht sich nicht frei, was zu einem Unfall führen kann.	Wenn der Bohrer beschädigt, verformt ist oder einen anderen Defekt aufweist, ersetzen Sie ihn, indem Sie die Gebrauchsanweisung für Turbine, Luftpumpen und Mikromotor befolgen.

7 Wartung und Reinigung

Nr.	Überprüfungs- punkt	Überprü- fungsintervall	Überprüfungsverfahren und -kriterien	Ergebnis, wenn keine Überprüfung durchgeführt wird	Erforderliche Wartungsmaßnahme, wenn das Überprüfungskriterium nicht erfüllt ist
7	Überprüfung der	Vor jedem Patienten	Stellen Sie sicher, dass die richtige Spitze sicher montiert ist und ordnungsgemäß verwendet wird. Beachten Sie die Gebrauchsanleitung für den Zahsteinentfernungsgerät. Überprüfen Sie, ob die Spitze frei von Defekten (Beschädigung oder Verformung) ist.	Die Spitze vibriert nicht ordnungsgemäß, was zu einem Unfall führen kann.	Wenn die Spitze verschlissen oder verformt ist, ersetzen Sie sie, indem Sie die Gebrauchsanleitung für den Zahsteinentfernungsgerät befolgen. Bei anderen Defekten wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
8	Überprüfen der Düsensperre (BT14/SYR-20/ Typ 77)	Vor jedem Patienten	Überprüfen Sie, ob die Düse fest arretiert ist. Stellen Sie sicher, dass sich die verriegelte Düse nicht löst, wenn Sie daran ziehen.	Die Düse könnte sich plötzlich lösen und Benutzer oder andere Personen verletzen.	Verriegeln Sie die Düse sicher. [Seiten 233, 236 und 238] Wenn Sie eine Fehlfunktion beobachten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
9	Rückstände am Mikromotor	Nach den Sprechstun- den	Überprüfen Sie, dass kein überschüssiges Öl vom Handstück an der Motoreinheit haftet.	Die Motoreinheit funktioniert möglicherweise nicht richtig, was zu einer Fehlfunktion führt.	Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung für den Mikromotor, um ihn zu warten.
10	Wartung Absaughand- stück/Kleiner Speichelsauger- handstück	Nach den Sprechstun- den	Waschen Sie die Absaug- und Kleiner Speichelsaugerleitungen aus.	Absaugung ist defekt.	Reinigen Sie die Absaugleitungen. [Seite 246]
11	Wartung Speischale	Nach den Sprechstun- den	Prüfen Sie, ob das Speischale Schmutz (oder Rückstände) enthält. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Schmutz am Schmutzfilter angesammelt hat.	Die Entleerung ist defekt.	Reinigen Sie das Speischale und den Schmutzfilter. [Seiten 247, 248]
12	Wartung Feststoffsam- mler	Nach den Sprechstun- den	Vergewissern Sie sich, dass sich kein Schmutz auf dem Feststoffsammler angesammelt hat.	Die Saugleistung des Absaug- oder Kleiner Speichelsaugerhandstücks hat sich verringert.	Reinigen Sie den Filter. [Seite 249]
13	Wartung Äußeres	Nach den Sprechstun- den	Kontrollieren Sie, dass keine chemische Lösung und kein verschmutztes Wasser an der Oberfläche des Produktes anhaftet oder dort verblieben ist.	Jede verbleibende Flüssigkeit verursacht eine Verfärbung oder Veränderung der Eigenschaften des Äußeren oder führt zur Verrostung der Metallteile.	Reinigen Sie das Äußere. [Seite 225]
14	Überprüfung des Haupt- scHolders und der Hauptwas- serventile	Nach den Sprechstun- den	Überprüfen Sie, ob der HauptscHolder ausgeschaltet und das Hauptwasserventil geschlossen ist.	Kann zu einem Kurzschluss oder Austritt von Wasser führen.	Wenn der HauptscHolder nicht ausgeschaltet oder das Hauptwasserventil nicht geschlossen werden kann, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
15	Bewegliche Teile des Produktes	Einmal wöchentlich	Kontrollieren Sie bei der Bedienung des Produktes, dass die beweglichen Teile keine ungewöhnlichen Geräusche abgeben.	Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß und verhindert eine ordnungsgemäße Behandlung oder einen ordnungsgemäßen Ablauf.	Wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn die beweglichen Teile ein ungewöhnliches Geräusch abgeben.
16	Wartung Ablassventil	Einmal pro Woche	Lassen Sie Wasser aus dem Ablassventil am Luftfilter ablaufen.	Wasser, das in die Luftleitung eintritt, führt zu einer Fehlfunktion.	Entleeren Sie immer den Luftfilter. [Seite 251]
17	Wasser- und Pneumatikdrücke prüfen	Einmal monatlich	Überprüfen Sie den Wasser- und Druckluftdruck mit dem Druckmesser am Wartungsfeld. Hauptwasserdruk: 0,2 MPa Hauptluftdruck: 0,5 MPa	Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß und verhindert eine ordnungsgemäße Behandlung oder einen ordnungsgemäßen Ablauf.	Falls der Druck außerhalb des Bereichs von Hauptwasserdruk/Hauptluftdruck liegt, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler.
18	Überprüfen Sie die Arzteinheit	Einmal monatlich	Der Arzttisch ist waagerecht und hält an der angegebenen Position an.	Gegenstände, die vom Arzttisch fallen, führen zu einer Verletzung oder einem Unfall.	Wenn der Arzttisch nicht waagerecht steht oder nicht an der angegebenen Position anhält, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
19	Ölnebelabschei- der	Einmal monatlich	Das Ablassöl reicht nicht bis zur Linie am Ölnebelabscheider.	Das Handstück funktioniert möglicherweise aufgrund eines Abluftausfalls nicht richtig.	Entleeren Sie das Öl. [Seite 239]

WARNUNG

Beziehen Sie sich stets auf diese Anleitung und die Bedienungsanleitung, die mit jedem Gerät (wie z. B. der ZahnarztLicht/Leuchte und den Handstücken) geliefert wird, bevor Sie die tägliche Wartung und Inspektion durchführen.

Wenn Sie die tägliche Wartung oder Überprüfung nicht durchführen, kann die Verwendung des Produktes zu einer Verletzung oder Beschädigung der Geräte in der Nähe führen.

Hinweise für die regelmäßige Überprüfung

Das Produkt enthält Teile, die in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Verwendung nicht mehr funktionieren oder verschleiß, und deshalb ist es wichtig, die Wartung (einschließlich des Austauschs der Verbrauchsmaterialien) und die Sicherheitsüberprüfungen regelmäßig einmal im Jahr durchzuführen.

Die Ersatzteile, die für die regelmäßige Überprüfung (einschließlich der Verbrauchsmaterialien) benötigt werden, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Jedoch können in Abhängigkeit von den Spezifikationen Ihres Geräts alternative Ersatzteile verfügbar sein, die sich von den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten unterscheiden.

Sie können die Wartung und Überprüfung an qualifizierte Personen, wie zum Beispiel autorisierte Reparaturdienste für Medizinprodukte, vergeben. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie irgendeine Frage zur regelmäßigen Überprüfung haben.

Liste der für die regelmäßige Überprüfung erforderlichen Ersatzteile

Teilename	Standardlebensdauer	Teilename	Standardlebensdauer
Bewegliches Teil	7 Jahre	ScHolder	5 Jahre
Verkabelung für ein bewegliches Teil	5 Jahre	PC-Platine	5 Jahre

Liste der Verbrauchsmaterialien, die für die regelmäßige Überprüfung erforderlich sind

Teilename	Teilename
O-Ring	Membran
Dichtung	Kleiner Speichelsaugerdüse

WARNUNG

Vertrauen Sie die regelmäßige Überprüfung Ihrem autorisierten Belmont-Händler vor Ort an.

Wenn Sie die regelmäßige Überprüfung nicht durchführen, kann die Verwendung des Produktes zu einer Verletzung oder Beschädigung der Geräte in der Nähe führen.

7-7 Abnehmbare Teile

Teilname	Teilname
Handstück	Absaugspitze
Handstückschlauch	Kleiner Speichelsaugerdüse
Holderhülse	Feststoffsammlerkappe
Speischale	Feststoffsammlerfilter
Abdeckung für den Ablauf des Speischales	Wasserserviceanschluss
Speischalesieb	Luftserviceanschluss
Saughandstück	Spritzendüse
Kleiner Speichersauger-Handstück	Spritzengehäuse
Ölnebelabscheider	Spritzenschlauch

7-8 Lagerungsmethode

Wenn Sie das Produkt nach den Sprechstunden oder während des Urlaubs über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden, beachten Sie stets die nachstehenden Sicherheitshinweise:

1. Schalten Sie den HauptscHolder nach den Sprechstunden immer aus.
(Dadurch wird die Zufuhr von Luft, Wasser und Strom gestoppt.)
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dies zu tun, um ein Wasserleck und elektrische Unfälle zu vermeiden.
2. Drehen Sie nach den Sprechstunden den HauptscHolder gegen den Uhrzeigersinn in die vertikale Position, um das Wasserhauptventil zu schließen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dies zu tun, um Unfälle durch austretendes Wasser zu vermeiden.
3. Schalten Sie den TrennscHolder des Kompressors aus und lassen Sie die Luft ab.
(Vergewissern Sie sich zudem, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.)
4. Schalten Sie den SchutzscHolder für die Vakuumpumpe aus.
(Vergewissern Sie sich zudem, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.)
5. Schalten Sie den SchutzscHolder für das Gerät in der Klinik aus. (Vergewissern Sie sich zudem, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.)
6. Stellen Sie den Sitz auf die niedrigste Stellung und die Rückenlehne auf die am meisten zurückgelehnte Stellung.

8–1 Kundendienst

Wenn Sie eine Reparatur beauftragen

Schlagen Sie unter ‚Fehlerbehebung‘ [ab Seite 259] nach, bevor Sie die Gerät überprüfen. Wenn das Problem bestehen bleibt, schalten Sie den Hauptschalter aus und bitten Sie Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort um die Reparatur.

8–2 Lebensdauer

Die Lebensdauer dieses Produktes beträgt unter der Bedingung, dass Wartung und Überprüfung ordnungsgemäß durchgeführt werden, 10 Jahre [gemäß unserer Selbstzertifizierung (eigene Daten)].

Die Standardlebensdauer der Ersatzteile, die einer regelmäßigen Überprüfung bedürfen, ist jedoch je nach Bauteil unterschiedlich. [Seite 256]

8–3 Liefergarantie für Ersatzteile

Wir halten die Wartungsteile, wie zum Beispiel die Verbrauchsmaterialien für die Produkte, für die Dauer von 10 Jahren nach dem Zeitpunkt der Einführung bereit.

* Die Wartungsteile sind die Teile, die für die Reparatur erforderlich sind, um das Produkt in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen oder dessen Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

9-1 Fehlerbehebung

Wenn bei Ihnen eines der nachfolgend aufgeführten Probleme auftaucht, ergreifen Sie die nachfolgend beschriebenen Gegenmaßnahmen, bevor Sie um die Reparatur bitten. Wenn das Problem auch nach der Fehlerbehebung bestehen bleibt, beenden Sie sofort die Verwendung des Produktes, schalten Sie den HauptscHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Erscheinung	Überprüfung	Abhilfemaßnahme
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.	Ist der HauptscHolder eingeschaltet?	Schalten Sie den HauptscHolder ein. [Seite 63]
	Ist die Stromversorgung zum Kompressor eingeschaltet?	Schalten Sie die Stromversorgung ein.
	Ist der SchutzscHolder für das Gerät im Schaltkasten der Zahnarztpraxis eingeschaltet?	Schalten Sie den SchutzscHolder für das Gerät ein.
Der Stuhl bewegt sich nicht.	Ist die Stuhlverriegelungsfunktion aktiviert?	Entriegeln Sie den Stuhl. [Seiten 111 bis 114]
	Haben Sie das Produkt über einen langen Zeitraum kontinuierlich verwendet?	Die Überhitzungsschutzvorrichtung des Hydraulikmotors wurde ausgelöst. Warten Sie etwa 10 Minuten und verstellen Sie dann den Stuhl.
Das Produkt kann nicht mit dem Funken Fußanlasser bedient werden.	Sind die richtigen Batterien eingelegt?	Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. [Seite 148]
	Sind die Batterien leer?	Ersetzen Sie die Batterien durch neue (oder aufgeladene) Batterien mit richtiger Polarität. [Seite 148]
	Ist der Funke Fußanlasser zu weit vom Produkt entfernt?	Halten Sie den Abstand zwischen dem Fußanlasser und dem Produkt unter 1 Meter.
	Wenn Sie mehr als ein Produkt verwenden, verwechseln Sie den Fußanlasser mit dem eines anderen Produkts?	Prüfen Sie den Kopplungs-Identifizierungscode und verwenden Sie die Kombination mit gleichen Codes. [Seite 147]
Es wird keine Luft zugeführt.	Ist die Stromversorgung zum Kompressor eingeschaltet?	Schalten Sie die Stromversorgung ein.
	Ist der Knopf, der die Luftzufuhr zur Spritze oder zu anderen Teilen steuert, geschlossen?	Öffnen Sie den Luftversorgungsregler. [Seiten 223, 224]
Es wird kein Wasser zugeführt.	Ist das Wasserhauptventil geschlossen?	Öffnen Sie das Wasserhauptventil. [Seite 62]
	Ist der Wasserzufuhr-Kontrollknopf zum Handstück oder zur Spritze geschlossen?	Öffnen Sie den Wasserversorgungsregler. [Seiten 223, 224]
Das Absaughandstück oder Kleiner Speichelsaugerhandstück aktiviert die Saugfunktion nicht.	Ist die Stromversorgung der Vakuumpumpe eingeschaltet?	Schalten Sie die Stromversorgung ein.
	Ist der Feststoffsammler-Filter verschmutzt?	Reinigen Sie den Filter. [Seite 249]
	Ist der Feststoffsammler-Filter richtig angebracht?	Befestigen Sie den Feststoffsammler ordnungsgemäß. [Seite 249]
Wird auf dem Touchpanel eine Meldung angezeigt?	Lesen Sie die Nachricht.	Ergreifen Sie die in der Meldung angegebenen Abhilfemaßnahmen. [Seiten 260 bis 262]
Wasser läuft weiter aus dem Becherfüller und stoppt nicht.	Befinden sich Schmutz oder Tröpfchen auf der Oberfläche des Becherfüllersensors?	Schalten Sie den HauptscHolder aus und reinigen Sie die Oberfläche des Feststoffsammlersensors.
Es kommt kein Wasser aus dem Becherfüller.	Befinden sich Schmutz oder Tröpfchen auf der Oberfläche des Becherfüllersensors?	Schalten Sie den HauptscHolder aus und reinigen Sie die Oberfläche des Feststoffsammlersensors.
	Ist der Sensor deaktiviert?	Heben Sie die Deaktivierung des Sensors auf. [Seite 153]

9–2 Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen

Erscheinung	Überprüfung	Abhilfemaßnahme	
E01: Kommunikation mit Speifontäne	Interner Verbindungsfehler des Geräts	Schalten Sie den HauptscHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.	
E02: Kommunikation mit Fußanlasser			
E03: Kommunikation mit Instrumentenheizer			
E04: Kommunikation mit Micromotor			
E05: Verbindung mit dem Zahnsteinentfernungsgerät			
E06: Kommunikation mit Stuhl			
E07: Kommunikation mit Becherfüller			
E08: Kommunikation mit/Auswaschen der Saugleitung			
E12: Bedienfeld (Arzt)	Der MembranscHolder wurde gedrückt, als die Stromversorgung eingeschaltet wurde.	Halten Sie Ihre Hand vom MembranscHolder fern. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, wenn Sie Ihre Hand wegnehmen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.	
E13: Bedienfeld (HELFERIN)	Der ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld wurde gedrückt, als die Stromversorgung eingeschaltet wurde.	Halten Sie Ihre Hand vom Helferinnen-Bedienfeld fern. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, wenn Sie Ihre Hand wegnehmen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.	
E14: Luftdruck zu niedrig	Der Hauptdruck im Pneumatiksystem sinkt.	Schalten Sie den HauptscHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.	
E20: HP wurde bei betätigtem FC gezogen	Das Pedal des Fußanlassers wurde getreten, als das Handstück aufgenommen wurde.	Lassen Sie das Pedal des Fußanlassers los. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, wenn Sie Ihren Fuß wegnehmen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.	
E22: Fußanlasser (Schieber)	Ein Kabel im Fußanlasser hat sich gelöst.	Schalten Sie den HauptscHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.	
E24: Kommunikation mit FC besetzt.	Die Verbindung zum Fußanlasser wird gestört. (Funker Fußanlasser)	Verwenden Sie das in der Verpackung enthaltene Kabel.	
E25: Fußanlasser EEPROM	EEPROM-Lesefehler (Speicherinhalt) für Fußanlasser	Schalten Sie den HauptscHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.	
E30: Sitz EEPROM	EEPROM-Lesefehler (Speicherinhalt) für den Stuhl		
E31: Potentiometer (Sitz)	Fehler bei der Erkennung der Stuhlposition		
E32: Potentiometer (Rückenlehne)			
E34: Thermistor (Magnetventil)	Fehler bei der Erkennung der Öltemperatur des Stuhls		

9 Fehlerbehebung

Meldung auf dem Touchpanel	Einzelheiten	Abhilfemaßnahme
E35: Joystick-SchHolder	Der Joystick-SchHolder wurde gedrückt, als die Stromversorgung eingeschaltet wurde.	Überzeugen Sie sich davon, dass der Joystick-SchHolder am Stuhl nicht von einem Bein oder Gegenstand berührt wird. Wenn er von nichts berührt wird, aber der Fehlercode nicht erlischt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E38: Potentiometer (Kopfstütze)	Fehler bei der Erkennung der Stuhlposition	Schalten Sie den HauptschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E39: Zeitüberschreitung (Stuhl)	Im Automatikbetrieb kann der Stuhl die Verstellbewegung bis in die Zielposition nicht in der vorgeschriebenen Zeit ausführen.	
E42: Zeitüberschreitung (Becherfüller)	Die Becherfüllung wurde nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen.	Wenn die Wasserzufluss unzureichend ist, stellen Sie die Zufuhr mit dem Einstellknopf für den Becherfüller ein. Wenn der Fehlercode nach der Anpassung nicht erlischt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E43: Becherfüller EEPROM	EEPROM-Lesefehler (Speicherinhalt) beim Becherfüller	Schalten Sie den HauptschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E44: Es ist nicht erkannt, dass sich Wasser im Tank befindet	Die Wasserstandserkennung in der Flasche oder das Magnetventil verhält sich ungewöhnlich.	Drücken Sie den OK -SchHolder. Setzen Sie das Absaug- und Kleiner Speichelsaugerhandstück wieder in den InstrumentenHolder und wenden Sie sich anschließend an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E45: Wasser im Tank kann nicht abfließen.	Das Absaug- und Kleiner Speichelsaugerhandstück sind nicht mit dem Einstekpunkt verbunden.	Drücken Sie den OK -SchHolder und versuchen Sie es erneut.
	Die Wasserstandserkennung in der Flasche oder die Wasserabsaugfunktion verhält sich ungewöhnlich.	Drücken Sie den OK -SchHolder. Setzen Sie das Absaug- und Kleiner Speichelsaugerhandstück wieder in den InstrumentenHolder und wenden Sie sich anschließend an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E46: Desinfektionsmittelpumpe funktioniert nicht.	Die Pumpe ist überlastet.	

9 Fehlerbehebung

Meldung auf dem Touchpanel	Einzelheiten	Abhilfemaßnahme
C01: Abgebrochen. Arzttisch ist im Weg.	Der Arzttisch wurde hinter der Rückenlehne verstellt, während sich der Stuhl bewegt hat, und der Stuhl hält unterwegs an.	Fahren Sie den Arzttisch neben die Armlehne und verstellen Sie den Stuhl.
C02: Abgebrochen. Arzttisch ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert den Arzttisch, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	Entfernen Sie die Ursache für den Notstopp und verstellen Sie den Stuhl. Wenn sich der Stuhl ordnungsgemäß verstehen lässt, erlischt der Fehlercode.
C03: Abgebrochen. Helferinnenarm ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert den Helferinnenarm, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	
C04: Abgebrochen. Das Speischale ist im Weg.	Das Speischale wurde während der Stuhlverstellung entfernt und der Stuhl hält unterwegs an.	Setzen Sie das Speischale zurück und verstellen Sie den Sitz.
C05: Abgebrochen. Fußstütze ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert die Fußstütze, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	Entfernen Sie die Ursache für den Notstopp und verstellen Sie den Stuhl. Wenn sich der Stuhl ordnungsgemäß verstehen lässt, erlischt der Fehlercode.
C06: Abgebrochen. Rückenlehne ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert die Rückenlehne, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	
C07: Abgebrochen. Hintere Stuhlabdeckung ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert die Hintere Stuhlabdeckung, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	
C08: Abgebrochen. Anschlusskasten ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert die Oberfläche des Anschlusskastens, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	Beseitigen Sie die Ursache für den Notstopp, befestigen Sie den Deckel des Anschlusskastens wieder und verstellen Sie den Stuhl.
C09: Abgebrochen. FC ist in Kontakt.	Das Pedal wurde während der Stuhlverstellung getreten und der Stuhl hält unterwegs an.	Lassen Sie das Pedal des Fußanlassers los und verstellen Sie den Stuhl. Wenn sich der Stuhl ordnungsgemäß verstehen lässt, erlischt der Fehlercode.
C10: Warten. Stuhl wird aufgeheizt.	Wenn die Temperatur zu niedrig ist, wird die Aufheizfunktion des Stuhls aktiviert.	Warten Sie, bis der Fehlercode erlischt (oder das Aufwärmen abgeschlossen ist)
C12: Priorität Instrumente	Die Prioritätsfunktion ist aktiviert.	Setzen Sie alle Handstücke wieder in den InstrumentenHolder. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
C13: Instrument in Holder zurückstellen.	Beim Einschalten war ein Handstück nicht im InstrumentenHolder.	Überzeugen Sie sich davon, dass alle Handstücke im InstrumentenHolder sind. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, obwohl alle Handstücke an ihrem Place sind, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
C14: LP-Position	Wenn der Stuhl aus der letzten Position in die Gurgelposition gefahren werden soll, befindet sich der Stuhl bereits in der Gurgelposition	Verstellen Sie den Stuhl mit einem anderen ScHolder als dem Letzte-Position-ScHolder.

10-1 Zubehör

Gebrauchsanweisung (dieses Dokument)
Installationsanweisungen
Konformitätserklärung
Kabel (nur für den Funken Fußanlasser)
Düsenreinigungswerkzeug (BT14-Spritze)



Clip zum Spülen (BT14-Spritze)



10-2 Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterialien sind Teile, die normalerweise verschleißend oder sich verschlechtern, ihr Aussehen ändern oder bei der Verwendung altern. Bitte beachten Sie, dass die Reparatur und der Austausch von Verbrauchsmaterialien nicht durch die Garantie abgedeckt sind und in Rechnung gestellt werden.
(* Der Grad des Verschleißes, der Verschlechterung oder Beschädigung und der Zeitpunkt des Austausches ist von der Verwendungsumgebung und den Bedingungen in den Räumen des Kunden abhängig.)

Verbrauchsmaterialien (Die nachfolgend aufgeführten Teile sind von der Garantie ausgenommen und kostenpflichtige Teile.)
[Referenz] Liste der für die regelmäßige Überprüfung erforderlichen Ersatzteile
[Seite 256]

EC **REP**

TAKARA COMPANY EUROPE GmbH

Industriestraße 21, 61381
Friedrichsdorf, Deutschland

CE
0197

CH **REP**

Albo-Healthcare GmbH

Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham

Belmont

TAKARA BELMONT CORPORATION



2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan
TEL : +81-6-6213-5945
FAX : +81-6-6212-3680